

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015

- ΠΡΟΣ :**
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κο Γρηγορόπουλο Αναστάσιο
 - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 - Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 - 1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διοικητή / Κο Άγγελο Παπαδόπουλο
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Προέδρου / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /
Κο Λέανδρο Ρακιντζή
 - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 - Κεντρική Υπηρεσία: Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για την πρώτη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Σύμβαση Συντήρησης – Επισκευής Δεκάξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro

Α. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως

επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

«Συντήρηση – Επισκευή Δεκαέξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού GAMBRO»

1.Όρος 2. *«Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο – εξουσιοδοτημένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος*

Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου. Να κατατεθούν τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου καθώς και τα ισχύοντα πιστοποιητικά διακρίβωσης τους».

Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από εκπαιδευμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από το Νοσοκομείο απολύτως περιοριστικά όταν στην ίδια πρόταση ζητείται να είναι και **εξουσιοδοτημένοι** καθώς και η προσκόμιση **εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του**. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τις εν λόγω βεβαιώσεις αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των

εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και **σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.**

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποβάλλουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση **υποθάλλει** πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια βεβαιώσεις στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ως άνω όρος περί προσκόμισης εξουσιοδοτήσεων από τον κατασκευαστικό οίκο δεν υπήρχε, με αυτή τη μορφή, σε παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού.

Ειδικότερα, στην διακήρυξη με αριθμ. 199/10 (***Σχετ. Ι***) αναγραφόταν ότι:

«2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο από τον Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση

του ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε κάθε τεχνικό που παρακολουθεί τις τακτικές εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν οι διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης που πρέπει να διαθέτει ο συντηρητής

καθώς και στην διακήρυξη 46/2012 (Σχετ. 2) αναγραφόταν ακριβώς ο ίδιος όρος:

«2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο από τον Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση του ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε κάθε τεχνικό που παρακολουθεί τις τακτικές εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν οι διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης που πρέπει να διαθέτει ο συντηρητής».

Ποιος είναι ο λόγος που ώθησε τον Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού να ζητήσει εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και εξουσιοδοτήσεις από τον κατασκευαστικό οίκο???

Μήπως ότι το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού δεν θέλει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού έχοντας τρανή απόδειξη την τελευταία ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ στην εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, βάσει της απόφασης ΔΣ 23 της 49^{ης} συνεδρίας ΔΣ της 14-1-2015 και ΑΔΑ 71Χ94960ΩΧ-ΖΜΤ (Σχετ. 3), βάσει της οποίας επισημαίνεται μεν η σοβαρότητα της χρήσης των μηχανημάτων, παρόλα αυτά δεν διενεργήθηκε έρευνα αγορά παρά μόνο ζητήσατε προσφορά από την εν λόγω εταιρεία διότι είναι «Αποκλειστικός Διανομέας των Μηχανημάτων Gambro Σουηδίας στην Ελλάδα».

Ποια χειρ φύτευσε εμβόλιμα και παρενθετικά το συγκεκριμένο πιστοποιητικό και μάλιστα οψίμως, τη στιγμή που μπορεί να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός στην επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων Gambro;

Αναπόφευκτο (ωσάν προγραμματισμένο) αποτέλεσμα θα είναι να ανθίσει η «φαιδρά πορτοκαλέα» και να «θάλλει η ελαία» στο Νοσοκομείο, το οποίο ενώ επί χρόνια βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών των τεχνικών μας (από το 1986 μέχρι 2012), συνδράμει πλέον στη μονοπώληση της σχετικής προμήθειας υπέρ του γνωστού

περιούσιου... μόνο και μόνο γιατί ο τελευταίος διαθέτει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό που δεν είναι όμως, ούτε βάσει νόμου ούτε ήταν παλαιότερα κατά την πρακτική του Νοσοκομείου, το μόνο ικανό και αναγκαίο στοιχείο απόδειξης της τεχνικής αρτιότητας των συντηρητών. Το τι σημαίνει ανταγωνισμός και τι μονοπώλιο είναι θεωρητική πλέον έννοια για τους υπεύθυνους δημόσιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από άλλα νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 4) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, αρ.πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 5) και αρ.πρωτ. 8834/21-9-2015 (Σχετ. 6) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Ομοίως με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζεται και από το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε διακήρυξη με αρ. 06/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Σχετ. 7) του νοσοκομείου, οι οποίοι όροι προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση, και έχει ως εξής:

«1. Ο Συντηρητής αποδεδειγμένα θα έχει τα κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία για τις εργασίες συντήρησης, τα οποία να αποδεικνύονται με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

- Πιστοποιήσεις ISO του συντηρητή που αφορά στην εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν εκπαιδευτεί στα υπό ανάθεση μηχανήματα τεχνητού νεφρού. Στην περίπτωση όπου δεν διαθέτουν οι τεχνικοί του αναδόχου πιστοποιητικά εκπαίδευσης για τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία τουλάχιστον ενός Δημόσιου

Νοσοκομείου, στην οποία να αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει ικανοποιητικά εργασίες συντήρησης σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου».

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε – τονίζουμε ο ως άνω όρος των τεχνικών προδιαγραφών να διαμορφωθεί ανάλογα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον εκάστοτε ανάδοχο συντηρητή να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια μέσω σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να μην εξαρτάται η απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον κατασκευαστή.

Η εταιρεία μας παρά την έλλειψη βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή οίκο, δραστηριοποιείται επιτυχώς στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού στην Ελλάδα από το 1976, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών αλλά και πολύ πιο οικονομικότερων για το συμφέρον των νοσοκομείων και για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ εν γένει, τιμών.

Προς επιπλέον επίρρωση της παράνομης σκοπιμότητας του όρου «εξουσιοδότηση» οράτε κατωτέρω στις σελίδες 24-26 υπό τίτλους :

Ιδού τι δήλωνε μέχρι το 2014 η κατασκευάστρια εταιρεία Gambro Lundia AB στα Ελληνικά Δικαστήρια, όπου η εταιρεία μας κατέφυγε για τη δικαίωση της.

Και

Ιδού τι αναφέρουν τα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια χρήσης της ίδιας της κατασκευάστριας εταιρείας Gambro Lundia AB.

2.Όρος 3. «Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν

[...]

-Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών τα οποία πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE.»

Τα ανταλλακτικά των Ιατρικών Μηχανημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν αποτελούν – θεωρούνται Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και συνεπώς δεν φέρουν πιστοποίηση CE.

3.Όρος 3. «Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν

[...]

στ. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή ο Συντηρητής θα προβαίνει κατά την άποψη του, σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του Συγκροτήματος, εφ' όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον Κατασκευαστή Οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελούμενων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του μηχανήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών. Ο Συντηρητής οφείλει να ενημερώνει στον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά με τις βελτιώσεις του ιατροτεχνολογικού είδους που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος».

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για το κάθε Νοσοκομείο. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η **ευθύνη του κατασκευαστή** να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. Τούτο, δε, οφείλει να πράττει απαρέγκλιτα ο κατασκευαστής, προκειμένου να διατίθεται νομίμως το ιατροτεχνολογικό του προϊόν (μηχάνημα) εντός της ΕΕ. Γι' αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται ή διακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE, δεικνύοντας τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη τη σήμανση CE και, συνεπώς, την εξασφάλιση ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σήμανση CE προορίζεται για

την εθνική εποπτεία της αγοράς και των αρχών επιβολής του νόμου, ως ένδειξη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση λοιπόν η υποχρέωση αυτή του κατασκευαστή μηχανημάτων απέναντι στον χρήστη, να φροντίζει για την αναβάθμιση των μηχανημάτων και να παρέχει προς τούτο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί (μέσω της τυχόν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του συγκεκριμένου όρου) σε δυνατότητα του κατασκευαστή να δίδει ή όχι τις αναγκαίες πληροφορίες.

Αλλά ούτε και θα μπορούσε ο προαναφερόμενος όρος να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί με τρόπο που θα υπέθαλπε και θα νομιμοποιούσε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζει έναντι της εταιρείας μας ο οίκος Gambro, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2012 μας έχει στερήσει παράνομα και καταχρηστικά την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Σημειωτέον ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές γι' αυτό στην Ελληνική Δικαιοσύνη και καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όπως δικαιωθήκαμε για το παράνομο αθέμιτο και αντι ανταγωνιστικό μποιϊκοτάζ στην προμήθεια ανταλλακτικών, που μας επέβαλαν για δύο και πλέον χρόνια, είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα δικαιωθούμε και για το θέμα της τεχνολογίας.

Πλέον τούτων, τονίζουμε με έμφαση ότι υπάρχουν Δημόσια Νοσοκομεία με οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, που αναλαμβάνουν από μόνα τους τις συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων τους και για τα οποία δεν προέκυψε ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την οποιαδήποτε αναβάθμιση, ακριβώς επειδή είναι υποχρέωση του κατασκευαστή να τις παρέχει χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προμήθειας με αριθμό 4567/2003 του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια 121 Μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro τύπου AK-95S ΚΑΙ AK-200S, σε 24 δημόσια νοσοκομεία, από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αναφέρεται στη σελίδα 10 όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικών ότι *«Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχ/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για Αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα» (Σχετ. 8).*

Ακολουθώς, στη σελίδα 26 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ως επιλογή τεχνικής στήριξης για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και αυτόνομο service στα Νοσοκομεία ως *συμφέρουσα λύση και εκπαίδευση των τεχνικών με τις εξής προϋποθέσεις:*

α. Να είναι ηλεκτρονικοί.

β. Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.

γ. Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις των και τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο.

Σας παραπέμπουμε στη σύμβαση 2581/99 του Υπουργείου Ανάπτυξης όπου το Νοσοκομείο σας προμηθεύτηκε το τέσσερα (4) μηχανήματα τεχνητού νεφρού AK-95 και τα δύο (2) μηχανήματα τεχνητού νεφρού AK-200 του οίκου Gambro, το οποίο αφορά ο παρών διαγωνισμός. Στις σελίδες 26 και 27 αναφέρεται επίσης το άνω κείμενο.

Δηλαδή η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω συμβάσεων 4567/2003 & 2581/99 δεσμεύονταν:

- Να εκπαιδεύσει τους τεχνικούς 24 νοσοκομείων για το 100% των βλαβών, μεταξύ αυτών και τους τεχνικούς του νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (!)
- Για την δυνατότητα και την οργάνωση 24 Αυτόνομων service σ' αυτά τα 24 Νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και του νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (!)

4.Όροι 5 και 6 .

Όρος 5. «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

[...]

Οι επισκευές βλαβών θα γίνονται καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 08:00 έως τις 16:00

[...]»

Όρος 6. «DOWN TIME

[...] Ο χρόνος αυτός θα προσμετράτε αθροιστικά από την ειδοποίηση του Συντηρητή (μη εξαιρουμένων Αργιών και Σαββαροκύριακων όταν το νοσοκομείο εφημερεύει) για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή fax από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08:00 έως 22:00. Η κλήση θα γίνεται – εφόσον παραστεί ανάγκη – από ώρες από 08:00 έως

22:00 και τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα, εφόσον το Νοσοκομείο εφημερεύει. [...]

Ως ώρες ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την ώρα ειδοποίησης του Συντηρητή, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Εφόσον ο χρόνος ακινητοποίησης μηχανήματος υποενότιας υπερβεί τις 24 ώρες από την ειδοποίηση / κλήση του Συντηρητή, οι πέραν των 24 ωρών δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης της περίπτωσης».

Οι δύο αυτοί όροι έρχονται σε πλήρη αντίφαση διότι :

- ο όρος 5 αναφέρει ότι οι επισκευές θα γίνονται από τις 08:00 έως τις 16:00, ενώ ο όρος 6 αναφέρει ότι θα γίνονται από τις 08:00 μέχρι τις 22:00.
- Από την κλήση του συντηρητή για επισκευή βλάβης αρχίζει να μετράει ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος.
- Άραγε ποιο είναι το σωστό χρονικό περιθώριο για την επισκευή του μηχανήματος, από πότε αρχίζει και πότε τελειώνει;
- Οι επισκευές βλαβών θα γίνονται μόνο καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00 αλλά ο «DOWN TIME» χρόνος θα προσμετρείται αθροιστικά από την ειδοποίηση του συντηρητή από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08:00 έως 22:00 και τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα , εφόσον το Νοσοκομείο εφημερεύει . (!!!)

5.Όρος 9. «Θα κατατεθεί βεβαίωση / επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων, ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησης των».

Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή

υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι ευνοούν και υποθάλλουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούσαν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ. 9), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου

αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαιώσεως που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

Οι αναφορές του περιούσιου συντηρητή σας

Οι αναφορές στις ψευδο-επιστολές και στις προσφορές της που προσκομίζει η εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ είναι ψευδείς, και για το λόγο ότι οι τύποι των μηχανημάτων AK-95, AK-100 και AK-200 έχουν πάψει να υποστηρίζονται τεχνικά από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro, όπως προκύπτει από τα παρακάτω σχετικά έγγραφα, τα οποία σας επισυνάπτουμε (*Σχετ. 10, 11, 12 & 13*):

- Ενημερωτικό δελτίο Service No 249/23-1-2013 για τα AK 95
- Ενημερωτικό δελτίο service No 403/21-06-2007 για τα AK-100
- E-mail από Gambro της 26/11/2009 για τελευταία ευκαιρία αγοράς ανταλλακτικών των μηχανημάτων AK-10, AK-90 και AK-100 πριν καταστραφεί (απορριφθεί - scrapped) το τελευταίο απόθεμα του κατασκευαστή.
- Ενημερωτικό δελτίο Service No 168/23-1-2013 για τα AK 200

Ο κατασκευαστικός οίκος δηλαδή δεν παρέχει πλέον γι' αυτά τα μηχανήματα ούτε τεχνική και επιστημονική υποστήριξη αλλά ούτε και ανταλλακτικά. Για ποια ευθύνη κάνει λόγο η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, για ποια αποκλειστική εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή οίκο Gambro, για ποια τεχνολογική και επιστημονική δυνατότητα και για ποια παροχή ανταλλακτικών, όταν ο ίδιος ο κατασκευαστής οίκος έχει αποποιηθεί κάθε ευθύνης με τα παραπάνω έγγραφα;;;, προσπαθώντας να παραπλανήσει τα νοσοκομεία, προκειμένου να πετύχει τον εκτοπισμό της εταιρείας

μας από τις διαγωνιστικές διαδικασίες και να επιβάλει παράνομα και μονοπωλιακά τις ασύμφορες προσφορές της, δεδομένου ότι αυτά έχουν πάψει προ πολλού να υποστηρίζονται τεχνικά από τον κατασκευαστικό οίκο;;;

Γ. Η μονοπωλιακή σχέση του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και η πλήρης υποστήριξη του ΚΑΡΤΕΛ από τους αρμόδιους του νοσοκομείου.

Στις διακηρύξεις 199/10 και 46/2012 του νοσοκομείου Ευαγγελισμός υπήρχαν οι κατωτέρω όροι:

«2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο από τον Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση του ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε κάθε τεχνικό που παρακολουθεί τις τακτικές εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν οι διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης που πρέπει να διαθέτει ο συντηρητής

[...]

9. Θα κατατεθεί βεβαίωση / επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων, ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησης των

10. Θα κατατεθεί δήλωση/δέσμευση του Οίκου Κατασκευής , που θα δεσμεύεται ότι αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις , με τους ίδιους ακριβώς όρους, της σύμβασης συντήρησης και επισκευής , σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου του έργου να ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο»

Οι παράνομες τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν από τους αρμόδιους του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός αποσκοπούσαν στην απόλυτη στεγανοποίηση της προμήθειας συντήρησης και επισκευής Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro υπέρ του ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και της Gambro Lunia AB, μη δίνοντας την ευκαιρία σε κανένα άλλο τυχάρπαστο τίμιο και ρομαντικό συντηρητή – προμηθευτή ο οποίος δρα και προσπαθεί να επιβιώσει νόμιμα πέρα και μακριά από

τις παράνομες μεν αλλά προσοδοφόρες δε πρακτικές των ΚΑΡΤΕΛ και των ΑΠΙΣΤΩΝ αρμόδιων υπαλλήλων των Νοσοκομείων. Πάντα βέβαια εν γνώσει των αρμοδίων για υψηλές τιμές και αμφιβόλου ποιότητας εργασίες.

Επιπλέον άξιο αναφοράς είναι και το πώς κατακυρώθηκε ανάδοχος η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ; διότι παρόλο που οι προδιαγραφές τέθηκαν με σκοπό την ευνοϊκή της μεταχείριση, και τη δυνατότητα συμμετοχής μόνο αυτής, η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ δεν διέθετε και δεν διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για κανένα τεχνικό της για τους τύπους μηχανημάτων ΑΚ-100 και ΑΚ-10. Επίσης αμφίβολο είναι αν χορηγήθηκε και η ανήκουστη βεβαίωση του παραπάνω όρου 10 από τον κατασκευαστικό οίκο. Άρα έθεσαν τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να συμμετάσχει μόνο η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και έκαναν τα στραβά μάτια γιατί ούτε ο περιούσιος μοναδικός συμμετέχων πληρούσε αυτές τις προδιαγραφές ;;;

Άραγε στα τόσα χρόνια συνεργασίας σας με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, ελέγξατε και μετρήσατε ποτέ τον χρόνο «DOWN TIME » των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro του νοσοκομείου σας ; και πιθανόν οι μετρήσεις αυτές (!) σας έκαναν να αλλάξετε και τον σχετικό όρο – προδιαγραφή προς το αυστηρότερο (!).

Η εταιρεία μας διαδεχόμενη την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ στη συντήρηση των μηχανημάτων Gambro, μέσω των διαγωνισμών που κερδίζουμε, διαπιστώνει καθημερινά τις «συντηρήσεις ... επί χάρτου » που έκανε η εν λόγω εταιρεία (οράτε σχετικά κατωτέρω στις σελίδες 26-29).

Έτσι και η παρούσα δημόσια διαβούλευση είναι πλήρως προσχηματική και πάντα υπέρ του ΚΑΡΤΕΛ αφού οι αρμόδιοι του νοσοκομείου είχαν το θράσος να ενισχύσουν τους όρους ζητώντας πλέον και εξουσιοδοτήσεις, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν το παράνομο μονοπώλιο της συντήρησης των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro. Εντελώς αυθαίρετα και αδικαιολόγητα προσθέτουν και αφαιρούν κατά το δοκούν όρους και τεχνικές προδιαγραφές προς εξυπηρέτηση του ΚΑΡΤΕΛ.

Γράφοντας μάλιστα και στα παλαιότερα των υποδημάτων τους το έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αρ. πρωτ. 2889/24-7-2015, ανακοίνωση της υπ' αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 απόφασης (Σχετ. 14), με βάση το οποίο από τις 21/07/2015 που τέθηκε σε εφαρμογή, οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που πρόκειται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, δεν συντάσσονται αυθαίρετα από τους αρμοδίους των νοσοκομείων αλλά μετά από υποχρεωτική πρόσκληση κατάθεσης

τεχνικών προδιαγραφών προς προμηθευτές συντηρητές κλπ. (παρόλο που η απόφαση αυτή επίσης δε λύνει το πρόβλημα των αυθαίρετων όρων !)

Σας επισυνάπτουμε (*Σχετ. 15*) τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις οποίες έχουμε καταθέσει απ' ευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3225/21-8-2015 έγγραφο μας, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης.

Επιπλέον το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ., μεταξύ και άλλων νοσοκομείων, εφάρμοσε την ως άνω απόφαση της ΕΠΥ και με το έγγραφο του υπ' αριθμ. πρωτ. 19763/28-9-2015 ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών. Σας επισυνάπτουμε (*Σχετ. 16*) Τεχνικές Προδιαγραφές που καταθέσαμε στο Νοσοκομείο του Ερυθρού, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 22260/27-10-2015 έγγραφο μας.

Αντί να δρουν υπέρ των συμφερόντων του νοσοκομείου και εν γένει του Δημοσίου Συμφέροντος δρουν υπέρ των ΚΑΡΤΕΛ και μάλιστα σε μία εποχή που η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε δραματική κατάσταση και η ελληνική κοινωνία ματώνει.

Ενώ λοιπόν βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και όχι ο περιορισμός του *...μέσω τεχνικών προδιαγραφών ... που ευνοούν ένα συγκεκριμένο προμηθευτή* με αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων και οικονομικότερων τιμών καθώς και ποιοτικότερων υπηρεσιών, οι αρμόδιοι του νοσοκομείου Ευαγγελισμός θεωρούν ότι το δημόσιο νοσοκομείο είναι τσιφλίκι τους και ότι μπορούν να πετούν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού προκειμένου να υποστηρίξουν το ΚΑΡΤΕΛ της Medical και της Gambro.

Ευλόγως, κάθε νοήμων άνθρωπος, θα απορούσε για την σκοπιμότητα των όρων αυτών:

Το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός θέλει ευρεία συμμετοχή και ανάπτυξη ανταγωνισμού στη συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO ;

Το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός θέλει ποιοτικότερες υπηρεσίες συντήρησης ;

Το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός θέλει οικονομικότερες τιμές και εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ ;

Ή μήπως το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με πρόσχημα δήθεν την εξασφάλιση της τεχνικής επάρκειας του συντηρητή , θέλει με πάση θυσία την διατήρηση της πολύχρονης παράνομης μονοπωλιακής συνεργασίας, με τον περιούσιο συντηρητή, ανεξαρτήτου ποιότητας και κόστους ;

Γ. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι οι όροι που τίθενται στο κείμενο της διαβουλεύσεως διαψεύδουν την υποτιθέμενη πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και καταλήγει σε κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση με το πρόσχημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε όπως ενδεικτικώς τις διακηρύξεις των Δημόσιων Νοσοκομείων, του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 7) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 17), του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Σχετ. 4) στις οποίες δεν υφίστανται τα αδικαιολόγητα εμπόδια που το Νοσοκομείο σας ορθώνει στον ανταγωνισμό.

Τα προς χάριν παραδείγματος προαναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία, όχι μόνο διαμόρφωσαν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ήδη δρέπουν τους καρπούς των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών τους (συμμετείχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με εξοικονόμηση δαπανών για τα Νοσοκομεία).

Τα Νοσοκομεία που θέλησαν πραγματικά και όχι προσχηματικά να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής συντηρητών πέτυχαν και απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε πολύ οικονομικότερες τιμές :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

A/A	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ- Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ	158,00 €	29 Μ.Τ.Ν.	20 MTN AK-200S & 9 MTN AK-200 ULTRA S

2.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	172,00 €	11 M.T.N.	10 MTN AK-200S & 1 AK-200 ULTRA S
3.	ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ	165,00 €	2 M.T.N.	2 MTN AK-200S
4.	Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	165,00 €	6 M.T.N.	2 MTN AK-200S, 2 MTN AK-200 2 MTN AK-95S
5.	Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	170,00 €	11 M.T.N	4 MTN AK-200S, 6 MTN AK-200 & 1 MTN AK-95
6.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ	195,00 €	10 M.T.N.	10 MTN AK-200S
7.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	178,95 €	7 M.T.N.	7 MTN AK-200S
8.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	160,00 €	11 M.T.N.	7 MTN AK-200S & 4 AK-200 ULTRA S
9.	Γ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	162,50 €	6 M.T.N.	2 MTN AK-95, 3 MTN AK-95S & 1 MTN AK-200S
10.	Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ	189,00 €	9 M.T.N.	6 MTN AK-200, 2 MTN AK-95 & 1 MTN AK-200S
11.	Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	166,67 €	13 M.T.N.	4 MTN AK-95, 1 MTN AK-200, & 8 MTN AK-200S
12.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	176,00 €	9 M.T.N.	1 MTN AK-10, 1 MTN AK- 100, 2 MTN AK-200, 4 MTN AK-200S & 1 MTN AK-200SU
13.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ	177,78 €	7 M.T.N.	3 MTN AK-10, 1 MTN AK-95 & 3 MTN AK-200S
14.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	160,00 €	4 M.T.N.	4 MTN AK-95S
15.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ	168,00 €	4 M.T.N.	4 MTN AK-200S-
16.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ	158,98 €	11 M.T.N.	1 MTN AK-200 ULTRA, 6 MTN AK-200, 3 MTN AK-200S & 1 MTN AK-95
17.	251 Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	166,67 €	6 M.T.N.	5 MTN AK-200 & 1 MTN AK-90S

Αν παρόλα αυτά δεν εμπιστεύεστε ούτε τους συναδέλφους σας ούτε τις καλές πρακτικές των άλλων νοσοκομείων, επιτρέψτε μας την απορία:

Προς τι η διαβούλευση και η συγκρότηση επιτροπών επί επιτροπών, όταν μάλιστα οι μισθοί δεν αυγατίζουν πλέον;;;

Κάντε ένα τηλέφωνο **στον κατασκευαστή... αυτός ξέρει...** θα σας στείλει τον ENAN, ΤΟΝ περιούσιο, ΤΟΝ πιο άξιο, ΤΟΝ πιο οικονομικό, ΤΟΝ ταγμένο στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Δ. Ενώ το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός γνωρίζει πολύ καλά τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας στην επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού. Αφού η συνεργασία μας με το Νοσοκομείο από το 1986 ποτέ δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα, οράτε αξιολογήσεις των τεχνικών μας από το διευθυντή της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (**Σχετ. 18**). Προτίμησε να εμφυτεύσει τους επιπλέον παραπάνω όρους εμβόλιμα και παρενθετικά προκειμένου να μην αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός και στην ουσία να επιτύχει την κεκαλυμμένη απ' ευθείας ανάθεση στον Περιούσιο συντηρητή.

Την ίδια στιγμή που το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού απαιτεί εξουσιοδοτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του οίκου Gambro, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αρεταίειο, το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, το Γενικό Νοσοκομείο Κω, το Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο, το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Αμ.Φλέμιγκ, το Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου, το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλλονιάς, το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αγλ. Κυριακού, το Γενικό Νοσοκομείο Χίου, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και άλλα Δημόσια Νοσοκομεία καθώς και ιδιωτικές Κλινικές, θεωρούν

επαρκέστατη τεχνικά την εταιρεία μας, συνεργάζονται μαζί μας και απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες και πολύ οικονομικότερες τιμές.

Τα Νοσοκομεία αυτά δεν συναίνεσαν στις καρτελικές μεθοδεύσεις του «περιούσιου» συντηρητή Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, ανέπτυξαν και εκμεταλλεύτηκαν τον υγιή ανταγωνισμό υπέρ του συμφέροντος του Νοσοκομείου τους και Γενικότερα του Δημόσιου συμφέροντος.

Ε.1. Η τεχνική μοναδικότητα της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ

1. Η εν λόγω εταιρεία, έχοντας εφαρμόσει πλήθος παράνομων πρακτικών προκειμένου να εκτοπίσει την εταιρεία μας από την αγορά, τον τελευταίο καιρό εμφανίζει μια νέα Δήλωση του κατασκευαστή οίκου (με ημερομηνία 4/11/14) προς δήθεν επιβεβαίωση όσων παράνομων, αθέμιτων και αντιανταγωνιστικών επικαλείται η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ στις ψευδό-επιστολές και στα ψευδό-υπομνήματά της.

Επιπλέον ισχυρίζεται τα περί τεχνικής μοναδικότητάς της, τα οποία εδράζει στην κατωτέρω καινοφανή βεβαίωση του πολυεθνικού οίκου Gambro προς αυτήν με ισχύ από 1.1.2014 (όχι παλαιότερα), η οποία λέει ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ότι «*Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών στον εξοπλισμό που φέρει το σήμα Gambro και Hospal σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας απαιτεί πρόσβαση στα συστήματα GFS και SSRGP και είναι αδύνατη χωρίς τέτοιου είδους πρόσβαση*».

2. Η Gambro Lundia AB στη νέα της δήλωση αναφέρει:

1. Η Medical Products Ltd (MP) είναι ο αποκλειστικός μας διανομέας για όλα τα υπό το σήμα Gambro και Hospal μηχανήματα αιμοκάθαρσης και τα μηχανήματα CRRT, τα συστήματα επεξεργασίας νερού τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα για την περιοχή της Ελλάδας και αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος πάροχος τεχνικών υπηρεσιών (εγκατάσταση, εκκίνηση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση, με και χωρίς ανταλλακτικά) για τέτοιου είδους προϊόντα που φέρουν το σήμα Gambro και Hospal.

2. Ως ο αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος μας πάροχος τεχνικών υπηρεσιών, η ΜΡ έχει διαρκή και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στη βάση δεδομένων και στο λογισμικό ιδιοκτησίας μας που ονομάζονται Υπηρεσίες Πεδίου Gambro («GFS») και Πόροι για την Υποστήριξη Συστημάτων των Προϊόντων Gambro («SSRGP»), τα οποία διασφαλίζονται με μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης και διαθέσιμους μόνο στους εξουσιοδοτημένους μας διανομείς καθώς επίσης και πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης των ιδιόκτητων διανοητικών και βιομηχανικών μας δικαιωμάτων, της τεχνογνωσίας, της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης τεχνικής επάρκειας.

3. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών στον εξοπλισμό που φέρει το σήμα Gambro και Hospal σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας **απαιτεί** πρόσβαση στα συστήματα GFS και SSRGP και είναι **αδύνατη** χωρίς τέτοιου είδους πρόσβαση.

4. Η ΜΡ είναι εξουσιοδοτημένη να διορίζει υπεργολάβους για την παροχή τέτοιου είδους τεχνικών υπηρεσιών στα προϊόντα υπό το σήμα Gambro και Hospal, που υπόκεινται στην έγκρισή μας, και τέτοιοι κατάλληλα διορισμένοι και εγκεκριμένοι υπεργολάβοι επίσης αποκτούν πρόσβαση στο GFS και στο SSRGP.

Αυτή η δήλωση ισχύει από 01/01/2014 έως 31/12/2015

Lund, 4 Νοεμβρίου 2014

Υπογραφή

Klas Arildsson

Γενικός Διευθυντής

Gambro Lundia AB

Αναρωτιέται ευλόγως ο καθένας, **ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ GAMBRO ΔΕΝ ΙΣΧΥΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-2014;;;**

Η απάντηση είναι ότι μέχρι τις αρχές του 2014, οπότε καθαρογράφηκε η υπ' 5667/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με βάση την οποία υποχρεώθηκε η εταιρεία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» να μας πουλάει ανταλλακτικά, το KAPTEΛ είχε επικεντρώσει την προσπάθεια εξοβελισμού της εταιρείας μας στο παράνομο μπούκοτάζ μας σε ανταλλακτικά (πού θα πάει...; θα κλείσουν).

Μέχρι το 2014, αυτοί που μας στερούσαν τα ανταλλακτικά (ο κατασκευαστικός οίκος Gambro και η εδώ ενιστάμενη), μας κατηγορούσαν ενώπιον των Δημόσιων Νοσοκομείων ότι πρέπει να αποκλειόμαστε από τους δημόσιους διαγωνισμούς, γιατί δεν διαθέτουμε ανταλλακτικά που αυτοί μας στερούσαν!!!

Από το 2014 και μετά, οπότε επήλθε η δικαστική μας δικαίωση, αναγκάζονται πλέον να αναπροσαρμόσουν τις παράνομες πρακτικές τους εις βάρος μας, διαμορφώνοντας δολίως το περιεχόμενο των ισχυρισμών και βεβαιώσεων προς τα Δημόσια Νοσοκομεία και λέγοντας για πρώτη φορά περί τεχνικής μοναδικότητας.

Ιδού τι δήλωνε μέχρι το 2014 η κατασκευάστρια εταιρεία Gambro Lundia AB στα Ελληνικά Δικαστήρια, όπου η εταιρεία μας κατέφυγε για τη δικαίωση της:

Στις 13/2/2012 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών:

«25.3 Ο μάρτυς της αιτούσας κατέθεσε ότι και μετά την καταγγελία της σύμβασης υπεργολαβίας της με την 2^η καθ' ης, η αιτούσα εξακολούθησε να μετέχει σε διαγωνισμούς Νοσοκομείων για τη συντήρηση και συνήψε πράγματι, όπως λέει, νέες τέτοιες συμβάσεις, που σημαίνει ότι και ανταλλακτικά έχει και βεβαιώσεις από εμάς δεν χρειάζεται αφού την επάρκειά της την γνωρίζουν ήδη τα Νοσοκομεία.»

Στις 19/8/2011 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών :

«Με αυτό το δεδομένο, η αιτούσα είχε (και έχει) απόλυτη ελευθερία να συντηρεί εκτός από τα προϊόντα της GAMBRO και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ακόμα και ανταγωνιστικά».

Ιδού τι αναφέρουν τα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια χρήσης της ίδιας της κατασκευάστριας εταιρείας Gambro Lundia AB:

«Εξουσιοδοτημένος Τεχνικός

Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός είναι ένας τεχνικός που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης AK 96 από τη Gambro και διαθέτει πιστοποίηση από τη Gambro ή έχει αποκτήσει ισάξια εμπειρία με παρόμοιο τρόπο.

(ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο χειριστή Gambro για το μηχάνημα AK 96, Σχετ. 19).

Για τον εκπαιδευόμενο τεχνικό διατίθεται το Εγχειρίδιο Σέρβις AK 200. Το Εγχειρίδιο Σέρβις παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή και απαιτούμενη συντήρηση του μηχανήματος.

Οι προληπτικές επιθεωρήσεις, συντήρηση και βαθμονόμηση του AK 200 θα γίνονται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Σέρβις του AK 200, το Εγχειρίδιο Συντήρησης HCEN9164 τα οποία μπορούν να παραγγελθούν από τον αντιπρόσωπό σας της Gambro. Η περιοδική συντήρηση πρέπει να γίνεται μετά από 2500 ώρες λειτουργίας ή τουλάχιστον ανά έτος. (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200 op.man. HCEL9761.Rev.12.1999 program verison 4.xx σελ. 1:3 και 1:4, Σχετ. 20).

Για τον έμπειρο τεχνικό, υπάρχει διαθέσιμο το Εγχειρίδιο Επισκευής του μηχανήματος αιμοδιάλυσης AK 200 S. Το Εγχειρίδιο Επισκευής παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και την ασφαλή και απαιτούμενη συντήρηση του μηχανήματος. (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο λειτουργίας (χειριστή) μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200S HCEL9882 Αναθεώρηση 04.2010. Έκδοση προγράμματος 10.xx σελ. 1:7 και 1:8, Σχετ. 21).

Επάρκεια Μηχανικών Service

Υπάρχει ένα ορισμένο ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για τους Μηχανικούς service που συντηρούν και επισκευάζουν προϊόντα Gambro, και συνοψίζεται ως εξής.

Ένας μηχανικός συντήρησης θεωρείται κατάλληλα ειδικευμένος, αν αυτός / αυτή έχει:

1. Παρακολουθήσει τεχνικό σεμινάριο για AK 200 S / AK 200 ULTRA S και του έχει δοθεί ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο τεχνικός έχει περάσει το μάθημα.
2. Πρόσβαση στο συνιστώμενο εξοπλισμό δοκιμών και τα ειδικά εργαλεία που αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο service.

3. Πρόσβαση στα συνιστώμενα ανταλλακτικά, ανατρέξτε στο AK 200S / AK 200 ULTRA S – Spare Parts List, HCEN 9288.
4. Πρόσβαση και κατανόηση στο εγχειρίδιο Χρήσης AK 200 S / AK 200 ULTRA S- (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο συντήρησης HCEN12395 Revision 02.2010 program version 10.xx σελ. 1:5, νομίμως μεταφρασμένη (Σχετ. 22).

Η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία πιθανόν ,έχοντας πλήρη επίγνωση των θεμάτων, δεν χρειάζεται να πάρει κανένα ρίσκο και προσέχει σχετικά , αφού ούτως ή άλλως, υπάρχουν υποψήφιοι «αρμόδιοι» των Νοσοκομείων που μπορούν να «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά», θέτοντας παράνομους όρους στους διαγωνισμούς κι έτσι δεν χρειάζεται να παρανομήσει η ίδια.

Ιδού τι δήλωνε μέχρι το 2014 και η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Στις 19/8/2011 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών:

«1.3. με μη νόμιμο Β' αίτημα (χορήγησης βεβαίωσης εξουσιοδοτημένου – πιστοποιημένου παρόχου) κατά της Α' καθής, αφού με αυτό ζητά κάτι που ήδη έχει, ώστε να ελλείπει παντελώς το έννομο συμφέρον (πρόδηλα και οιοδήποτε κατεπείγον) να διαταχθεί αυτό με προσωρινή διαταγή».

«1.6. τέλος, χωρίς ορισμένη επίκληση κινδύνου (δεν συνιστά τέτοια επίκληση η περί «42 εκκρεμών συμβάσεων» που επιβάλουν «διαρκή παροχή υπηρεσιών», αφού η αιτούσα μπορεί ανά πάσα στιγμή να προμηθευτεί από εμάς όποια ανταλλακτικά επιθυμεί για τις εκκρεμείς της συμβάσεις, και παραμένει πιστοποιημένη γι' αυτές».

(Αιτούσα είναι η εταιρεία μας ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ)

Σας αποκαλύπτουμε τις «**συντηρήσεις... επί χάρτου**» που έκανε η εν λόγω εταιρεία, τις οποίες διαπιστώσαμε, διαδεχόμενοι αυτήν στη συντήρηση των μηχανημάτων Gambro στα νοσοκομεία:

Α. Περίπτωση Νοσοκομείου Ρεθύμνου

- Τα μηχανήματα είχαν την εικόνα ασυντήρητων ή πλημμελώς συντηρημένων μηχανών, οι οποίες παρουσίαζαν δυσλειτουργίες.

- Στα μηχανήματα είχαν τοποθετηθεί ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που ο κατασκευαστής τοποθετεί και περιγράφει στα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια των μηχανημάτων (Φίλτρα πιπετών K14944001 αντί K1085701).
- Ανταλλακτικά που έχρηζαν αντικατάστασης, δεν είχαν αντικατασταθεί, είτε σε προληπτική συντήρηση (φίλτρα αέρος είχαν να αντικατασταθούν πλέον του έτους), είτε σε επανορθωτικές συντηρήσεις – αποκαταστάσεις βλαβών (γλωσσίδες ορισμένων βαλβίδων).
- Χρήση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών από μηχανήματα του Νοσοκομείου Χανίων.
- Τηλεφωνική ή άλλη τεχνική στήριξη - αναγγελία βλάβης από άλλη εταιρεία (Τεχνοϊατρική-Δουλγκερης) πέραν της εταιρείας που είχε αναλάβει την συντήρηση (MEDICAL PRODUCTS).
- Ακύρωση λειτουργιών σε μηχανήματα λόγω βλάβης (ακύρωση λειτουργίας αντλίας ηπαρίνης), μονάδα πιεσομέτρου (BPM) το οποίο παρέμενε χαλασμένο και απενεργοποιημένο πάρα πολύ καιρό. Αυτό δε αντικατεστάθη από τον προηγούμενο συντηρητή Medical Products μόλις στις 24/9/2014 και ενώ ήδη ήταν συντηρητής η εταιρεία μας από τον Ιούλιο του 2014.
- Μηχάνημα που έμεινε εκτός λειτουργίας αρκετό καιρό λόγω έλλειψης ανταλλακτικού !!

B. Περίπτωση Νοσοκομείου Καρδίτσας

- Υπάρχουν φθαρμένα εξαρτήματα τα οποία έχρηζαν αντικατάστασης ήδη από το χρόνο της προηγούμενης σύμβασης συντήρησης και δεν έχουν αντικατασταθεί από τον προηγούμενο συντηρητή. (καπάκια αντλιών αίματος K19693A, K19693B).
- Έχουν τοποθετηθεί εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που ο κατασκευαστής τοποθετεί και ορίζει σε συγκεκριμένα σημεία του μηχανήματος (Φίλτρα πιπετών, Air Detector Door).
- Παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές στα εξωτερικά κελύφη μηχανημάτων ενώ μερικά είναι σπασμένα.
- Διαπιστώθηκαν αυθαίρετες μετατροπές σε μηχανήματα που στην καλύτερη περίπτωση ακυρώνουν λειτουργικές δυνατότητες των μηχανημάτων. Κάποιες μετατροπές συνιστούν υποβάθμιση (παράκαμψη βάσης select cart) ενώ άλλες

είναι επικίνδυνες (μερική παράκαμψη του 1ου υπερφίλτρου στα AK-200 ULTRA S).

Γ. Περίπτωση Νοσοκομείου Πύργου

- Υπήρχαν φθαρμένα και σπασμένα εξαρτήματα τα οποία έχρηζαν αντικατάστασης ήδη από το χρόνο της προηγούμενης σύμβασης συντήρησης και δεν είχαν αντικατασταθεί από τον προηγούμενο συντηρητή (βάση συγκράτησης αρτηριακού ποτηριού MULTIHOLDER K20397001 σε τρία μηχανήματα και LUNDIA ARM K15541B σε ένα μηχανήμα).
- Εφεδρικά μηχανήματα, τα οποία παρουσίαζαν αδικαιολόγητες βλάβες, δεδομένου ότι είχαν συντηρηθεί από τον προηγούμενο συντηρητή Medical Products.
- Χαλασμένοι αισθητήρες πίεσης από άλλα μηχανήματα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε εφεδρικό μηχανήμα, με συνέπεια να μένει χαλασμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ανακριβείς τεχνικά δελτία (εκθέσεις service) που εμφανίζουν να τοποθετείται εξάρτημα σε κάποιο μηχανήμα, ενώ διαπιστώνεται ότι είναι τοποθετημένο σε άλλο μηχανήμα της M.T.N.
- Δεν υπάρχουν σε κανένα μηχανήμα δύο πανάκριβες κάρτες FM CPU BOARD K40078005 και BM CPU BOARD K40079001R, ενώ δηλώνονται σε εκθέσεις service ότι έχουν αντικατασταθεί.
- Χρήση ανταλλακτικών από εφεδρικό μηχανήμα του Νοσοκομείου σας και όχι καινούργιων - αμεταχείριστων, ως είχε συμβατική υποχρέωση η συντηρήτρια.
- Κίνδυνος μόλυνσης «μη θετικών» μηχανημάτων από την τοποθέτηση σ' αυτά ανταλλακτικών που προέρχονται από εφεδρικό μηχανήμα το οποίο είναι θετικό.
- Εκτός λειτουργίας μηχανήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδικαιολόγητα, και κατά παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Δ. Περίπτωση Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Παν. & Αγλ. Κυριακού»

- Εικόνα μηχανημάτων πλημμελώς συντηρημένων ή ασυντήρητων μηχανημάτων για μακρό χρονικό διάστημα, πολύ μεγαλύτερο από την

τελευταία συντήρηση που αναφέρεται στις τεχνικές εκθέσεις που έκδωσε η προηγούμενη συντηρήτρια εταιρεία Ιατρικά προϊόντα ΕΠΕ.

- Τα φίλτρα των πιπετών (K10857001) καθώς και τα φίλτρα υγρού (K14944001) ήταν σε κακή κατάσταση.
- Οι σωλήνες των συνδετικών (connectors) που διανέμουν το έτοιμο διάλυμα στο φίλτρο αιμοκάθαρσης παρουσίαζαν φθορά, είχαν χρώμα καφέ -κόκκινο όταν υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι διάφανοι.
- «ΑΣυνήθιστες» και υπερβολικά μεγάλες αποκλίσεις αγωγιμότητας που επηρεάζουν την τελική σύσταση του υγρού αιμοκάθαρσης και δεν παρατηρούνται σε μηχανήματα συντηρημένα προ εξαμήνου.
- Μονάδα του συστήματος τεχνητού νεφρού AK100 που χρησιμοποιείται σε έκτακτες αιμοκαθάρσεις στην ΜΕΘ, να είναι ασυντήρητη και να δυσλειτουργεί, παρ' όλες τις διαβεβαιώσεις της συντηρήτριας εταιρείας των μηχανημάτων Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ (Medical Products).
- Μηχανήματα πλημμελώς συντηρημένα ή ασυντήρητα, αδικαιολόγητα και κατά παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, σε ένα νοσοκομείο που πρέπει να εξυπηρετήσει νεφροπαθή ΠΑΙΔΙΑ!!!

Οι αυθαίρετες μετατροπές, τα διαφορετικά ή λάθος εξαρτήματα, η μη αντικατάσταση φθαρμένων και σπασμένων εξαρτημάτων καθιστούν τη λειτουργία των μηχανημάτων προβληματική και καταργούν και καταπατούν κάθε έννοια συντήρησης προληπτικής ή επανορθωτικής, όπως αυτή περιγράφεται στις αναλυτικές οδηγίες του κατασκευαστή στα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια των μηχανημάτων.

Αν δεν βιώναμε στο πετσί μας το αδίστακτο ΚΑΡΤΕΛ του πολυεθνικού οίκου Gambro και της ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, θα απορούσαμε ευλόγως πώς είναι δυνατόν ο κατασκευαστής οίκος να μην *τραβάει το αυτί* του *περιούσιου* συντηρητή του (Ιατρικά Προϊόντα) για την άθλια κατάσταση των μηχανημάτων, την οποία θα έπρεπε να γνωρίζει σύμφωνα με το διαφημιζόμενο σύστημα GFS.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, η εταιρεία μας βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες παράνομες πρακτικές και καρτελικές μεθοδεύσεις από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ με αιτιάσεις όπως «...η ΣΕΡ.ΚΟ δεν έχει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή οίκο ή δεν έχει πρόσβαση στις αναβαθμίσεις για να μετέχει στους διαγωνισμούς κλπ.».

Ε.2. Ο πανικός της ... για τους νεφροπαθείς ρε γαμώτο!

Η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ευρισκόμενη σε μεγάλο πανικό να βλέπει την εταιρεία μας, όχι μόνο να μην έχει εξοβελιστεί από την αγορά (παρά τις παράνομες πρακτικές που υφίσταται), αλλά να συμμετέχει ισότιμα στους δημόσιους διαγωνισμούς και να κερδίζει επάξια αυτούς, εφηύρε εσχάτως την μεθόδευση της μη ανάγκης δήθεν διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών (μην διενεργείτε διαγωνισμούς, δώστε τους απευθείας σε εμάς. **για τους νεφροπαθείς ρε γαμώτο!**), επικαλούμενη αλυσιτελώς και αποσπασματικά την Οδηγία 2004/18.

Συγκεκριμένα, ενώ επικαλείται το άρθρο 31 της παραπάνω Οδηγίας, το οποίο ούτως ή άλλως αφορά *όλως εξαιρετικές περιστάσεις που πρέπει να ερμηνεύονται στενά* (C-328/92 σκέψεις 15 και 16), αποφεύγει να μνημονεύσει το άρθρο 48 της Οδηγίας που απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής ικανότητας των οικονομικών φορέων, μεταξύ των οποίων δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους (το οποίο αποτελεί γι' αυτή επαρκή λόγο εξάλειψης των δημόσιων διαγωνισμών υπέρ της ιδίας).

Έτι περαιτέρω, η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, έχοντας κακομάθει στη μονοπώληση των διαγωνισμών ενόσω μπούκόταρε την πώληση ανταλλακτικών στην εταιρεία μας, στηρίζει χωρίς την παραμικρή αιδώ το επιχείρημα της ανάγκης δήθεν εξάλειψης των δημόσιων διαγωνισμών όσον αφορά τα μηχανήματα Gambro, στην παράνομη άρνηση του κατασκευαστικού οίκου να γνωστοποιεί προς τους χρήστες των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού τις αναγκαίες βελτιώσεις (άρθρο 13 παρ. 6, δ' Οδηγίας 42/1993), εκβιάζοντας έτσι ωμά τα νοσοκομεία, προκειμένου να αποσπάσει μονοπωλιακά το οικονομικό όφελος μέσω της διενέργειας απευθείας αναθέσεων.

Λησμονεί, όμως, ότι η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro αδιάλειπτα επί ολόκληρες δεκαετίες (ακόμα και ενόσω διαρκούσε το μπούκοτάζ εις βάρος της, στο βαθμό που το επέτρεπαν τα αποθέματά της), έχοντας αποσπάσει όλα αυτά τα χρόνια εύσημα για το επίπεδο των υπηρεσιών της, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αγορά επισκευής και συντήρησης των εν λόγω μηχανημάτων αποτελεί αγορά εντός της οποίας **υφίσταται ανταγωνισμός**, καθώς δραστηριοποιούνται περισσότερες από μία εταιρείες.

Σημειωτέον, δε, ότι αραδιάζει για λόγους εντυπωσιασμού μια σειρά από αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποκρύβοντας ότι καμία από τις επικαλούμενες αποφάσεις δεν δικαιώνει το επιχείρημα παρέκκλισης

από την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών. Λχ. η απόφαση 86/2009 του IV τμήματος του ΕΛΣυν δέχεται ότι η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, στην αγορά υπάρχει ένας μόνον πάροχος των υπό ανάθεση υπηρεσιών, με συνέπεια να καθίσταται ατελέσφορη η, διά της προκήρυξης διαγωνισμού, αναζήτηση άλλων προσφορών, προϋπόθεση όμως που δεν συνέτρεχε καθώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, **μόνη η ιδιότητα της φερομένης ως δικαιούχου εταιρίας ως κατασκευάστριας των μηχανογραφικών προγραμμάτων δεν αρκεί για να την καταστήσει το μοναδικό πάροχο των υπηρεσιών συντήρησής τους**. Έτσι, εκρίθη παράνομη η απευθείας ανάθεση του έργου της συντήρησης μηχανογραφικών προγραμμάτων του ΟΓΑ σε συγκεκριμένη εταιρεία και δεν θεωρήθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα.

Κι ενώ σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται πολύ έντονος ανταγωνισμός στην αγορά της επισκευής και συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων καθώς και στην αγορά των ανταλλακτικών, με τεράστια οφέλη για τα νοσοκομεία και τις κλινικές, το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα Ε.Π.Ε., θεωρώντας τη χώρα μας απόλυτη μπανανία επιμένει στην μονοπώληση της αγοράς στις εξωφρενικές τιμές που αυτή επιθυμεί και στην αμφίβολη ποιότητα που θέλει να επιβάλει.

Πιθανόν η μέθοδος, να χρησιμοποιεί και να επικαλείται νόμους και ευρωπαϊκές οδηγίες, προκειμένου να πείσει τα νοσοκομεία για τη νομιμότητα των παράνομων και βρόμικων καρτελικών πρακτικών της, να είναι η ίδια δοκιμασμένη μέθοδος που για δεκαετίες έπειθε και κατάφερνε και πουλούσε τα φίλτρα τεχνητού νεφρού στα 50 € το ένα έναντι των 7 € με 8 € που πουλιόντουσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, ή το απλό κιτρικό που στο μπακάλη της γειτονιάς κοστίζει μόλις 2 € το κιλό (1κιλό = 1000 γραμμάρια) αυτή πουλούσε και πουλάει τα 32 γραμμάρια εντός της ειδικής συσκευασίας (CLEAN CART C) με διαφορά τιμής πολλές χιλιάδες τοις εκατό (ορ. λχ. φίλτρα τεχνητού νεφρού **Σχετ. 23 & 24**, υλικά **CLEAN CART C** και **CLEAN CART A Σχετ. 25**).

Ε.3. Οι συντηρήσεις των Ιατρικών Μηχανημάτων σε όλο τον κόσμο και ο διπλός ρόλος (πρόσωπο) των αρμοδίων του Ευαγγελισμού

Οι συντηρήσεις των Ιατρικών Μηχανημάτων

Σε όλον τον κόσμο οι συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων γίνονται είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων (OEMs) είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής τεχνικών υπηρεσιών (ISOs) είτε από τεχνικό προσωπικό των πελατών των μηχανημάτων (internal ή in house) (ορ. σχετικές εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, *Σχετ. 26*).

Στις 15.9.2014, έλαβε χώρα στην Αθήνα επιστημονική ημερίδα από την Ελληνική Εταιρεία Βιοιατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) με θέμα *«Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού και Πιστοποίηση Κλινικών Μηχανικών»*, την οποία παρακολούθησαν πλήθος στελεχών των τμημάτων βιοιατρικής τεχνολογίας των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, **συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου σας**. Σε αυτήν μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών ήταν και ο Κος Κοτσοβόλης, εκπρόσωπος της εταιρείας MESA που δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητη επισκευάστρια ιατρικών μηχανημάτων σε αρκετές χώρες, ο οποίος παρουσίασε την αγορά της συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων τόσο για την Αμερική όσο και για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA). Σύμφωνα με την εισήγησή του (*Σχετ. 27*) στην αγορά της Αμερικής οι υπηρεσίες συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων κατανέμονται ποσοστιαία μεταξύ εξουσιοδοτημένων παρόχων (OEMs), ανεξάρτητων παρόχων (ISOs) και τεχνικών υπηρεσιών των πελατών ιατρικών μηχανημάτων – νοσοκομείων ως επί το πλείστον (internal) ως εξής:

29%-36% εσωτερικά - internal

34% - 37% μέσω ISOs και

30% - 34% μέσω OEMs

Στην αγορά EMEA (Ευρώπη – Μέση Ανατολή – Αφρική) τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

10% - 12% εσωτερικά-internal,

3% - 5% μέσω ISOs και

82%-87% μέσω OEMs

Ακολούθησε θετικός σχολιασμός από τον Πρόεδρο της ΕΛΕΒΙΤ Κο Παληκαράκη, σχετικά με την δραστηριοποίηση των ανεξάρτητων εταιρειών service στα Ιατρικά Μηχανήματα, την ανάπτυξη ανταγωνισμού και τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που μπορούν να έχουν τα δημόσια νοσοκομεία.

Επίσης, πιο πριν ως κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ο Κος Saide Calil, Καθηγητής του State University of Campinas, Brazil και Πρόεδρος του Clinical Engineering Division της IFMBE στην ομιλία του με θέμα:

“Clinical Engineering Certification: do we need it?”

Ανέπτυξε θέματα όπως:

- Τι προβλέπει η νομοθεσία διεθνώς για την πιστοποίηση των κλινικών μηχανικών.
- Αν χρειάζεται η πιστοποίηση των κλινικών μηχανικών.
- Συστήματα πιστοποίησης κλινικών μηχανικών.

Ο διπλός ρόλος και τα δύο διαφορετικά πρόσωπα των αρμοδίων του Ευαγγελισμού.

Η παραπάνω παρουσίαση του Κου Κοτσοβόλη εκπροσώπου της εταιρείας MESA έγινε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης που έλαβε χώρα κατά την άνω ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) με πρόεδρο αυτής τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Ευαγγελισμού» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΒΙΤ (Αντιπρόεδρος) Κο Β. Α. Γκέρκη (**Σχετ. 28**).

Επίσης παρόν στην άνω ημερίδα ήταν και ο προϊστάμενος του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του «Ευαγγελισμού» Κος Δ. Μπιρμπιλόπουλος.

Έτσι από τη μια βλέπουμε τους πλέον αρμόδιους του «Ευαγγελισμού» πέραν κάθε αμφισβήτησης:

- Να είναι γνώστες για το τι γίνεται διεθνώς στην αγορά της συντήρησης των Ιατρικών Μηχανημάτων.
- Να είναι γνώστες για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού που υφίσταται σε όλο τον κόσμο στην αγορά της συντήρησης και επισκευής των Ιατρικών Μηχανημάτων.

και από την άλλη με κάθε τρόπο μέσω εμφύτευσης τεχνικών προδιαγραφών, ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής –

συμμετοχής προκειμένου να διατηρηθούν πάση θυσία τα ασύμφορα και παράνομα μονοπώλια των κατασκευαστών και των αντιπροσώπων τους.

Συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του επιστημονικού σωματείου ΕΛΕΒΙΤ, όπου μεταξύ άλλων, μέσω των επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων που οργανώνει, προάγει την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού και ενημερώνει τόσο για την διεθνή όσο και την εθνική νομοθεσία σχετικά με τις συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων.

Αλλά συγχρόνως ως αρμόδια στελέχη του Ευαγγελισμού εργάζονται με κάθε τρόπο προκειμένου να υποστηριχθούν και να διατηρηθούν τα παράνομα μονοπώλια των κατασκευαστών και των αντιπροσώπων τους κατακρεουργώντας και αφανίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό.

Τα ίδια πρόσωπα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Ευαγγελισμού Δ. Μπιρμπιλόπουλος και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ευαγγελισμού Β. Α. Γκέρκης, εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευαγγελισμού, με πρόσχημα ΔΗΘΕΝ την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, την με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ σύναψη σύμβασης Συντήρησης με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αξίας 47.601,00 € (Σχετ. 3). Γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους το συμφέρον του Νοσοκομείου και το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, παραβαίνοντας Νομοθεσίες και Κανονισμούς Προμηθειών Δημοσίου.

Ωσάν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού να τα βγάζουν από την τσέπη τους και το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός να είναι τσιφλίκι τους, κάνουν πάρτι εις υγείαν των κοροϊδών πετώντας στην κυριολεξία χιλιάδες ευρώ.

Κατόπιν τούτων, και με την πικρή αίσθηση που μας αφήνει η παρούσα διαδικασία, σας καλούμε να αναλογιστείτε το ρόλο σας ως ex officio εγγυητές του δημοσίου συμφέροντος, άλλως θα σας συμβουλεύαμε να μεταπηδούσατε από τον γκρίζο και άχαρο τομέα των τεχνικών προδιαγραφών των δημοσίων συμβάσεων στον καλλιτεχνικό χώρο της φωτογράφισης, όπου η ικανότητά σας είναι απaráμιλλη.

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού από το 1976. Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρεία μας ήταν το μοναδικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών της Gambro στην Ελλάδα, καθώς και ο αποκλειστικός διανομέας ανταλλακτικών. Ουδέποτε όμως χρησιμοποιήσαμε ή εκμεταλλευτήκαμε την ιδιότητα μας αυτή για να μονοπωλήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αθέμιτα την Ελληνική Αγορά των επισκευών και συντηρήσεων των Μ.Τ.Ν. του οίκου Gambro. Αντιθέτως δίνουμε απλόχερα σε όποιον μας ζητούσε τόσο τα ανταλλακτικά όσο και την τεχνολογία της Gambro, ως αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη εταιρεία που ήμασταν, χωρίς να δημιουργούμε το παραμικρό εμπόδιο εισόδου και παραμονής σε κανέναν στην εν λόγω αγορά.

Η εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ (MEDICAL) έχει αποδυθεί σε απόλυτη σύμπνοια και συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο Gambro Lundia AB (GAMBRO) επί τετραετία και πλέον, σε ανηλεή εμπορικό πόλεμο κατά της εταιρείας μας με αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές, προκειμένου να πετύχει την μονοπώληση της ελληνικής αγοράς παροχής υπηρεσιών service στα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του ως άνω κατασκευαστικού οίκου, επί ζημία του ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος. Επί των ως άνω παράνομων πρακτικών και επιδιώξεων των δύο εταιριών έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2011, η GAMBRO παράνομα και αντισυμβατικά έπαψε να μας τροφοδοτεί με ανταλλακτικά και μας παρέπεμψε στη Medical, τον νέο διανομέα της ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά. Πλην, όμως αργότερα και η Medical διέκοψε την τροφοδοσία της ΣΕΡΚΟ, την οποία όπως μας δήλωσε (προσχηματικά όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων) θα διατηρούσε μόνο για τις εκκρεμείς συμβάσεις μας. Εν συνεχεία, στις 16 Φεβρουαρίου του 2012 η GAMBRO, σε πλήρη σύμπλευση με τη MEDICAL κλιμακώνοντας τις αντιανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές τους, αιφνιδίως διέκοψε στη ΣΕΡΚΟ την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματά της προκειμένου να δυναμιτίσει την παροχή υπηρεσιών από μέρους μας.

Η εταιρεία μας προσέφυγε αμέσως στη Δικαιοσύνη, η οποία δια της υπ' αριθμ. 5667/2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απεφάνθη μεταξύ άλλων κατά το διατακτικό της:

- *ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ* ότι η άρνηση της δευτέρης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «*Medical Products Ltd*», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «*ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα* (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – *Service*) και το διακριτικό τίτλο «*SER.CO LTD*» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.
- *ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ* τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «*Medical Products Ltd*» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «*ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα* (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – *Service*) και το διακριτικό τίτλο «*SER.CO LTD*», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη *Medical Products Ltd* [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπτράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Η εταιρεία μας είναι από τις λίγες εξαιρέσεις στην ελληνική αγορά της συντήρησης των Ιατρικών Μηχανημάτων που προσπαθεί να λειτουργήσει και να επιβιώσει στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού. Κάποια νοσοκομεία ενώ βλέπουν ότι στους περισσότερους διαγωνισμούς συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων δεν αναπτύσσεται καθόλου ανταγωνισμός και λειτουργεί το απόλυτο μονοπώλιο προσπαθούν, αντί να

συνδράμουν στην ανάπτυξη ανταγωνισμού και στο άνοιγμα της αγοράς και σε μικρές εταιρείες όπως η εταιρεία μας, να προσφέρουν παρανόμως υπηρεσίες υπέρ της στεγανοποίησης της αγοράς, βοηθώντας και συμμετέχοντας στις εναρμονισμένες παράνομες αθέμιτες και αντιαγωνιστικές πρακτικές των πολυεθνικών κατασκευαστών και των βραχιόνων τους.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι σε Διαγωνισμό Δημόσιου Νοσοκομείου για την συντήρηση μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στον οποίο δεν συμμετείχαμε, λόγω του παράνομου μποϊκοτάζ προμήθειας ανταλλακτικών, που προαναφέραμε, και έχουμε ήδη δικαιωθεί, η διαφορά - ζημιά - για το Δημόσιο συμφέρον φθάνει τις 13.500 €, παραπάνω κόστος από τη μονοπωλιακή σύμβαση που υπέγραψε με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ.

Σε όλο τον κόσμο οι συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων γίνονται είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων (OEMs) είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής τεχνικών υπηρεσιών (ISOs) είτε από τεχνικό προσωπικό των πελατών των μηχανημάτων (internal ή inhouse). (βλ. αντίστοιχες εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) (*Σχετ. 26*).

Κι ενώ σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται πολύ έντονος ανταγωνισμός στην αγορά της επισκευής και συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων καθώς και στην αγορά των ανταλλακτικών, με τεράστια οφέλη για τα νοσοκομεία και τις κλινικές, το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα Ε.Π.Ε. και της Gambro, θεωρώντας τη χώρα μας απόλυτη μπανανία επιμένει στην μονοπώληση της αγοράς στις εξωφρενικές τιμές που αυτή επιθυμεί και στην αμφίβολη ποιότητα που θέλει να επιβάλει.

Όλα τα παραπάνω τα έχουμε κοινοποιήσει και είναι εν γνώση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, καθώς και μέσω των καταγγελιών μας και Αγωγών είναι εν γνώση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Οράτε ενδεικτικά:

Στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας: Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2102, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-

2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ. 1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3211/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3212/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3225/21-8-2015, Αρ. πρωτ. 3296/31-8-2015.

Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας: Αρ. πρωτ. 2210/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2211/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2335/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 2336/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 321/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 406/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 621/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 622/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 1009/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1010/5-5-2015, Αρ.

πρωτ. 1011/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1207/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1208/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1209/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2259/1-9-2015.

Στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Αρ. πρωτ. 2280/22-5-2014, Αρ. πρωτ. 2344/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2345/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2427/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2624/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 2793/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 2887/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 2888/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3222/30-7-2014, Αρ. πρωτ. 3255/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 3588/4-9-2014, Αρ. πρωτ. 3938/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 3993/26-9-2014, Αρ. πρωτ. 4086/2-10-2014, Αρ. πρωτ. 4170/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4169/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4218/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 4247/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 4666/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 5401/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5402/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5403/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5404/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5405/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5406/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 658/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 659/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 842/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 1140/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1142/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1963/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1964/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1965/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1966/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1967/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 2213/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2214/19-5-2015 Αρ. πρωτ. 2215/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3742/1-9-2015.

Στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης: Αρ. πρωτ. 23836/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 25335/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 26642/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 26643/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 27771/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 27772/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 3387/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 4175/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 5611/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 5613/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 9919/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9920/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9922/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9923/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9924/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 11347/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 11348/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 11350/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 19222/1-9-2015.

Πράγματι, βέβαια, η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό του Νοσοκομείου σας **γεννά σοβαρότατους κινδύνους**, αλλά για το ίδιο το ΚΑΡΤΕΛ του πολυεθνικού οίκου Gambro και της ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, βλέποντας το παράνομο μονοπώλιο τους σιγά σιγά να καταρρέει...

Προς επιπλέον απόδειξη ότι τα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία απαιτούν ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες και δεν τάσσονται υπέρ του παράνομου ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αλλά υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ απορρίπτοντας τις παράνομες πρακτικές του ΚΑΡΤΕΛ, σας παραθέτουμε λίστα με τα Δημόσια Νοσοκομεία που προσφάτως έχει συνάψει συμβάσεις η εταιρεία μας, και είμαστε στη διάθεσή σας, μόλις μας ζητηθεί, να σας προσκομίσουμε και τα πρακτικά κατακύρωσης – συμβάσεις, παρόλο που αυτά είναι δημόσια διαθέσιμα από την εφαρμογή της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ :

- 1) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- 2) Γ. Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ
- 3) Γ. Νοσοκομείο –Κ.Υ. Κω
- 4) Γ. Νοσοκομείο Φιλιατών
- 5) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
- 6) Γ. Νοσοκομείο Λευκάδας
- 7) Γ. Νοσοκομείο Καλύμνου
- 8) Γ. Νοσοκομείο Λιβαδειάς
- 9) Γ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
- 10) 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
- 11) Γ. Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
- 12) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
- 13) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΠΓΚ
- 14) Γ. Νοσοκομείο Χαλκίδας
- 15) Γ. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κύμης
- 16) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- 17) Γ. Νοσοκομείο Μεσολογγίου
- 18) Γ. Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
- 19) Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας
- 20) Γ. Νοσοκομείο Πύργου
- 21) Γ. Νοσοκομείο Αγρινίου
- 22) Γ. Νοσοκομείο Ρεθύμνου
- 23) Γ. Νοσοκομείο Πρέβεζας
- 24) Γ. Νοσοκομείο Λασιθίου
- 25) Γ. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου
- 26) Γ. Νοσοκομείο Χίου
- 27) Γ. Νοσοκομείο Σύρου
- 28) Γ. Νοσοκομείο Λαμίας
- 29) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Επιπλέον για να γίνει περισσότερο αντιληπτό από το Νοσοκομείο σας, το μέγεθος του πλιάτσικου από το συγκεκριμένο ΚΑΡΤΕΛ, σας γνωστοποιούμε ενδεικτικά πόσο πωλούνται αντίστοιχα, σε άλλες χώρες, τα ανταλλακτικά:

K40280001 AC/DC UNIT AK200S:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 350,00€ ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 2.069,65 €.

K11845A Level Transducer:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 36,00 € ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 246,72 €.

K40228003 Pressure transducer kit compl.:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 112,00 € ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 715,48 €.

Ανταλλακτικό που άλλες χώρες το αγοράζουν 112 € στην Ελλάδα πουλιέται από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ 715,48 €. Το ίδιο πράττει η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και με τις τιμές των αναλωσίμων τεχνητού νεφρού,

Έτσι το Φίλτρο Τεχνητού Νεφρού που το κόστος του δεν υπερβαίνει το 1 € και άλλες χώρες το αγοράζουν 6 - 8 € στην Ελλάδα σήμερα πουλιέται 28 € και παλιότερα 50 €.

Με βάση δημοσιεύματα στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο της περιόδου Ιουλίου 2014 σχετικά με έρευνα του εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Κου Δημόπουλου :

«Σύμφωνα με την καταγγελία, τα φίλτρα αιμοκάθαρσης στα ελληνικά νοσοκομεία πωλούνται σε τιμές που κυμαίνονται από 23 έως 30 ευρώ, όταν την περίοδο αυτή στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπερβαίνουν τα 15 ευρώ. Παλιότερα δε, οι τιμές τους είχαν εκτοξευτεί στα 50 ευρώ το ένα, παρότι το κόστος παρασκευής των υλικών αυτών υπολογίζεται ότι μετά βίας να ξεπερνούσε το 1 ευρώ!!

Ο κ. Εισαγγελέας, ζητά να εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της απιστίας σε βάρος του δημοσίου από την πλευρά των ιδρυμάτων, αλλά και τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και το ενδεχόμενο να έχει τελεστεί το αδίκημα

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Δεν αποκλείεται παράλληλα να γίνουν έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς συγκεκριμένων προσώπων, καθώς οι καταγγέλλουσες πηγές ανέφεραν ότι υποστηρίζουν πως από τις συγκεκριμένες προμήθειες μέλη νοσοκομείων “εισπράττουν ποσοστά”», αναφέρεται σε σχετικό επίσημο ερώτημα αρ. πρωτ. 1200/17-7-2014 των βουλευτών κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδα προς τον υπουργό υγείας (Σχετ.24).

Για το καρτέλ στο χώρο του Τεχνητού Νεφρού, έχει μιλήσει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας Κος Α. Σαμαράς από το βήμα της Βουλής στις 12/11/2012:

«Τα Ελληνικά νοσοκομεία αγόραζαν ως πρόσφατα τα φίλτρα για τις μονάδες τεχνητού νεφρού προς 35 ευρώ το ένα. Την ίδια στιγμή στην Κύπρο και σε άλλες χώρες τα ίδια φίλτρα έκαναν προς 8 ευρώ το ένα! ... Αυτό πια κόβεται με το μαχαίρι...», (Σχετ. 23).

"Σύμφωνα με την καταγγελία, όλες οι προμηθεύτριες εταιρίες συμφώνησαν να διαθέτουν τα υλικά, στην ίδια υψηλή τιμή και συνέστησαν offshore εταιρία, με τη συμμετοχή γιατρών από την Βόρεια Ελλάδα αλλά και την Αθήνα."

Πηγή: <http://www.onmed.gr/ygeia-politiki/item/316153-sta-xeria-tou-eisaggelea-i-ypothesi-gia-to-kartel-tou-texnitoy-nefroy#ixzz3Fgiycufs>

Κατόπιν τούτων, η συμβολή των Δημόσιων Νοσοκομείων και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει να είναι καθοριστική στην αποτροπή εγκαθίδρυσης παράνομων μονοπωλιακών καταστάσεων στις προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων, με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη του Δημόσιου Συμφέροντος μέσω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνονται απλοί παρατηρητές και ακόμη περισσότερο συμμετοχοί στο «τεράστιο πάρτυ» των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Τέλος, εφόσον η παρούσα διαβούλευση δεν είναι προσχηματική (ή πάψει να είναι προσχηματική) και υπάρχει (υπάρξει) πραγματική βούληση – πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και της μέγιστης δυνατής ανάπτυξης ανταγωνισμού,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας και να διαμορφώσετε ανάλογα τους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας έτσι, για πρώτη φορά:

- το σταμάτημα των ασύμφορων μονοπωλιακών συνεργασιών των Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
- την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο των συμβάσεων λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro.
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τους προϋπολογισμούς των Δημόσιων Νοσοκομείων – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Σχετικά:

- 1) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 199/10 του Γ.Νοσ/μείου Αθηνών Ευαγγελισμός
- 2) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 46/2012 του Γ.Νοσ/μείου Αθηνών Ευαγγελισμός
- 3) Απόφαση υπ' αριθμ. 23/49/14-1-2015 του Γ.Ν. Αθηνών Ευαγγελισμός περί απευθείας ανάθεσης της συντήρησης και επισκευής των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro στην Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ
- 4) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 5402/23-06-2015 του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου– Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΔΥΝΑΚΕΙΟ»
- 5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 2860/20-03-2015
- 6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 8834/21-9-2015
- 7) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 6/2014 του Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- 8) Σύμβαση 4567/2003 Υπουργείου Ανάπτυξης – Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ
- 9) Απόσπασμα της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου
- 10) Ενημερωτικό δελτίο Service No 249/23-1-2013 για τα ΑΚ 95
- 11) Ενημερωτικό δελτίο Service No 403/21-6-2007 για τα ΑΚ 100
- 12) E-mail της 26-11-2009 για τα ΑΚ-100
- 13) Ενημερωτικό δελτίο Service No 168/23-1-2013 για τα ΑΚ 200
- 14) Έγγραφο της ΕΠΥ υπ' αριθμ. πρωτ. 2889/24-07-2015-11-24

- 15) Έγγραφο της εταιρείας μας υπ' αριθμ. 3225/21-8-2015 προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
- 16) Έγγραφο μας υπ' αριθμ. πρωτ. 22260/27-10-2015 προς το Γ.Ν. Αθηνών Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
- 17) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 2137/2015 του Γ.Ν. Ρεθύμνου
- 18) Εντυπα αξιολόγησης ISO υπογεγραμμένα από το Διευθυντή της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
- 19) Εγχειρίδιο χειριστή Gambro για το μηχάνημα AK 96
- 20) Εγχειρίδιο λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200 op.man. HCEL9761.Rev.12.1999 program verison 4.xx σελ. 1:3 και 1:4
- 21) Εγχειρίδιο λειτουργίας (χειριστή) μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200S HCEL9882 Αναθεώρηση 04.2010. Έκδοση προγράμματος 10.xx σελ. 1:7 και 1:8
- 22) Εγχειρίδιο συντήρησης HCEN12395 Revision 02.2010 program version 10.xx σελ. 1:5
- 23) Δημοσίευμα με ομιλία του πρωθυπουργού Κου Α. Σαμαρά από το βήμα της Βουλής στις 12/11/2012
- 24) Δημοσίευμα με σχετικό επίσημο ερώτημα αρ. πρωτ. 1200/17-7-2014 των βουλευτών κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδα προς τον υπουργό υγείας
- 25) Επιστολή της εταιρείας μας υπ' αριθμ. πρωτ. 18222/8-7-2014 προς το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 26) Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για συντηρήσεις ιατρικών μηχανημάτων με αποσπασματική μετάφραση
- 27) Εισήγηση του Κου Κοτσοβόλη στην Ημερίδα της ΕΛΕΒΙΤ της 15/09/2014
- 28) Πρόγραμμα Ημερίδας ΕΛΕΒΙΤ της 15/09/2014
- 29) Ψηφιακός Δίσκος (cd) με όλα τα δεδομένα του παρόντος

Για τη ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ


Μπάλτσας Ιωάννης

ΣΕΡ.ΚΟ Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3 - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ.: 210 7013582 - FAX: 210 7519343
ΑΦΜ: 095221353 - ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ


Στεριώτης Κων/νος

Διαχειριστές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Ταχ. Δ/ση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47
Τ.Κ. 10626- ΑΘΗΝΑ
URL: [www.evangelismos-hosp..gr](http://www.evangelismos-hosp.gr)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 199/10

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια **ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοίκτος Δημόσιος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	10-02-11
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠΑΝ)	0800-00001
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	
ΚΩΔΙΚΟΣ GMDN	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	641.972,11€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	(1) ένας χρόνος
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.	15-12-10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	24-12-10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	22-12-10

ΚΑΕ: 0800-00001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2009 ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΥ ΕΤΟΥΣ 2010 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Σύστημα επεξεργασίας ύδατος με αντιστροφή Οσμωση	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	3.710,60 €
2	Ακτινολογικό PHILIPS DIAGNOST VR	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	15.922,00 €
3	Δύο Ακτινολογικά PHILIPS DIAGNOST TH	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	9.863,00 €
4	Συγκρότημα μαγνητικής τομογραφίας GE Medical Systems	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 79.855,00
5	Δικέφαλη τομογραφική Γ' κάμερα Sopha Medical	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 22.134,00
6	Μονοκέφαλη τομογραφική Γ' κάμερα Sopha Medical	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 29.914,00
7	Επτά (7) Ανασθ/κά Συγκροτήματα GE HEALTHCARE	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 32.067,57
8	Επτά (7) Ανασθ/κά KION MAQUET CRITICAL CARE	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 51.048,86
9	Ψηφιακός Στεφανιογράφος INNOVA 2000 GE	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 73.362,00
10	Δεκατρείς (13) Αναπνευστήρες Servo-i MAQUET	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 29.892,25
11	Εμφανιστήρια-Ψηφιοποιητές-Εκτυπωτές AGFA	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 32.454,87
12	Συγκρότημα Ψηφιακής Αγγειογραφίας INTEGRIS V500 PHILIPS	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 48.755,50
13	Κλιβανοί Αιμού και Πλυντήρια εργαλείων GETINGE	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 39.879,00
14	Δεκαέξη (16) Αναπνευστήρες Servo 300 MAQUET	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 54.378,24
15	Ακτινολογικό Συγκρότημα Siemens Iconos R200	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 25.585,00
16	Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού GAMBRO	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 54.621,00
17	Ηλεκτρικά κρεβάτια HILL-ROM	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 9.255,22
18	Αναπνευστήρας Υψηλών Συχνοτήτων	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	4.403,00 €
19	C-ARM OEC 9800 PLUS G.E. Medical Systems	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	13.447,00 €
20	Δύο (2) Συστήματα Πρωτοξειδίου Αζώτου (NO)	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	11.424,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :			641.972,11 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΑΘΗΝΑ 10-6-2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO

Αναλυτικός πίνακας Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού που πρόκειται να καλυφθούν με σύμβαση συντήρησης.

	ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	BM	FM	SERIAL NUMBER	ΤΜΗΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ
1	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:2454 BMM:31062 UCM:16968 FCM:10582	MTN	Με όσμωση WSF:3536 & WRO:8377
2	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:4661 BMM:271 UDM:16948 FCM:9622	MTN	-
3	GAMBRO	AK-95	-	-	5328	MTN	-
4	GAMBRO	AK-95	-	-	5331	MTN	-
5	GAMBRO	AK-95	-	-	5353	MTN	-
6	GAMBRO	AK-95	-	-	5355	MTN	-
7	GAMBRO	AK-100	11684	10607	-	MTN	-
8	GAMBRO	AK-200	5958	4518	-	MTN	-
9	GAMBRO	AK-200	6128	4636	-	MTN	-
10	GAMBRO	AK-200	9048	6682	-	MTN	-
11	GAMBRO	AK-200	9050	6684	-	MTN	-
12	GAMBRO	AK-200	12155	8939	-	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ ΚΟ ΤΜΗΜΑ	Με όσμωση WRO: 1189 & WSF: 101
13	GAMBRO	AK-200S	-	-	16279	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ ΚΟ ΤΜΗΜΑ	Με όσμωση WRO: 1768 & WSF: 101
14	GAMBRO	AK-200S	-	-	16292	MTN	-
15	GAMBRO	AK-200S	-	-	16293	MTN	-

1°. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των παραπάνω αναφερόμενου μηχανημάτων , κατά τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου , καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης .
Ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει ISO 9001/2008 και το ISO 13485.

2 . Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο από τον Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση του ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε κάθε τεχνικό που παρακολουθεί τις τακτικές εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν οι διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης που πρέπει να διαθέτει ο συντηρητής .

3 . Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν :

α) Την λειτουργική συντήρησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου και ειδικότερα :

- Τον έλεγχο ασφαλείας , μετρήσεις τάσεων παλμών , κλπ.
- Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης .
- Τις αναγκαίες ρυθμίσεις , λιπάνσεις και εσωτερικούς καθαρισμούς των μηχανημάτων .

β) Την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα :

- Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση .
- Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών τα οποία πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE.
- Την λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών .

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή:

- i) Ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός , θύελλες , νερά , κεραυνό, φωτιά). Από χτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή από τρίτους.
- ii) Η αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή από τρίτους.
- iii) Η χρήση ακατάλληλων υλικών για την αποστείρωση, για τον καθαρισμό απασβέστωσης, καθώς και η ελλιπής διαδικασία απασβέστωσης , ή καθαρισμού, πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως αναφέρονται στα Τεχνικά εγχειρίδια .

- iv) Η κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου.
- v) Η κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περιόδων του Νοσοκομείου ή της ΔΕΗ.
- vi) Οι εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.

Εάν ζητηθεί αποκατάσταση των βλαβών , λόγω των παραπάνω περιπτώσεων και εφόσον είναι δυνατόν, η δαπάνη θα συμπεριλαμβάνει τα εργατικά και τα ανταλλακτικά, και θα χρεώνεται χωριστά με βάση τις ισχύουσες τιμές του συντηρητή.

Ο μέγιστος χρόνος αντίδρασης είναι είκοσι τέσσερις (24) ώρες και κατόπιν έγγραφης κλήσεως από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου .

- γ) Την περιοδική συντήρηση των μηχανημάτων , που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από αυτόν, και συγκεκριμένα :
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-10 ανά εξάμηνο
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-95 κάθε 2500 ώρες λειτουργίας (kit κωδ 113 502 500)
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-100 κάθε 2500 ώρες λειτουργίας (kit κωδ 113 802 500)
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-200 κάθε δύο (2) χρόνια το Base-Kit (K40165001) και το A-Kit (K40166001) και το B-Kit (K40167001) .

4 . Όλες οι ως άνω εργασίες θα εκτελούνται υπό την εποπτεία αρμόδιου τεχνικού του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή , από 08:30π.μ έως 16:30μ.μ εξαιρουμένων εορτών και αργιών .

5 . Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται προγραμματισμένα , ενώ για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών ο Συντηρητής υποχρεούται να επιλαμβάνεται με αποστολή των ειδικευμένων τεχνικών του , εντός δύο (2) ωρών από την λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της συντηρήτριας εταιρείας .


6 . Ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος τεχνητού νεφρού της σύμβασης , συμφωνείται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες ανά έτος . Σαν χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια αιμοκάθαρσης . Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης .

Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης θα προστείνεται η σύμβαση κατά επτά (7) ημέρες άνευ ανταλλάγματος.

7. Μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχεται στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίου εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης.
8. Ο Συντηρητής πρέπει να διατηρεί ικανή επάρκεια ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων.
9. Θα κατατεθεί βεβαίωση/επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων, ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησής των.
10. Θα κατατεθεί δήλωση/δέσμευση του Οίκου Κατασκευής, που θα δεσμεύεται ότι αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις, με τους ίδιους ακριβώς όρους, της σύμβασης συντήρησης και επισκευής, σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου του έργου να ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο.-

Για το
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Κ.ε.α.



Δ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προϊστάμενος Τμήματος
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Ταχ. Δ/ση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47
Τ.Κ. 10626- ΑΘΗΝΑ
URL: [www.evangelismos-hosp..gr](http://www.evangelismos-hosp.gr)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 46/2012
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 13 Σεπτεμβρίου 2012 Ημέρα : Πέμπτη Ωρα : 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Υψηλάντου 45-47
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	50400000-9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	470.371,67€ με Φ.Π.Α.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	12 μήνες
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου και η ποσότητα παράδοσης δεν θα είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που αντιστοιχεί σε χρόνο κάλυψης αναγκών σε ποσότητες 45 ημερών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.	18/07/2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	19/07/2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	20/07/2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΑΘΗΝΑ 10-6-2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO

Αναλυτικός πίνακας Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού που πρόκειται να καλυφθούν με σύμβαση συντήρησης .

	ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	BM	FM	SERIAL NUMBER	ΤΜΗΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ
1	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:2454 BMM:31062 UCM:16968 FCM:10582	MTN	Με όσμωση WSF:3536 & WRO:8377
2	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:4661 BMM:271 UDM:16948 FCM:9622	MTN	-
3	GAMBRO	AK-95	-	-	5328	MTN	-
4	GAMBRO	AK-95	-	-	5331	MTN	-
5	GAMBRO	AK-95	-	-	5353	MTN	-
6	GAMBRO	AK-95	-	-	5355	MTN	-
7	GAMBRO	AK-100	11684	10607	-	MTN	-
8	GAMBRO	AK-200	5958	4518	-	MTN	-
9	GAMBRO	AK-200	6128	4636	-	MTN	-
10	GAMBRO	AK-200	9048	6682	-	MTN	-
11	GAMBRO	AK-200	9050	6684	-	MTN	-
12	GAMBRO	AK-200	12155	8939	-	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ ΚΟ ΤΜΗΜΑ	Με όσμωση WRO: 1189 & WSF: 101
13	GAMBRO	AK-200S	-	-	16279	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ ΚΟ ΤΜΗΜΑ	Με όσμωση WRO: 1768 & WSF: 101
14	GAMBRO	AK-200S	-	-	16292	MTN	-
15	GAMBRO	AK-200S	-	-	16293	MTN	-
16	GAMBRO	AK-200S	-	-	21822	MTN	-
17	GAMBRO	AK-200S	-	-	21826	MTN	-

1°. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των παραπάνω αναφερόμενου μηχανημάτων , κατά τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου , καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης .
Ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει ISO 9001/2008.

2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο από τον Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση του ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε κάθε τεχνικό που παρακολουθεί τις τακτικές εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν οι διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης και το ISO 13485 που πρέπει να διαθέτει ο συντηρητής .

3. Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν :

α) Την λειτουργική συντήρησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου και ειδικότερα :

- Τον έλεγχο ασφαλείας , μετρήσεις τάσεων παλμών , κλπ.
- Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης .
- Τις αναγκαίες ρυθμίσεις , λιπάνσεις και εσωτερικούς καθαρισμούς των μηχανημάτων .

β) Την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα :

- Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση .
- Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών τα οποία πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE.
- Την λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών .

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή:

- i) Ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός , θύελλες , νερά , κεραυνό, φωτιά). Από χτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή από τρίτους.
- ii) Η αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή από τρίτους.
- iii) Η χρήση ακατάλληλων υλικών για την αποστείρωση, για τον καθαρισμό απασβέστωσης, καθώς και η ελλιπής διαδικασία απασβέστωσης , ή καθαρισμού, πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως αναφέρονται στα Τεχνικά εγχειρίδια .

- iv) Η κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου.
- v) Η κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περιόδων του Νοσοκομείου ή της ΔΕΗ.
- vi) Οι εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.

Εάν ζητηθεί αποκατάσταση των βλαβών , λόγω των παραπάνω περιπτώσεων και εφόσον είναι δυνατόν, η δαπάνη θα συμπεριλαμβάνει τα εργατικά και τα ανταλλακτικά, και θα χρεώνεται χωριστά με βάση τις ισχύουσες τιμές του συντηρητή.

Ο μέγιστος χρόνος αντίδρασης είναι είκοσι τέσσερις (24) ώρες και κατόπιν έγγραφης κλήσεως από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου .

- γ) Την περιοδική συντήρηση των μηχανημάτων , που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από αυτόν, και συγκεκριμένα :
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-10 κάθε 1000 ώρες λειτουργίας ή μία φορά το εξάμηνο τουλάχιστον, καθώς και κάθε 3000 ώρες λειτουργίας ή μία φορά τον χρόνο τουλάχιστον.
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-95
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-100
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-200 κάθε δύο (2) χρόνια το Base-Kit (K40165001) και όποτε απαιτείται το A-Kit (K40166001) και το B-Kit (K40167001) .

- 4. Όλες οι ως άνω εργασίες θα εκτελούνται υπό την εποπτεία αρμόδιου τεχνικού του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες καθώς και τις Κυριακές και τις αργίες.
- 5. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται προγραμματισμένα , ενώ για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών ο Συντηρητής υποχρεούται να επιλαμβάνεται με αποστολή των ειδικευμένων τεχνικών του , εντός δύο (2) ωρών από την λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της συντηρήτριας εταιρείας .
- 6. Ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος τεχνητού νεφρού της σύμβασης , συμφωνείται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες ανά έτος . Σαν χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια αιμοκάθαρσης . Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης .

Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης θα παρατείνεται η σύμβαση κατά επτά (7) ημέρες άνευ ανταλλάγματος.

7. Μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχεται στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίου εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης.
8. Ο Συντηρητής πρέπει να διατηρεί ικανή επάρκεια ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων.
9. Θα κατατεθεί βεβαίωση/επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων, ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησής των.
10. Θα κατατεθεί δήλωση/δέσμευση του Οίκου Κατασκευής, που θα δεσμεύεται ότι αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις, με τους ίδιους ακριβώς όρους, της σύμβασης συντήρησης και επισκευής, σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου του έργου να ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο.-

Για το
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

**CPV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (50400000-9)**

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.	Δικέφαλη τομογραφική Γ' κάμερα Sorpha Medical	Ετήσια	22.878,00 € με ΦΠΑ
2.	Δικέφαλη τομογραφική Γ' κάμερα Sorpha Medical	Ετήσια	22.878,00 € με ΦΠΑ
3.	Μονοκέφαλη τομογραφική Γ' κάμερα Sorpha Medical	Ετήσια	30.919,44€ με ΦΠΑ
4.	Τέσσερα (4) Αναισθ/κά Συγκροτημάτα GE HEALTHCARE (OHMEDA)	Ετήσια	27.020,63 € με ΦΠΑ
5.	Αυτόματο Σύστημα Απομόνωσης DNA/RNA	Ετήσια	2.776,11 € με ΦΠΑ
6.	Εμφανιστήρια-Ψηφιοποιητές-Εκτυπωτές AGFA	Ετήσια	32.454,84 € με ΦΠΑ
7.	Κλίβανοι Ατμού και Πλυντήρια εργαλείων GETINGE	Ετήσια	39.360,00 € με ΦΠΑ
8.	Δεκατρείς (13) Αναπνευστήρες Όγκου Servo-I MAQUET	Ετήσια	29.520,00 € με ΦΠΑ
9.	Δεκαέξι (16) Αναπνευστήρες Όγκου Servo-300 MAQUET	Ετήσια	55.104,00 € με ΦΠΑ
10.	Δεκαπέντε(15) Μηχ/τα Τεχνητού Νεφρού GAMBRO	Ετήσια	57.142,65 € με ΦΠΑ
11.	Ηλεκτρικά κρεβάτια HILL-ROM	Ετήσια	16.140,00 € με ΦΠΑ
12.	Δύο (2) Συστήματα Πρωτοξειδίου Αζώτου (NO)	Ετήσια	11.424,00 € με ΦΠΑ
13.	Ενδοσκοπικός εξοπλισμός Olympus ΙΑΠΩΝΙΑΣ	Ετήσια	122.754,00 € με ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ		470.371,67 € με ΦΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 49^{ης} Συνεδρίας Δ.Σ. της 14-1-2015
Απόφαση 23

Σύμβαση Πλήρους Συντήρησης Μηχανημάτων Τεχνητού
Νεφρού GAMBRO Σουηδίας.

Τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αριθμ. πρωτ.
14/01/4048/24-12-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής
Υπηρεσίας, σχετική με το παραπάνω θέμα, η οποία αναφέρει :

ΣΧΕΤ.: α. Απόφαση 14 της 102 Συνεδρίας Δ.Σ. της 22-11-2013
β. Σύμβαση υπ' αριθμό 3099/2013
γ. Απόφαση 40 Ε.Η.Δ. της 82^{ης} Συνεδρίας Δ.Σ. της 26-7-2013
δ. Προσφορά της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD) με αρ. πρωτ.
4028/23-12-2014
ε. Σχέδιο Σύμβασης

Κύριε Διοικητά:

1. Με την Απόφαση 14 της 102^{ης} Συνεδρίας Δ.Σ. της 22-11-2013 (σχετ.
α), έχει ανατεθεί η συντήρηση (συμπεριλαμβανομένων των
ανταλλακτικών και των Kit των συντηρήσεων) του παρακάτω
αναφερόμενου εξοπλισμού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, στην
Προμηθεύτρια και Αποκλειστική Διανομέα Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD). Το κόστος της
συντήρησης για ένα (1) έτος (Από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ήταν
48.708,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/ α	ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	BM	FM	SERIAL NUMBER	ΤΜΗΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:2454 BMM:31062 UCM:16968 FCM:10582	MTN	Με όσμωση WSF:3536 & WRO:8377
2	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:4661 BMM:271 UDM:16948 FCM:9622	MTN	-
3	GAMBRO	AK-95	-	-	5328	MTN	-
4	GAMBRO	AK-95	-	-	5331	MTN	-
5	GAMBRO	AK-95	-	-	5353	MTN	-
6	GAMBRO	AK-95	-	-	5355	MTN	-
7	GAMBRO	AK-100	11684	10607	-	MTN	-
8	GAMBRO	AK-200	5958	4518	-	MTN	-
9	GAMBRO	AK-200	6128	4636	-	MTN	-
10	GAMBRO	AK-200	9048	6682	-	MTN	-

11	GAMBRO	AK-200	9050	6684	-	MTN	-
12	GAMBRO	AK-200	12155	8939	-	ΝΕΦΡΟΛΟ ΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	<u>Με όσμωση</u> WRO: 1189 & WSF: 101
13	GAMBRO	AK-200S	-	-	16279	ΝΕΦΡΟΛΟ ΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	<u>Με όσμωση</u> WRO: 1768 & WSF: 101
14	GAMBRO	AK-200S	-	-	16292	MTN	-
15	GAMBRO	AK-200S	-	-	16293	MTN	-
16	GAMBRO	AK-200S	-	-	21822	MTN	-
17	GAMBRO	AK-200S	-	-	21826	MTN	-

2. Λόγω της ιδιαιτερότητας, παλαιότητας και ευαισθησίας ως προς τη σωστή χρήση των ποιο πάνω Μηχανημάτων, του υψηλού κόστους των ανταλλακτικών και του υψηλού κόστους προμήθειας των απαιτούμενων οργάνων για τους απαραίτητους ελέγχους από τους Τεχνικούς του Νοσοκομείου, το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ζήτησε από την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD), να καταθέσει πρόταση ανανέωσης της σύμβασης συντήρησης.

3. Σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας, το κόστος συντήρησης (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των Kit συντηρήσεων) για τα παρακάτω μηχανήματα, θα ανέλθει στο ποσό των 47.601,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

	ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	BM	FM	SERIAL NUMBER	ΤΜΗΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ ΕΙΣ
1.	GAMBRO	AK-95	---	---	5328	MTN	-
2.	GAMBRO	AK-95	---	---	5331	MTN	-
3.	GAMBRO	AK-95	---	---	5353	MTN	-
4.	GAMBRO	AK-95	---	---	5355	MTN	-
5.	GAMBRO	AK-100	11684	10607	-	MTN	-
6.	GAMBRO	AK-200	5958	4518	-	MTN	-
7.	GAMBRO	AK-200	6128	4636	-	MTN	-
8.	GAMBRO	AK-200	9048	6682	-	MTN	-
9.	GAMBRO	AK-200	9050	6684	-	MTN	-
10.	GAMBRO	AK-200	12155	8939	-	MTN	<u>Με όσμωση</u> WRO: 1189 & WSF: 101
11.	GAMBRO	AK-200S	---	---	16279	MTN	<u>Με όσμωση</u> WRO:1768 & WSF: 101
12.	GAMBRO	AK-200S	---	---	16292	MTN	-
13.	GAMBRO	AK-200S	---	---	16293	MTN	-
14.	GAMBRO	AK-200S	---	---	21822	MTN	-
15.	GAMBRO	AK-200S	---	---	21826	MTN	-
16.	GAMBRO	AK-200S	---	---	14765	MTN	<u>Με όσμωση</u> WRO: 300 & WSF: 10-9M

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** α) Το Ν° 16 Μηχάνημα GAMBRO του ΠΙΝΑΚΑ 2 περιήλθε στην κυριότητα του Νοσοκομείου μετά από δωρεά (σχετ. γ).
β) Η πλήρη συντήρηση του μηχανήματος GAMBRO AK-100 του ΠΙΝΑΚΑ 2 θα καλύπτεται χωρίς χρέωση.

4. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

-Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί σε 24ωρη βάση 6 ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων και των αργιών.
-Εφόσον καλύπτονται από Σύμβαση Συντήρησης τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανήματα, η ανταπόκριση της εταιρείας σε περίπτωση βλάβης θα είναι εντός δύο (2) ωρών από ειδοποίησής της, το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, προτείνει όπως εγκρίνετε:

- i. Για τον παραπάνω αναφερόμενο εξοπλισμό του ΠΙΝΑΚΑ 2, την σκοπιμότητα σύναψης ετήσιας Σύμβασης Συντήρησης (Από 01-01-2015 έως 31-12-2015) με την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD) που είναι ο Αποκλειστικός Διανομέας των Μηχανημάτων GAMBRO Σουηδίας στην Ελλάδα.
- ii. Το Σχέδιο Σύμβασης (Σχετ. ε).
- iii. Την δαπάνη των **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (47.601,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.** για την πλήρη συντήρηση (επισκευών με ανταλλακτικά και τα Kit των συντηρήσεων) των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του ΠΙΝΑΚΑ 2.
- iv. Την καταβολή της δαπάνης των **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (47.601,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε τέσσερεις (4) τριμηνιαίες δόσεις των ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (11.900,25 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εκάστη, βάσει τιμολογίων που θα εκδίδονται μετά το πέρας του κάθε τριμήνου της Σύμβασης Συντήρησης.-**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δ.ΜΠΗΡΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β.Α.ΓΚΕΡΓΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την απόφαση 14 της 102 Συνεδρίας Δ.Σ. της 22-11-2013, την υπ' αριθμό 3099/2013 σύμβαση, την απόφαση 40 Ε.Η.Δ. της 82^{ης} Συνεδρίας Δ.Σ. της 26-7-2013, την προσφορά της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD) με αρ. πρωτ. 4028/23-12-2014, το σχέδιο Σύμβασης, την κείμενη νομοθεσία, μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, **ομόφωνα**

αποφασίζει-εγκρίνει:

1.Την σκοπιμότητα σύναψης ετήσιας Σύμβασης Συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού GAMBRO Σουηδίας, (για τον εξοπλισμό του Πίνακα 2), από 1-1-2015 έως 31-12-2015, με την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD) που είναι ο Αποκλειστικός Διανομέας των Μηχανημάτων GAMBRO Σουηδίας στην Ελλάδα.

2.Το Σχέδιο Σύμβασης.

3. Δαπάνη ποσού **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (47.601,00 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την πλήρη συντήρηση (επισκευών με ανταλλακτικά και τα Kit των συντηρήσεων) των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του Πίνακα 2.

4.Την καταβολή της δαπάνης των **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (47.601,00 €)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε τέσσερεις (4) τριμηνιαίες δόσεις των **ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (11.900,25 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εκάστη, βάσει τιμολογίων που θα εκδίδονται μετά το πέρας του κάθε τριμήνου της Σύμβασης Συντήρησης.

5.Την ανάρτηση της Σύμβασης στο Διαδίκτυο.

6.Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας/Γραφείο Προμηθειών να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διοικητής
«Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός»
-Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική»

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2015
Ακριβές Αντίγραφο

Γεωργία Κανέλλου
Γραμματέας Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Γραφείο Προμηθειών

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του cookies. Ενημερωθείτε για την πολιτική χρήσης τους [εδώ](#) ().

✓ Ενημερώθηκα



Διαύγεια (lumiview)
διαφάνεια στο κράτος

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



Είσοδος (/login)

Εισάγετε κείμενο για αναζήτ

A- A A+ A++

Σύνθετη αναζήτηση...

Πληροφορίες αναζήτησης... (/searchInfo)

Αρχική > Προβολή Πράξης

Ενέργειες ▾

Υποβολή επισήμανσης

ΑΔΑ

71X94690ΩΧ-ZMT

Κατάσταση

Αναρτηθείσα

Ημερομηνία ανάρτησης

28/01/2015 09:53:00

Τελευταία τροποποίηση

28/01/2015 09:53:00

Ηλεκτρονικό αρχείο

Λήψη αρχείου (<https://diavgeia.gov.gr/doc/71X94690ΩΧ-ZMT>) | Προβολή αρχείου
(<https://diavgeia.gov.gr/doc/71X94690ΩΧ-ZMT?inline=true>)

Είδος

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Θέμα

Σύμβαση Πλήρους Συντήρησης Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού GAMBRO Σουηδίας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-
 ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
 Α.Φ.Μ 999070198
 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
 ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΚΝΩΣΣΟΥ 4 Τ.Κ 72100
 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΞΑΡΑ
 ΤΗΛ:2841343174
 FAX:284108328
 www.agnhosp.gr
 e-mail: gkoxara@agnhosp.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5402/23-6-2015	
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
Για την παροχή υπηρεσιών :	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού
Κωδικός CPV	50421000-2
Με κριτήριο κατακύρωσης :	ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) :	73.000,00 ευρώ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 28 Ιουλίου 2015 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11 πμ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γραφείο Προμηθειών Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014	50421000-2
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.	ΚΑΕ 887
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	73.000,00 € (συμπ/νου του ΦΠΑ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.agnhosp.gr)	26/6/2015

Έχοντας υπόψη:**1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:**

- Του **N. 2286/1995** (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 145/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
- Του **Π.Δ. 118/2007** (ΦΕΚ Α' 150/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.».
- Του **N. 2362/95** (ΦΕΚ Α' 247/1995) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- Του **N. 2741/1999** (ΦΕΚ Α' 199/1999), άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».
- Του **N. 2955/2001** (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και

λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»), όπως ισχύει σήμερα.

6. Του **N. 3329/2005** (ΦΕΚ Α' 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
7. Του **N. 3527/2007** (ΦΕΚ Α' 25/9.2.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
8. Του **N. 3580/2007** (ΦΕΚ Α' 134/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
9. Του **Π.Δ. 166/2003** (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
10. Του **N. 3846/2010** (ΦΕΚ Α' 66/11-5-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24.
11. Του **N 3861/2010** (ΦΕΚ Α' 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
12. Του **N. 3867/2010** (ΦΕΚ Α' 128/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», άρθρο 27.
13. Του **N. 3868/2010** (ΦΕΚ Α' 129/3-8-2010) τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
14. Του **N. 3918/2011** (ΦΕΚ Α' 31/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
15. Το **N. 4013/2011** (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.

1. **Το Ν. 4052/2012** (ΦΕΚ Α 41/1.3.2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
2. **Τον Ν. 4281/2014** (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

2. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ. 5804/24-11-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3261Β/4-12-2014) περί Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό πρ/σμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
2. Την υπ' αριθμ. 6484/30-12-2014 Υ.Α (ΦΕΚ 3693Β/31-12-2014 «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014 πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών – Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2010, 2011 και 2013.)
3. Την υπ' αριθμ. 352/8-6-2015 Απόφαση του Διοικητή 7^{ης} Υ.Πε. Κρήτης.
4. Την με αρ. 11081/14.12.2011 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των φορέων του αρ. 9 παρ. 1 του Ν. 3580/07» (ΦΕΚ

2957B/23.12.2011).

5. Το με ΑΠ 2397/21.3.2012 έγγραφο της ΕΠΥ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
6. Το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της ΕΠΥ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
7. Την υπ' αριθμ. 335/27-5-2015 απόφαση του Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο τακτικό ανοικτό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση των

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Α' με κωδ. **50421000-2** του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 Πιστώσεις 2015 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 887 και αναλυτικά :

1. **ΤΜΗΜΑ Α:** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ FRESENIUS ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 37.000,00 ΕΥΡΩ
2. **ΤΜΗΜΑ Β:** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 24.000,00 ΕΥΡΩ
3. **ΤΜΗΜΑ Γ:** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 12.000,00 ΕΥΡΩ

Άρθρο 1^ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από κανονική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο και στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση/ανάρτηση:

- Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημ. Συμβάσεων» της Εφημερ. της Κυβέρνησης στις 23/6/2015 όπου θα δημοσιευθεί στις 26/6/2015
- Στον ελληνικό τύπο στις 23/6/2015 όπου και θα δημοσιευθεί στις 26/6/2015
- Στην ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ στις 23/6/2015, στους Πίνακες Ανακοινώσεων του

ΓΝΑΝ, του Τοπικού Επιμελητηρίου και του Δήμου Αγ. Νικολάου στις 23/6/2015.

Αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ στις 26/6/2015.

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας βαρύνουν το Νοσοκομείο στις δε τοπικές εφημερίδες βαρύνουν τους αναδόχους.

- Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.agnhosp.gr (Προκηρύξεις Διαγωνισμών) στις 26/6/2015 απ' όπου θα διατίθεται αποκλειστικά.
- Η αναθέτουσα αρχή θα διατηρεί ειδικό κατάλογο, στον οποίο θα καταγράφονται όσοι παραλαμβάνουν την διακήρυξη, προς ενημέρωσή τους σε περίπτωση που χρειαστεί να τους ενημερώσει για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού. Όσοι παραλαμβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να αποστέλλουν σχετικό έγγραφο αίτημα ένταξής τους στον ειδικό αυτό κατάλογο (με φax στο 2841083327 ή με e-mail στα: gkochara@agnhosp.gr), συμπληρώνοντας το έντυπο του παραρτήματος Γ', στο οποίο θα καταγράφουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και θα υπογράφουν, θα αναγράφεται δε ακόμη και η ημερομηνία παραλαβής της διακήρυξης.

Άρθρο 2^ο

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Πρωτοκόλλου της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος	27 Ιουλίου 2015 Δευτέρα ΩΡΑ: 2:30 μμ	Γραφείο Προμηθειών Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος	28 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη ΩΡΑ: 11:00 πμ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού.
2. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:
 - α) Τα μέλη της επιτροπής
 - β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης).

Άρθρο 3ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

- α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) Συνεταιρισμοί
- γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- δ) Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Άρθρο 4ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής** στον διαγωνισμό ίση με το **2%** της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή 1.187,00 ευρώ εφόσον ο υποψήφιος θα συμμετέχει στον διαγωνισμό για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. Εφόσον θα συμμετέχει προμηθευτής σε ορισμένες μόνο από τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες, η εγγυητική επιστολή μπορεί να αφορά μόνο τις υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο παράρτημα Γ' της παρούσας διακήρυξης.
2. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86** (Α'75), άρθρου 8, παρ. 4 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :
 - 2.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή η διαδικασία ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν.
 - 2.2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 - 2.2.1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα (του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ. 60/2007) δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 - 2.2.2. Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 - 2.2.3. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
 - 2.2.4. Δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από

τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

- 2.2.5.** Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. του αρ. 43 του ΠΔ 60/2007 καταστάσεις, δηλ. σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
- 2.2.6.** Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας & επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- 2.2.7.** Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση ότι θα προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του.
- 2.2.8.** Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) & επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
- 2.2.9.** Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη & προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ. 6 του ΠΔ 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο αρ. 6 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 20 του ΠΔ 118/2007. Τα δικαιολογητικά αυτά θα τα προσκομίσουν μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση από την αναθέτουσα αρχή και μόνο από τον προς όν η κατακύρωση.
- Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

3. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
- 3.1.** Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 - 3.2.** Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - 3.3.** Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.
 - 3.4.** Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - 3.5.** Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - 3.6.** Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
4. **Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο** τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους **παραστατικό εκπροσώπησης**.
5. Υπεύθυνη **Δήλωση** της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86(Α'75) όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με την οποία υποχρεούνται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα του προμηθευτή, ΠΔ.118/2007 άρθρο 8 παρ. 2, που απαιτούνται στο στάδιο της κατακύρωσης.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται **η χώρα καταγωγής του** τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ 118/2007
2. **Υπεύθυνες Δηλώσεις** που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 :
- 2.1.** Ο προσφέρων, εφόσον **κατασκευάζει ο ίδιος** το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.
 - 2.2.** Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της.
 - 2.3.** Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς

τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιοδήποτε λόγο, ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 118/2007, άρθρο 18.

3. Σε περίπτωση που κατατεθούν δείγματα το αντίγραφο του Δελτίου αποστολής των Δειγμάτων θα κατατίθεται με την τεχνική προσφορά

4. Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας :

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO
- CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων.
- Με τα οποία θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.
- Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη.
- Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών μόνο οι προμηθευτές στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και παραλαβής της ειδοποίησης, τα εξής δικαιολογητικά :

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του **τελευταίου τριμήνου** πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

- α)** συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- β)** δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- γ)** απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- δ)** νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),
- ε)** Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

2. **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής** (έκδοσης του **τελευταίου εξαμήνου**) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3. **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής** (έκδοσης του **τελευταίου εξαμήνου**) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό.
4. **Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή**, από το οποίο να προκύπτει ότι **κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης**, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής** στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
6. **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου** ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, **κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού**, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.α' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

- α)** Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
- β)** Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
- γ)** Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
- δ)** Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
- ε)** Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση **αποτελεί ένωση υποψηφίων προμηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά**, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης-από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 - Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλ.
 - Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
 - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του0 χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 - Αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ,κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης.

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α & Β αντίστοιχα.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α'101) όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπο άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
3. Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των Ε.Π.Ε και των προσωπικών εταιρειών Ο.Ε και Ε.Ε και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης ,από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περιπτώσεως 1 του εδαφίου Α.

Επί ημεδαπών Α.Ε τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της εκδίδονται όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ,στο μητρώο Α.Ε της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7^α.1ιά αι 7β.12 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ,από το αρμόδιο εφετείο της έδρας της Α.Ε που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε & Ε.Ε) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης-από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ του δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :
 - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

- Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μάιου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλ.
 - Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
 - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 - Αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
4. Επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά εφόσον πρόκειται για **ημεδαπούς συνεταιρισμούς**.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
 - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2 &3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Εφόσον πρόκειται για **αλλοδαπούς συνεταιρισμούς** :

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του παρόντος δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής :

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νόμιμες καταστάσεις.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Προκειμένου να διαπιστωθεί η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση καθώς και οι τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. **Κατάλογο**, στον οποίο αναφέρονται οι **κυριότερες παραδόσεις** των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.
2. Περιγραφή του **τεχνικού εξοπλισμού** της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών και κατά το διάστημα λειτουργίας αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο τζίρο της τελευταίας τριετίας της τάξεως του 30% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος τζίρος για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι της τάξεως του 30% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι :

- Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.
- Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. ή των ακριβών αντιγράφων τους.
- Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της προηγούμενης παραγράφου.

- Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
- Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει:

α. Να υποβάλλονται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, **δηλαδή μέχρι 27/7/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30 μμ.**

β. Να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι **27/7/2015** (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες**, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με **τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες**.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Οι Υποψήφιοι προμηθευτές **δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους**, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος **υπόκειται σε κυρώσεις** και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα σε έντυπη μορφή.

Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3 Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

2.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5 Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1 **ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** (πρωτότυπα και αντίγραφα) που αναφέρονται στο Άρθρο 4, της παρούσης και η **εγγυητική συμμετοχής** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»**.

3.2 **ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς (Πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο σε έντυπη μορφή, με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:

- **ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ** που αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσης
- Τα Προσφερόμενα είδη και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά τους με αναφορά στην αρίθμηση που φέρει καθένα από αυτά στο παράρτημα Α της παρούσας:.
- Τα εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS φωτογραφίες, τεχνικών φυλλαδίων, εγχειρίδια κ.λ.π.)
- Τα πιστοποιητικά τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας και τις δηλώσεις του άρθρου 5.
- Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, συμπληρωμένο κατά το συνημμένο στην

διακήρυξη υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών.

- Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού.

3.3 **ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο σε έντυπη μορφή με την ένδειξη **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**.

4. Επισημαίνεται ότι :

- 4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις **ενδείξεις του κυρίως φακέλου**.
- 4.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»** και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 4.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη **«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα»**. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
- 4.4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να **είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική** γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
- 4.5. Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προμηθευτή, θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά

στοιχεία που ορίζει η διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα-συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με τις ενδείξεις «**κύρια προσφορά**» και «**αντίγραφο προσφοράς**»

- 4.6. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. **Παραπομπές σε έγγραφα** επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
- 4.7. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δΐξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- 4.8. Αντιπροσφορές ή Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης.
- 4.9. **Διευκρινίσεις** που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
- 4.10. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή **διορθώσεις** οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
- 4.11. Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά σε μέρος ή στο σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού (Παράρτημα Α).
- 4.12. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι **αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης**

και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αποσφράγισης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του ΠΔ 118/2007 διαδικασία.

Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

1. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο **φάκελος των δικαιολογητικών** καθώς και ο φάκελος της **τεχνικής προσφοράς**, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διενέργειας & Αποσφράγισης του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) ή με τη χρήση μηχανικού μέσου (διατρητή) θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.
- Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.
- Η Επιτροπή Διενέργειας & Αποσφράγισης καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.
- Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

2. Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,

στους Προσφέροντες θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

3. Μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ενημερώνονται όλοι οι προμηθευτές που συμμετέχουν στην οικονομική αξιολόγηση με έγγραφη ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των **φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης**, προκειμένου να λάβουν γνώση.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ζητούνται μόνο από αυτούς που έχουν αναδειχθεί από την οικονομική αξιολόγηση ως υποψήφιοι προμηθευτές, προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο Διενέργειας & Αποσφράγισης των προσφορών.

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική έγγραφη ανακοίνωση.

4. Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών, τιμών που προσφέρθηκαν) εντός πέντε ημερών μετά από κάθε αποσφράγιση και ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή. Στην έντυπη οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά και η τιμή και ο κωδικός του υλικού, αν υπάρχει, στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών. Εάν δεν υπάρχει το είδος στο Παρατηρητήριο Τιμών, ο προμηθευτής θα το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή που θα επισυνάπτει στην οικονομική του προσφορά.

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προσφερόμενη τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα μέτρησης όπως ζητείται στη διακήρυξη (ανά τεμάχιο, σετ κ.λ.π.) επί ποινή απόρριψης.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθεί από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή είναι ανώτερη από την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.

Άρθρο 12ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την τελική επιλογή του ανάδοχου λαμβάνεται υπόψη:

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- 3 Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
4. Συγκριτικά στοιχεία τιμών.

Άρθρο 13ο

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει :

Α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%.

Β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

- i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό. ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

Άρθρο 14ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με χρόνο ισχύος 15 μήνες από την έκδοσή της. Το ύψος της εγγύησης, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, θα προσδιοριστεί με την ανακοίνωση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρ. 25 παρ. 5 του ΠΔ 118/2007. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης.

Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Άρθρο 15ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
- Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
- Δ. Την τιμή
- Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
- ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
- Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
- Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Σχέδιο της προς υπογραφή σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 16^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί για ένα τρίμηνο μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η συγκατάθεση του προμηθευτή και με τους εξής όρους:

Α) Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Β) Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ' αναλογία.

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του

προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 17ο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 18ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση του Νοσοκομείου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση του Νοσοκομείου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση, την κακή εκτέλεση ή την παράβαση όρων της σύμβασης.

Άρθρο 19ο

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 2286/95 και το ΠΔ 118/07.

Τόπος παράδοσης των υλικών όπως θα ορίζει και η σύμβαση είναι οι αποθήκες του Νοσοκομείου μας.

Άρθρο 20^ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 21ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα γίνεται από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) και εντός δύο μηνών από την κατάθεση των τιμολογίων.

Τα έγγραφα αυτά θα προσκομίζονται στην οικονομική υποδιεύθυνση του νοσοκομείου και αφού θα ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας, θα προχωρούν στην έκδοση εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα θεωρείται αρμοδίως.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους είναι οι εξής:

Υπέρ ψυχικής υγείας 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/07

Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης (αρ. 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011)

Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Άρθρο 22°

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 23°

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Αγίου Νικολάου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ
FRESENIUS ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 601,62 ΕΥΡΩ

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα δέκα (10) μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESENIUS της Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου μας.

Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο μας .

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESENIUS με ανταλλακτικά του κατασκευαστικού οίκου .

Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει δύο (2) συντηρήσεις κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους (μία ανά εξάμηνο). Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργασιών ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο) με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν., μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου FRESENIUS .

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου , θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESSENIUS του Νοσοκομείου μας.

Το τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχανήματα τεχνητού νεφρού τον μήνα και θα περιλαμβάνει όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε περίπτωση που κάποιο μηχανήματα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως .

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας.

**ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ
GAMBRO ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 390,24 ΕΥΡΩ

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα επτά (7) μηχανήματα τεχνητού νεφρού (επτά μηχανήματα AK 200) του οίκου GAMBRO της Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου μας.

Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο μας .

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ ,πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.

Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) συντηρήσεις κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους (μία ανά τρίμηνο).Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργάσιμων ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο) με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν. , μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου GAMBRO .

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα)που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου , θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας,

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου GAMBRO του Νοσοκομείου μας.

Η τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχανήμα τεχνητού νεφρού τον μήνα και θα περιλαμβάνει όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε περίπτωση που κάποιο μηχανήμα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ Νοσοκομείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ**ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.****ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 195,12 ΕΥΡΩ**

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για την συντήρηση του κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100 S των Χειρουργείων του Νοσοκομείου μας.

Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο μας.

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στον προαναφερόμενο κλίβανο με αμεταχείριστα ανταλλακτικά του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση μέσα σε 24 ώρες εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης (ΕΠΠΕΔΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΠΕΔΟΥ Ε2) και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε με τους κωδικούς τους,

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (ΕΠΠΕΔΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΠΕΔΟΥ Ε2) θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κλιβάνου λόγω βλάβης ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος. Στον χρόνο αυτό δεν υπολογίζεται ο χρόνος για την προληπτική και την επανορθωτική συντήρηση του κλιβάνου.

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας,

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD του Νοσοκομείου μας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1

Θα γίνει με την συμπλήρωση 6 μηνών ή 750 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση επιπέδου Ε2 και **θα περιλαμβάνει**

1) PM 1 kit

2)Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης , Αλλαγή λαδιών αντλίας κενού , Καθαρισμό vaporizer κλιβάνου , Απομάκρυνση νερού από δοχείο συλλογής αέρα, Απομάκρυνση υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης, Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού ,καθαρισμός των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2

Με την συμπλήρωση 12 μηνών ή 2250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση επιπέδου Ε2 **και θα περιλαμβάνει**

1) PM1 kit και PM2 kit

2)Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης , Αλλαγή λαδιών αντλίας κενού , Καθαρισμό vaporizer κλιβάνου , Απομάκρυνση νερού από δοχείο συλλογής αέρα, Απομάκρυνση υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης, Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού ,καθαρισμός των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος , Έλεγχος λειτουργίας ρυθμιστή πίεσης ,Αντικατάσταση καταλυτικού φίλτρου και του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού, Αντικατάσταση του φίλτρου HEPA ,Καθαρισμό της πόρτας του κλιβάνου ,Αντικατάσταση δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου, Αντικατάσταση

Των STOP στους οδηγούς του ραφιού του θαλάμου, Αντικατάσταση των μονωτικών αποστατών του ηλεκτροδίου .

3)Πιστοποίηση του κλιβάνου από τον κατασκευαστικό οίκο .

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

Αναβαθμίσεις - Διορθωτικές επεμβάσεις - Τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το Νοσοκομείο καθώς επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-
ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Α.Φ.Μ 999070198
Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.)	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα την ημέρα στην Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο, οδός Κνωσού, αρ. 4, οι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός μεν ο κ. Εμμανουήλ Μακρονικολάκης, Πρόεδρος του Δ. Σ. και Διοικητής του Νοσοκομείου και νόμιμος εκπρόσωπός του και αφ' ετέρου η εταιρεία, που εδρεύει στο, οδός αρ., ΤΚ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον, ..., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος στο εξής θα αποκαλείται χάρη συντομίας «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» ενώ ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα αποκαλείται «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ».

Την το Νοσοκομείο διενήργησε Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» σύμφωνα με την αριθμ. 335/27-5-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου εγκρίθηκε το πρακτικό δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού και κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας για τα είδη που αναφέρονται στην σύμβαση.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου εγκρίθηκε το πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε η προμήθεια των αναφερόμενων στην σύμβαση ειδών στην προμηθεύτρια εταιρεία.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης δικαιολογητικών του διαγωνισμού στην συμβαλλόμενη προμηθεύτρια αντί συνολικού ποσού € (συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με την προσφορά της και με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους περί προμηθειών του Δημοσίου όπως εκάστοτε ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και δεσμεύει τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Ήδη με την παρούσα ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την ετήσια συντήρηση για ένα έτος στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

1. Το Νοσοκομείο αναθέτει στην εταιρεία την ετήσια συντήρηση αντί του συνολικού ποσού των ευρώ.
2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την συντήρηση και επισκευή των οκτώ (8) μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού FRESENIUS του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:

- Ι. **«Προληπτική συντήρηση»** είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών, υδραυλικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας των μηχανημάτων

- II. **«Επανορθωτική συντήρηση»** είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
- III. **«Κανονικές μέρες εργασίας»** θεωρούνται: Οι από Δευτέρα έως και Σάββατο εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του Κράτους.
- IV. **«Ανωτέρα βία»** σημαίνει και θα περιλαμβάνει κάθε γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο, που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμη και με την λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης εκατέρου των συμβαλλομένων μερών, συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, Κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και (ή) εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.
- V. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
- VI. Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για τα μηχανήματα (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

Σε περίπτωση που ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ» οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης στα μηχανήματα συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων (αναλωσίμων και μη αναλωσίμων) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες αυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΤΥΠΟΣ	

1.		

ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

1. Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται προς τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ από το Νοσοκομείο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι ως εξής:
 - (Η κατά μήνα επιβάρυνση του Νοσοκομείου για την συντήρηση κάθε μηχανήματος θα είναι: πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.)
 - Άρα η ανά μήνα επιβάρυνση του Νοσοκομείου για τα μηχανήματα είναι .:€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
 - Συνεπώς η ετήσια επιβάρυνση του Νοσοκομείου θα είναι€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
2. Η εξόφληση της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων, που είναι οι εξής:
 - Υπέρ ψυχικής υγείας 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/07
 - Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης (αρ. 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011)
 - Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

Η εξόφληση θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του ΠΔ 166/2003.

Ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων επιβαρύνει το Νοσοκομείο.
3. (Σε περίπτωση που τεθεί εκτός λειτουργίας κάποιο μηχάνημα ή προστεθεί κάποιο άλλο, το κόστος της συντήρησης θα διαμορφωθεί ανάλογα.)
4. Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής & επανορθωτικής συντήρησης συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της παρούσας σύμβασης.
5. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την έως τις Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί, με τους ίδιους όρους

και τιμές, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους τρεις πρώτους μήνες παράτασης, μετά την λήξη της σύμβασης. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η συγκατάθεση του προμηθευτή και με τον όρο ότι η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες συνολικά. Σε περίπτωση παράτασης σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι της σύμβασης και η τιμή της.

6. Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση παροχής των υπηρεσιών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

ΑΡΘΡΟ 4^ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Επιφυλασσόμενων των όρων και προϋποθέσεων των όλων όσων γράφονται στην παρούσα σύμβαση το Νοσοκομείο συμφωνεί στις ακόλουθες ενέργειες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

1. Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να τα χειρίζεται και να τα χρησιμοποιεί προσεκτικά προφυλλάσσοντάς τα από οποιαδήποτε ζημιά.
2. Να γνωστοποιεί άμεσα και έγκαιρα στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
3. Να εξασφαλίζει ώστε όλη η προληπτική ή επανορθωτική συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
4. Να διευκολύνει την είσοδο των Τεχνικών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την παροχή των υπηρεσιών στους ανάλογους χώρους του Νοσοκομείου, καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση της προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης.
5. Να παρέχει στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ χωρίς επιβάρυνση επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία.
6. Να καταγράφει όλες τις εμπειρίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων Οι παρατηρήσεις αυτές διευκολύνουν στον

εντοπισμό προβλημάτων και επιδιόρθωσης τους όπως και την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Επιφυλασσόμενων των όρων και προϋποθέσεων των όλων όσων γράφονται στην παρούσα σύμβαση ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ συμφωνεί να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες συντήρησης κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

1.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανωτέρα βία το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν την αιτία που προκαλεί την ανωτέρα βία.
2. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τους τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο με έγγραφη γνωστοποίηση.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα του Νοσοκομείου μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, σε περίπτωση δε που το Νοσοκομείο ζητήσει από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των εργατικών και των ανταλλακτικών θα χρεώνονται ξεχωριστά βάσει των ισχυουσών τότε τιμών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

1. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής των μηχανημάτων από θεομηνίες (πλημμύρα, φωτιά, κεραυνός, σεισμός κ.λπ.)

2. Από κακή χρήση των μηχανημάτων από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτους καθώς επίσης από πτώση ή χτυπήματα των μηχανημάτων.
3. Λοιπές εργασίες όπως μεταφορά των μηχανημάτων σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου κ.λπ.
4. Κακόβουλες ενέργειες τρίτων

Όλους τους παραπάνω όρους αποδέχονται τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και προς επικύρωση τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΑΡΘΡΟ 5° ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον Προμηθευτή να εκχωρήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.

Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και έχει εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 6°: ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η τροποποίηση θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Αγίου Νικολάου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση) προς τους Οίκοι του εξωτερικού που εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 9° ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμογή έχουν οι νόμοι περί Προμηθειών του Δημοσίου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε σε δύο αντίγραφα, και έλαβε ο καθένας των συμβαλλομένων από ένα νόμιμα υπογεγραμμένο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εκδότης: _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Οδός ΚΝΩΣΟΥ αρ. 4 , Τ.Κ. 72100, Πόλη ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εγγύηση μας υπ' αριθμόν _____ για ευρώ _____

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των _____ ευρώ υπέρ της Εταιρείας _____, οδός _____, αριθμός _____ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) _____, (2) _____

_____, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της _____ δια την προμήθεια ειδών «Χειρουργικά Είδη και εργαλεία μιας χρήσης» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με την υπ' αριθμ. _____ Διακήρυξη.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την _____ (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη)

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης: _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

**Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Οδός ΚΝΩΣΟΥ αρ. 4 , Τ.Κ. 72100, Πόλη ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εγγύηση μας υπ' αριθμόν _____ για ευρώ _____

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών _____, οδός _____, αριθμός _____, σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ' αρ. σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση , συνολικής αξίας , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ποσού _____

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα _____ παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) _____, 2) _____

_____ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την _____

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ:
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
Άγιος Νικόλαος
Κνωσσού 4
ΤΚ 72100

Δηλώνω ότι παρέλαβα την υπ' αριθμ. διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας (για λογαριασμό της κάτωθι εταιρείας) και παρακαλώ για την εγγραφή της στον ειδικό κατάλογο που διατηρεί η υπηρεσία σας, και για την ενημέρωσή μας για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί του ανωτέρω διαγωνισμού.

Επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου	
Διεύθυνση	
Τηλέφωνο	
Φαξ	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	
Ημερομηνία παραλαβής της διακήρυξης	

Τόπος, ημερομηνία
Υπογραφή αιτούντος
Σφραγίδα εταιρείας, ονοματεπώνυμο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Αντιγραφή Ζητούμενης Τεχνικής Προδιαγραφής της Υπηρεσίας από τη Διακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται στα Παράρτημα Α΄ της παρούσας	Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ” Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ”	Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής Προδιαγραφής της Προσφερόμενης Υπηρεσίας από τον Υποψήφιο Ανάδοχο	
Για παράδειγμα:			
1. Να διαθέτει Τάση τροφοδοσίας 220volts/50Hz.	ΚΑΛΥΠΤΕΙ	Το προσφερόμενο σύστημα Χ του κατασκευαστικού οίκου Υ διαθέτει τάση τροφοδοσίας 220volts/50Hz.	Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4

- Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας από τη Διακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στο παράρτημα Α της παρούσας Διακήρυξης.
- Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΚΑΛΥΠΤΕΙ", αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ" ενώ αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ".
- Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική Προδιαγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
- Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).
- Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
- Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.



Ι.Π Μεσολογίου 20-3-2015

Αριθμ. Πρωτ: 2860

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Οδός Ναυπάκτου
Ταχ. Κώδικας : 30200
Πληροφορίες : Κουντσοπούλου Χριστίνα
Τηλ. : 2631360185
Fax : 2631360107

ΣΧΕΔΙΟ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρη Διαγωνιστική Διαδικασία με ανάρτηση για :

1. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΜΗΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (Από 1-4-2015 έως και 31-7-2015, συνολικού Προϋπολογισμού 9.400,00€ με ΦΠΑ)».

Σχετ.: α. Το Π.Δ 118/07 άρθρο 22.

β. Το Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

γ. Ο Ν.2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 13, εδαφ. V.

δ. Η με Αριθμ. πρωτ. 4516/4-6-2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο 1 της Ε.Π.Υ

ε. Το με Αριθμ. πρωτ. ΓΠΠΓ οικ. 68005/8-06-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΥΚΑ.

στ. Την με αριθμ. πρωτ: 2856/20-3-2015 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών.

ζ. Την υπ' αριθμ. 60/20-3-2015 απόφαση έγκρισης Διοικητή για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί σε προμήθεια και παροχή υπηρεσίας με πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά των παρακάτω εργασιών, άκρως απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις **27/3/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.** , σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφετε η φράση «οικονομική προσφορά» το θέμα και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου). Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί την προσφορά τους να υποβάλλουν και τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.
- Να δηλώνεται υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος για τις εργασίες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να τις εκτελέσει σε χρονικό διάστημα που θα του ορίσει το Νοσοκομείο.

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-6-2003.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για επιπλέον πληροφορίες. (τηλ. 2631360178).

Η σύμβαση θα έχει ισχύ 4 μήνες με δικαίωμα μονομερούς παράτασης δύο μηνών. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού παύει να ισχύει.

Ο προμηθευτής που θα υπογράψει σύμβαση, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βάσει του άρθρου 25 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 και η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

α) Για την τετράμηνη κάλυψη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης δύο μηνών βλαβών/συντήρησης 8 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO της MTN. Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται η εργασία και μετακίνηση τεχνικών και όχι τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά. (AK-95S-21336, AK-95S-21337, AK-200S-15753, AK200-6802, AK200-6749, AK200-6801, AK200-6763, AK200S-208333). (Προϋπολογισμού 5.700,00€ με ΦΠΑ)

β) Για την τετράμηνη κάλυψη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης δύο μηνών βλαβών/συντήρησης 5 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού FRESenius της MTN. Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται η εργασία και μετακίνηση τεχνικών και όχι τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά. (FRESenius 4008B-8V5AC524, FRESenius 4008B-8V5AC519, FRESenius 4008B-8V5AC517, FRESenius 4008B-8V5AC512, FRESenius 4008B-8V5AC537). (Προϋπολογισμού 3.700,00€ με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογίου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, απαιτείται η σύναψη σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία. Τα Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης που θα καλύπτονται από τη σύμβαση συντήρησης και επισκευής είναι τα ως άνω. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

01. Προληπτική Συντήρηση

Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει συντηρήσεις σε κάθε ένα από τα μηχανήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Γενικότερα θα πρέπει μετά από κάθε προληπτική συντήρηση να πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις γι' αυτές τις συντηρήσεις, θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

02. Αποκατάσταση Βλάβης

Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

03. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)

Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

04. Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τρίτη Πέμπτη από 07:20 έως 14:40 που δεν λειτουργεί η Μονάδα). Εξαιρούνται οι ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή.

05. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο.

06. Ανταλλακτικά

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης αυτών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης **θα καλύπτονται από το Νοσοκομείο με ξεχωριστή έγκριση δαπάνης**. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα.

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του συντηρητή ένα επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξάρτηματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.

07. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανημάτων.

08. Τηλεφωνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

09. Απόσυρση Μηχανήματος

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι' αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή ή τροποποίηση της σύμβασης.

10. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεση του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημόσιου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

11. Φύλλο Συμμόρφωσης

Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο απαιτήσεων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γρ. Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Ναυπάκτου
Τηλ. 2631360185
Φαξ: 2631360107

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.09.21 14:22:42
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΓΒΗ46907Π-ΣΝ7

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μεσολόγγι : 21-09-2015
Αριθμ. Πρωτ. : 8834
ΑΔΑ : ΩΓΒΗ46907Π-ΣΝ7

ΠΡΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ –GAMBRO N.M.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» διάρκειας τριών (3) μηνών προϋπολογισμού δαπάνης 4.250,88 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ”

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε κλειστή τεχνική και οικονομική προσφορά για τα κάτωθι το αργότερο έως 24/09/2015 ώρα 11:00 π.μ., η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 24/09/2015 στις 12:00 μ.μ.. Με τον μειοδότη θα υπογραφεί 3μηνη σύμβαση με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός μηνός βλαβών/συντήρησης των 8 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO της MTN. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται η εργασία και μετακίνηση τεχνικών και όχι τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά. (AK-95S-21336, AK-95S-21337, AK-200S-15753, AK200-6802, AK200-6749, AK200-6801, AK200-6763, AK200S-208333). ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 1/10/2015-31/12/2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, απαιτείται η σύναψη σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία. Τα Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης που θα καλύπτονται από τη σύμβαση συντήρησης και επισκευής είναι τα ως άνω. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

01. Προληπτική Συντήρηση

Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει συντηρήσεις σε κάθε ένα από τα μηχανήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Γενικότερα θα πρέπει μετά από κάθε προληπτική συντήρηση να πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις γι' αυτές τις συντηρήσεις, θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

02. Αποκατάσταση Βλάβης

Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

03. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)

Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μηχανήματα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

04. Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τρίτη Πέμπτη από 07:20 έως 14:40 που δεν λειτουργεί η Μονάδα). Εξαιρούνται οι ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή.

05. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο.

06. Ανταλλακτικά

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης αυτών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης **θα καλύπτονται από το Νοσοκομείο με ξεχωριστή έγκριση δαπάνης**. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα.

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του συντηρητή ένα επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξαρτήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.

07. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανημάτων.

08. Τηλεφωνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

09. Απόσυρση Μηχανήματος

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να

ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι' αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή ή τροποποίηση της σύμβασης.

10. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεση του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημόσιου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

11. Φύλλο Συμμόρφωσης

Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο απαιτήσεων.

Ευχαριστούμε



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πειραιάς: 13-06-2014

2^η Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"

Αριθμ. Πρωτ. 6811

Αριθμ. Διακήρυξης 6

ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

Ταχ. Δ/ση : Αφεντούλη & Ζαννή ,
Τ.Κ 185 36

Πληροφορίες: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο : 210 4592 160
FAX 210 4592 597

13-06-2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 6 / 2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ανοικτός δημόσιος Διαγωνισμός ή..... Η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία: 17-07-2014 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ωρα: 10 π.μ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	16-07-2014 ΩΡΑ 13.00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΩΔΙΚΟΣ GMDN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γρ. Προμηθειών Σύμφωνα με συνημμένη κατάσταση ...50400000-9.....(# 58.671,00 # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Σύμφωνα με συνημμένη κατάσταση
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.	ένας(1) χρόνος..... Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΣΗΜΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:	...13-06-.2014 ... 13-06-2014 Γ.Ν.Π «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΓΡ. ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΖΑΝΕΙΟΥ www.tzaneio.gr

Έχοντας υπόψη:**1. Τις διατάξεις όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί:**

- Της Α3α/οικ./10358/92 (ΦΕΚ 681/Β.20-11-92) Απόφαση Υ.Π.Π.Κ.Α. “Αρμοδιότητες Δ.Σ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων”.
- Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) “Προμήθειες Δημ. Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”.
- Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) “Περί Δημόσιου Λογιστικού”.
- Του Ν. 2889 (Φ.Ε.Κ. 37/2-3-2001) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 2955 (Φ.Ε.Κ. 256/2-11-2001) Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
- Του Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28-9-1999).
- Του Ν. 3204/03 (Φ.Ε.Κ. 296/23-12-03) Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθν. Σύστημα Υγείας και άλλων θεμάτων.
- Του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. 279/10-11-05). Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
- Του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/4-4-05).
- Του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. Α25Τ/9-2-07).
- Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16-3-07).
- Του Ν. 3580/07 (Φ.Ε.Κ. 134/18-6-07). Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υ.Υ.& Κ.Α. και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 3204/03.
- Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/10-7-07). Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. (Κ.Π..Δ.).
- Του Ν.3867 / 2010 (Φ.Ε.Κ 128/ 3-08-2010 τ. α')
- Ν. 4152 / 2013 (107 / 9-5-2013)
- 18 / 10-10-2012 Απόφαση Ε.Π.Υ (Α.Π 965 / 26-03-2013) «Κόστη ετήσιου συμβολαίου πλήρους συντήρησης Ιατρικών Συστημάτων με εγκεκριμένες από την Ε.Π.Υ προδιαγραφές»

2. Την με Αριθμ. πρωτοκ. 6881 / 3-10-2012 Απόφαση της Ε.Π.Υ (Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας(Π.Π.Υ.Υ) έτους 2012 και 2013

3 . Την με αριθμ. 5572/24-10-2013 Απόφαση Παράτασης Π.Π.Υ.Υ 2012

4. Το με Αρ. πρωτ. 13134 / 24-05-2013 έγγραφο 2^{ης} Δ.Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου περί καθορισμού Φορέα υλοποίησης για διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ 2012

5. Το με αριθμ. πρωτ. 15915 / 27-6-2013 περί Καθορισμού Φορέα υλοποίησης για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ του 2012

6. Την με αριθμ. 05 / 05-03-2014 Θ. 1^ο Ε.Η.Δ εγκριτική προκήρυξης διαγωνισμού Δ.Σ Νοσοκομείου

7. Τις με αριθμ. 9/10-04-2014 Θ 10^ο Ε.Η.Δ και 13 / 21-05-2014 Θ 2^ο Ε.Η.Δ αποφάσεις Δ.Σ. του Νοσοκομείου σχετικά με τη διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία. Οι διαδικασίες εξέλιξης διέπονται από το Π.Δ. 118/2007

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΤΟΠΟΣ: «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-07-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 10 π.μ.

Οι προσφορές πρέπει είτε να υποβάλλονται στο Νοσοκομείο (Ζαννή και Αφεντούλη), είτε να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται από αυτό μέχρι και την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού , ΔΗΛΑΔΗ 16-

07-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ΩΡΑ 13.00 Ημερομηνία Υποβολής / Παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου
Εφόσον η προσφορά αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία Διενέργειας, να φέρει την ένδειξη, «Να μην ανοιχθεί από την Γραμματεία».

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

- α) Οι Έλληνες πολίτες.
- β) Οι Αλλοδαποί
- γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
- δ) Οι Συνεταιρισμοί.
- ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

5. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη,
της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα εξής παραρτήματα:

- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :** Γενικοί όροι του διαγωνισμού.
- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :** Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών.
- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :** Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών (χαμηλότερη τιμή).
- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ :** Αναλυτικός κατάλογος ειδών
- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε :** Τεχνικές προδιαγραφές
- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ:** Σχέδιο σύμβασης

6. Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, απαιτείται κατάθεση δειγμάτων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα **11 & 36** του **Π.Δ.118/2007. (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ)**

7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και **οκτώ (8) ημέρες** προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του **άρθρου 15 παρ. 2 περ. α** του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο **τρεις (3) ημέρες** προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω

συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός **έξι (6) ημερών** πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών

1. 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), και σε ηλεκτρονική μορφή (CD / DVD) εφόσον αυτό απαιτείται μαζί με τη διακήρυξη.

1. 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη αυτή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
- Ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, και ειδικότερα ως εξής:

1.4. 1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: **φάκελος δικαιολογητικών** (με όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 5,6,7,8,8^α) και η εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τον Π.Δ. 118/2007. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”.

Τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς, τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

1.4.2. Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά **συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”** και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

1.6. Η επιτροπή, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, που κατατέθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σελίδα 3 παραγρ. 3 (ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ) την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.6.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και στη συνέχεια παραδίδεται στην Υπηρεσία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.

1.6. 3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στο φάκελο δικαιολογητικών τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία των Νόμων, που αναφέρονται στη σελίδα 2 της παρούσας Διακήρυξης καθώς και αυτά που προβλέπονται κατά περίπτωση από τα **5,6,7,8,8^α και 18 του Π.Δ. 118/2007:**

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στις οποίες θα δηλώνονται τα αναφερόμενα **στα άρθρα 6 και 8^α του Π.Δ. 118/2007.**

Συγκεκριμένα στις δηλώσεις, να περιλαμβάνονται απαραίτητως τα ακόλουθα, κατά περίπτωση (φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα):

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν

β) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118 (Αναφέρατε τα αδικήματα αναλυτικά)

- δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση (2) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (Αναφέρατε αναλυτικά).

- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007

- Είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό και κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (αναφέρατε τις καταστάσεις αυτές αναλυτικά εφόσον σας αφορά)

γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση, των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος.

δ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση, των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 και εδαφίων α), β), γ), (κατά περίπτωση), του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007 κατά το στάδιο της κατακύρωσης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ημερομηνία δήλωσης των παραπάνω (του δηλούντος κι όχι του θεωρούντος το γνήσιο) θα πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι και την

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όπως αυτή αποδεικνύεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλου κατάθεσης του Νοσοκομείου

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, που υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής όπου να δηλώνεται ότι:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης
- Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή
- Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του φορέα για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

6. Γραμμάτιο είσπραξης (20 €) για την αγορά της Διακήρυξης

1.8 Τεχνική Προσφορά

1.8.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

1.8.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαραίτους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή.

1.8.3 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (σε υλοποίηση του άρθρου 9, και παρ. (ζ) του άρθρου 8 κατά περίπτωση), πιστοποιητικά σήμανσης CE, συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833 όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις της, του συμμετέχοντα και των κατασκευαστών του.

1.8.4 Η υπέρβαση του χρόνου ανταπόκρισης στη ζητούμενη υπηρεσία αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.8.5. Επισημαίνεται ότι:

1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Διευκρινίσεις που γίνονται από τους προσφέροντες **οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές** και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.6 Εάν η προσφορά αναφέρεται σε περισσότερα τους ενός είδους, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς και η διακήρυξη, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε **επί ποινή απόρριψης** τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στην διακήρυξη και τον κωδικό είδους

1.8.7 Εφ' όσον τα είδη του διαγωνισμού είναι περισσότερα του ενός(1) οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν για το σύνολο ή για μέρος των ειδών

Απαγορεύονται ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

1.10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

Απαγορεύονται ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.

1.11. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό, αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες ότι τα είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκης του Νοσοκομείου. **Απόκλιση από τον όρο αυτό, συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.**

1.12. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και **πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα**, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη **«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα»**. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.13. Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των κατασκευαστών του προσφερομένου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ' αναλογία.

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από τις ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

2. Οικονομική προσφορά - Προσφερόμενες τιμές

Η Οικονομική προσφορά να έχει απαραίτητως, την ακόλουθη μορφή: Αύξοντας αριθμός σύμφωνα με τη Διακήρυξη, Κωδικός Διακήρυξης, Κωδικός Εμπορίου, Είδος, Κωδικός Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει), Τιμή Παρατηρητηρίου τη στιγμή κατάθεσης της προσφοράς (όπου υπάρχει), Τιμή Προσφοράς

2. 1. Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ευρώ για παράδοση ελεύθερη στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

2.2. Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα, ως εξής :

α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το Φ.Π.Α.

β) ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

2.3. Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. ,θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την σύγκριση των προσφορών.

2.4. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη, η τιμή να δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά , αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απόρριψης τον αύξοντα αριθμό είδους και τον κωδικό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στην διακήρυξη.

2.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Ο Φ.Π.Α. θα καταβληθεί όπως ορίζει ο νόμος.

3. ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

3.1 Φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης

1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που ανακηρύσσονται μειοδότες, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 εντός 20 ημερών από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης από την υπηρεσία, σε σφραγισμένο φάκελο.

2. Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση στον ίδιο φάκελο, των δικαιολογητικών του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007, και συγκεκριμένα, των αναφερομένων στην παράγραφο 2, εδάφια α β και γ.. Επιπλέον προσκόμιση των υπολοίπων περιπτώσεων του άρθρου, ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΕΑΝ ζητούνται στους ειδικούς όρους – προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

3.2 Ημερομηνία Υποβολής/Παραλαβής του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης αναγράφονται υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον κυρίως φάκελο προσφοράς, και επιπρόσθετα η ένδειξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.

3.3 Η αποσφράγιση του φακέλου γίνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, κατά τρόπο ανάλογο των σταδίων που προηγήθηκαν, ενώπιον των ενδιαφερόμενων παρευρισκομένων, που ενημερώθηκαν για την αποσφράγιση, με έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

4. Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει τα οριζόμενα υπό του άρθρου 21 Π.Δ. 118/2007.

5. Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος)

- Στον προμηθευτή /ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας , αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Με την έγγραφη ανακοίνωση στον ανάδοχο , η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

- Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια/συντήρηση των ειδών θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφ' όσον δεν έχει προκύψει ακόμη σύμβαση από νέα διαγωνιστική διαδικασία, για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

- **Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συμβάσεων, του σχετικού διαγωνισμού σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν.**
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, **ως τόπος εκτέλεσης ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ**, υποβαλλομένων των προμηθευτών ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

6. Εγγυήσεις (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007).

6.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α) Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α σύμφωνα με το **άρθρο 25 παρ.4α του Π.Δ 118/2007**. Σε περίπτωση συμμετέχων στο διαγωνισμό προσφέρει για μέρος των υπό συντήρηση ειδών τότε αρκεί εγγύηση που καλύπτει το παραπάνω ποσοστό της αξίας των προσφερομένων απ' αυτόν υπηρεσιών συντήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.4β του Π.Δ 118/2007

β) Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται με τις παραπάνω εγγυήσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

γ) Η Εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα(1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

δ) Η Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης .

6.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α) Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η ανάθεση, **υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης**, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό **10%** της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

β) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο συντήρησης πλέον δύο (2) μήνες.

6.3 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Ελληνικό Προξενείο).

6.4. Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. 150/10-7-2007/Τεύχος Α).

7. Παράδοση - Παραλαβή- Κυρώσεις

Π.Δ. 118.2007 (άρθρα 27,28,29,30,31,32,33,34).

7.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές της Διακήρυξης, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες του Νοσοκομείου και μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

7.2. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης του αναδόχου πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή του Νοσοκομείου.

7.3. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτήν με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη, ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο που επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 32 και 34 του Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. 150/Τεύχος Α/10-7-2007).

8. Πληρωμή – Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τη σύμβαση, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου του Νοσοκομείου με τακτικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, με βάση τα απαιτούμενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή περιγραφή της εργασίας συντήρησης, σύμφωνα με την προσφορά του και την σύμβαση.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει με ευθύνη του Νοσοκομείου, ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 4152 /2013 (107/9-05-2013)

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και ειδικότερα:

- Μ.Τ.Π.Υ και Ο.Γ.Α ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ 3, 072 %
- ΦΟΡΟΣ 8%
- Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10%
- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2% Ν. 3580 / 2007 2%

8. Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές - Δικαστικές προσφυγές. Π.Δ. 118/2007.

Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ 118 / 2007

Η ενιστάμενη εταιρεία θα ενημερώνεται μετά την έγκριση της απάντησης της επιτροπής ενστάσεων από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

9. Κόστος Διακήρυξης

Με την λήψη της διακήρυξης του διαγωνισμού, **οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο του Νοσοκομείου το ανάλογο ποσό και να προσκομίσουν την απόδειξη πληρωμής στα δικαιολογητικά τους.**

10. Γενικά

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

*** ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ	# 58.671,00 # € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

1. Για την **αξιολόγηση των προσφορών**, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία, όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή προσφοράς:
 - Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης
 - Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε
 - Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και με την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
2. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο/ προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης
3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.
6. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

- Gabro AK-10 με BMM: 26244 & UDM: 13252 & BCM: 1819 & FCM: 10238
- Gabro AK-90S με S/N 1392
- Gabro AK-200S με BM : 17875 & FM : 14301
- Gabro AK-200S με BM : 17876 & FM : 14302
- Gabro AK-200S με BM : 17877 & FM : 14303
- Nikkiso DBB-05 με S/N 63009-01
- Nikkiso DBB-05 με S/N 63009-02
- Nikkiso DBB-05 με S/N 63009-03
- Fresenius 4008 B/HDF με S/N 9V5AH922
- Fresenius 4008 B/HDF με S/N 0V5AL533
- Fresenius 4008S με S/N 3VCAQ 835
- Fresenius 4008S με S/N 3VCAQ 834
- Fresenius 4008S με S/N 7VCAFR95
- Fresenius 4008S με S/N 7VCAFR87
- Fresenius 4008S με S/N 7VCAFR88

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ / ΜΗΝΑ Χ 12 ΜΗΝΕΣ*	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ*
GABRO AK 10	1	265X12	3.180
GABRO AK 90S	1	265X12	3.180
GABRO AK 200S	3	265X12	9.540
NIKISSO DBB – 05	3	265X12	9.540
FRESENIUS 4008 B HDF	2	265X12	6.360
FRESENIUS 4008 S	5	265X12	15.900
ΣΥΝΟΛΟ			47.700
ΦΠΑ			10.971
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ			58.671

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

1. Ο συντηρητής αποδεδειγμένα θα έχει τα κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία για τις εργασίες συντήρησης, τα οποία να αποδεικνύονται με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

- Πιστοποιήσεις ISO του συντηρητή που αφορά στην εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν εκπαιδευτεί στα υπό ανάθεση μηχανήματα τεχνικού νεφρού. Στην περίπτωση όπου δεν διαθέτουν οι τεχνικοί του αναδόχου πιστοποιητικά εκπαίδευσης για τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία τουλάχιστον ενός Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει ικανοποιητικά εργασίες συντήρησης σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

2. Ειδικότερα ο συντηρητής πρέπει να εκτελεί οπωσδήποτε δύο (2) τακτικές συντηρήσεις (μία ανά εξάμηνο), όπως αναλυτικά περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστού των μηχανημάτων, λαμβανομένου υπόψη ότι τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης της Μ.Τ.Ν. λειτουργούν κάθε εβδομάδα τουλάχιστον **100 ώρες** και οσοδήποτε άλλες φορές ήθελε χρειαστεί ενδιάμεσα για την αποκατάσταση των διαφόρων βλαβών που θα προκύψουν.

Ο συντηρητής οφείλει επιπλέον να προβαίνει άμεσα σε τυχόν μετατροπές, αναβαθμίσεις ή βελτιώσεις των μηχανημάτων (software updates) που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, προς τον χρήστη, χωρίς extra χρέωση.

3. Ο συντηρητής θα πρέπει να υποβάλλει με την προσφορά του το αναλυτικό πρόγραμμα με τις προληπτικές συντηρήσεις που θα εκτελεί και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των μηχανημάτων, με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των.

4. Ο συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό των μηχανημάτων, και γενικά για τις εργασίες και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές για την συντήρηση κάθε μηχανήματος που αναφέρονται.

FLUID MONITOR

- Διαδικασία καθαρισμού και απασβέστωσης
- Ρύθμιση αισθητήρων πίεσης
- Ρύθμιση ανιχνευτού διαρροής αίματος
- Ρύθμιση αισθητήρων αγωγιμότητας
- Έλεγχος τάσεων αναφοράς
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Ρύθμιση Bicart select
- Εσωτερική ρύθμιση αισθητήρα υπερδιήθησης
- Ρύθμιση FRN
- Ρύθμιση ευθυγράμμιση UF

BLOOD MONITOR

- Ρύθμιση αισθητήρων φλεβικής πίεσης
- Ρύθμιση αισθητήρων αρτηριακής πίεσης
- Ρύθμιση αισθητήρα στάθμης
- Ρύθμιση αισθητήρα προετοιμασίας
- Έλεγχος πιεσομέτρων

5. Τον συντηρητή βαρύνουν τα υλικά καθαρισμού και λίπανσης, η εργασία των τεχνικών που θα απασχοληθούν για την συντήρηση, έλεγχο, ρύθμιση λειτουργίας, επισκευή βλαβών κλπ.

6. Τον συντηρητή βαρύνουν όλα τα ανταλλακτικά, πλην των αναλωσίμων τα οποία στην προσφορά του θα προκαθορίζονται επακριβώς.

7. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης **με το αρμόδιο τμήμα και το τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας**, χωρίς να διαταράσσεται η κανονική λειτουργία του τμήματος και κατ' επέκταση του Νοσοκομείου.

8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση του τμήματος Βιοϊατρικής τεχνολογίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.

9. Ο συντηρητής πρέπει να επεμβαίνει για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα παρουσιάζεται στα μηχανήματα μέσα σε 4 ώρες από οποιοδήποτε έκτακτο κάλεσμά του, από το Νοσοκομείο, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων αργιών και εορτών.

10. Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης λόγω επισκευών και προγραμματισμένων συντηρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο, (υπολογίζονται 2 τακτικές συντηρήσεις), ο δε χρόνος αυτός θα ορίζεται με σαφήνεια στην προσφορά. Σε περίπτωση υπέρβασης, η σύμβαση θα παρατείνεται για 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για κάθε ημέρα υπέρβασης του προαναφερόμενου συνολικού χρόνου των είκοσι ημερών.

11. Σαν ακινητοποίηση του μηχανήματος νοείται οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά ολόκληρο ή μέρος του μηχανήματος να μην μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, οπότε και θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης από την αναγγελία της βλάβης στον συντηρητή. Το μέσον αναγγελίας μπορεί να είναι είτε τηλεφωνικό είτε με φαξ.

12. Για κάθε μηχανήμα με μέριμνα και ευθύνη του συντηρητή θα τηρείται βιβλίο συντηρήσεων-επισκευών, στο οποίο θα αναγράφονται ανελλιπώς και με πληρότητα (ημερομηνία, περιγραφή εργασίας κλπ), τις συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, ρυθμίσεις, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο. Το βιβλίο αυτό θα τηρείται στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

13. Παράλληλα με το προαναφερόμενο βιβλίο και μετά από κάθε επίσκεψη τεχνικού του συντηρητή θα συμπληρώνονται ειδικά δελτία του συντηρητή και του Νοσοκομείου, και τα οποία θα υπογράφονται από τον συντηρητή και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου συντήρησης του Νοσοκομείου.

14. Η σύμβαση θα διακόπτεται αυτομάτως αν λόγω παλαιότητας του μηχανήματος δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο ή απο οποιονδήποτε τρίτο που διαθέτει γνήσια ανταλλακτικά.

15. Από την αποκατάσταση βλαβών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες όπως:

- Μη ενδεδειγμένη χρησιμοποίηση του μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
- Ζημιά, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή δόλο.
- Βίαιη καταστροφή.
- Όλες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας.
- Μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση.

16. Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει από ελαττωματική συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων, στο προσωπικό του νοσοκομείου, στο υπ' αυτόν ή τους ασθενείς, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου από υπαιτιότητα του ή δόλο.

17. Στην περίπτωση που ο συντηρητής αποδειχθεί ότι είναι ασυνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του το Δ.Σ. του νοσοκομείου ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου

συντήρησης θα τον κηρύσσει έκπιωτο και θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή “καλής εκτέλεσης της σύμβασης” υπέρ του νοσοκομείου.

18. Προσφορά που δεν απαντά με σαφήνεια και αναλυτικά σε όλα τα ζητούμενα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2^{ης} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
"Τ Ζ Α Ν Ε Ι Ο"

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

**ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

Στον Πειραιά σήμερα στις.....μεταξύ του Νοσοκομείου με την επωνυμία **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"**, που εδρεύει στον Πειραιά, (Ζαννή και Αφεντούλη), και εκπροσωπείται νόμιμα από τ ν κ , **Διοικητ** , και που στη συνέχεια θα αποκαλείται το **"Νοσοκομείο"** και αφ' ετέρου δε της εταιρείας " " που εκπροσωπείται νόμιμα, από τον κ. στη συνέχεια θα αποκαλείται ο **"προμηθευτής"**, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την **-20.... /ΘΕΜΑ** απόφαση του **Δ.Σ.** του Νοσοκομείου και ύστερα από δημόσιο ανοικτό, διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου συντηρητή **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ** με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, κατακυρώνεται στην " " και αυτή στη συνέχεια αναλαμβάνει τη συντήρηση των στο άρθρο 1 οριζόμενων όπως παρακάτω περιγράφονται, με τους ειδικότερους όρους και τις συμφωνίες που ακολουθούν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο συντηρητής υποχρεούται να συντηρήσει τα παρακάτω μηχανήματα αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών από έως

Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συμβάσεων, του σχετικού διαγωνισμού σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν και ο προμηθευτής στερείται του δικαιώματος να ζητήσει αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο συντηρητής υποχρεούται να συντηρεί τα μηχανήματα που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους στο τέλος της παρούσας όρους συντήρησης. Η συνολική ετήσια αμοιβή για την παρούσα σύμβαση διαμορφώνεται στο ποσό των € πλέον Φ.Π.Α

Η χρέωση ορίζεται ανά (χρον. διάστημα) στο ποσό των €

Η συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας και θα αποδεικνύεται με βεβαίωση επιτροπής που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.

Εξοδα μετακίνησης και μεταφοράς βαρύνουν το συντηρητή

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις**ΑΡΘΡΟ 3ο**

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο συντηρητής κατέθεσε στο Νοσοκομείο την αριθμ.

..... εγγυητική επιστολής της

..... € η

οποία θα του επιστραφεί μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

4^ο ΑΡΘΡΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του συντηρητή θα γίνεται από το Νοσοκομείο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, με βάση των απαιτούμενων, για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικών
 . Σε περίπτωση που η πληρωμή του συντηρητή καθυστερήσει με ευθύνη του Νοσοκομείου, ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 4152 / 2013 (107 / 9-5-2013)

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει έτη μετά.

Το Γ.Ν.Πειραιά «Τζάνειο» δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκομείου.
- (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Νοσοκομείου.
- (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ,
- (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
- (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της εργασίας συντήρησης – **μετά από προειδοποίησή του** – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του) ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα συντήρησης.

.Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

Το Νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Για τις περιπτώσεις μη ανταπόκρισης ή πλημμελούς ανταπόκρισης του Αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε ανώτερη βία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6^ο**Περίοδος εγγύησης- συντήρησης-ανταλλακτικά**

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε (....) έτη (ή όσο επιπλέον χρονικό διάστημα αναφέρεται ενδεχομένως στην προσφορά του Προμηθευτή). Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου των μηχανημάτων που θα συντηρήσει, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο που έχει προσκομίσει. Η εγγύηση καλύπτει το Νοσοκομείο για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/και ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού προς τα συμφωνηθέντα.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Συντηρητής οφείλει αναποφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου να αποκαθιστά τη βλάβη, τη δυσλειτουργία ή/ και ασυμφωνία των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόμη και με μερική ή ολική αντικατάσταση αυτού.

Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της αμοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού, καθώς επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Συντηρητή

Ο χρόνος ανταπόκρισης του Προμηθευτή για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού είναι αυτός που ορίζεται στην οικεία θέση της διακήρυξης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συντηρητής δεν συμμορφώνεται με τις ως άνω υποχρεώσεις του, το Νοσοκομείο μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση) με δικά του έξοδα, με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα της παρούσας σύμβασης, ως τόπος εκτέλεσης ο Πειραιάς υποβαλλομένου του προμηθευτή ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

Για τα υπόλοιπα θέματα της παρούσας, ισχύουν οι όροι της σχετικής διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις προμήθειες Δημοσίου.

Αφού αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αρχίζει από την υπογραφή της, σε τρία (3) πρωτότυπα, και το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ



ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός:	4567/2003
Ποσό:	1.536.108, 00 ΕΥΡΩ
Προμηθευτής:	ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ - MEDICAL PRODUCTS
Είδος:	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Διάφορα Νοσοκομεία) ΓΕΣ και Β' ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	

Σήμερα την 4η Απριλίου του έτους Δύο χιλιάδες τρία (2003) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεν. Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Ε. Κάννινας), οι υπογεγραμμένοι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Επιστημονικών Οργάνων, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση τις κείμενες διατάξεις και αφητέρου η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ - MEDICAL PRODUCTS, Δ/ση Γ. Γεννηματά 54, Τ.Κ. 16662 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 9647500 και ΑΦΜ 095150743, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, που νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΛΑΧΟ του Αγγελού (Α.Τ. Ξ. 315272/85, Α.Τ. Α. Γλυφάδας), σύμφωνα με το 19596/7-12-1998 καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ 9929/29-12-1998), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την 8-7-2002 με βάση την Δ/ση 247/2001, διενεργήθηκε ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ - ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια Συσκευών Τεχνητού Νεφρού, τύπου ΑΚ-95S και ΑΚ-200S, του οίκου GAMBERO LUNDIA AB ΣΟΥΗΔΙΑΣ για τις ανάγκες του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Διάφορα Νοσοκομεία) - ΓΕΣ και Β' Νοσοκομείου ΙΚΑ Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την αριθμ. 57027-1-2003 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο όνομα της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ - MEDICAL PRODUCTS, ως αναλυτικά αναφέρεται στο Αρθρο 1ο.

Υστερα από αυτό ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής στην παρούσα σύμβαση

[Handwritten signature]

"ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ", και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/96) "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", το Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατ. Προμηθειών προς Εξωτερικούς Δίκαιος", το Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ 102/Α/95) και το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου".

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ-ΤΙΜΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ	ΦΟΡΕΑΣ
1	ΕΙΔΟΣ 1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΚ-95 του οίκου GAMBERO AB ΣΟΥΗΔΙΑΣ	3	9.391,00 ΦΠΑ 18%	28.173,00 5.071,14 33.244,14	Ν.Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2		4	9391,00 ΦΠΑ 18%	37.564,00 6.761,52 44.325,52	Ν.Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3		3	9.391,00 ΦΠΑ 18%	28.173,00 5.071,14 33.244,14	Π.Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
4		3	9.391,00 ΦΠΑ 18%	28.173,00 5.071,14 33.244,14	Ν.Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
5		2	9.391,00 ΦΠΑ 18%	18.782,00 3.380,76 22.162,76	Ν.Γ.Ν. ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΤΙΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
6		1	9.391,00 ΦΠΑ 18%	9.391,00 1.690,38 11.081,38	ΓΕΣ
7		3	9.391,00 ΦΠΑ 18%	28.173,00 5.071,14 33.244,14	Β' ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	19		219.546,22	

[Handwritten signature]

ΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΕΜΑ- ΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ	ΦΟΡΕΑΣ
1	ΕΙΔΟΣ 2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AK-200 του οίκου GAMBERO AB ΣΟΥΗΔΙΑΣ	4	11.005,00 ΦΠΑ 18%	44.020,00 7.923,60 51.943,60	ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ "ΣΥΜΑΝΟΥΣΙΟ"
2		8	11.005,00 ΦΠΑ 18%	88.040,00 15.847,20 103.887,20	Π.Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
3		8	11.005,00 ΦΠΑ 18%	88.040,00 15.847,20 103.887,20	Π.Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4		5	11.005,00 ΦΠΑ 18%	55.025,00 9.904,50 64.929,50	Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
5		6	11.005,00 ΦΠΑ 18%	66.030,00 11.885,40 77.915,40	Ν.Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"
6		7	11.005,00 ΦΠΑ 18%	77.035,00 13.866,00 90.901,30	Ν.Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
7		4	11.005,00 ΦΠΑ 18%	44.020,00 7.923,60 51.943,60	Ν.Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8		7	11.005,00 ΦΠΑ 18%	77.035,00 13.866,00 90.901,30	Ν.Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
9		3	11.005,00 ΦΠΑ 18%	33.015,00 5.942,70 38.957,70	Ν.Γ.Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
10		4	11.005,00 ΦΠΑ 18%	44.020,00 7.923,60 51.943,60	Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
11		2	11.005,00 ΦΠΑ 18%	22.010,00 3.961,80 25.971,80	Ν.Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3

[Handwritten signature]


12		4	11.005,00 ΦΠΑ 18%	44.020,00 7.923,60 51.943,60	Ν.Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ
13		3	11.005,00 ΦΠΑ 18%	33.015,00 5.942,70 38.957,70	Ν.Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ
14		10	11.005,00 ΦΠΑ 18%	110.050,00 19.809,80 129.859,80	Ν.Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ
15		2	11.005,00 ΦΠΑ 18%	22.010,00 3.961,80 25.971,80	Ν.Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
16		8	11.005,00 ΦΠΑ 18%	88.040,00 15.847,20 103.887,20	Ν.Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
17		1	11.005,00 ΦΠΑ 18%	11.005,00 1.980,90 12.985,90	Π.Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
18		5	11.005,00 ΦΠΑ 18%	55.025,00 9.904,50 64.929,50	Ν.Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΑΣ
19		5	11.005,00 ΦΠΑ 18%	55.025,00 9.904,50 64.929,50	Ν.Γ.Ν. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ
20		2	11.005,00 ΦΠΑ 18%	22.010,00 3.961,80 25.971,80	Ν.Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
21		1	11.005,00 ΦΠΑ 18%	11.005,00 1.980,90 12.985,90	Γ.Ε.Σ.
22		3	11.005,00 ΦΠΑ 18%	33.015,00 5.942,70 38.957,70	Β' ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
		102		1.324.561,80	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ		

4

[Handwritten signature]

Η τιμή μονάδας των υπό προμήθεια μηχανημάτων είναι για παράδοση αυτών (με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή) ελεύθερη στις αποθήκες των φορέων και περιλαμβάνει την αξία των μηχανημάτων, και τα έξοδα μεταφοράς των μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής αυτών.

Θα επιβαρυνθεί δε με τον αναλογούντα ΦΠΑ ως ανωτέρω.



ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της παρούσης (εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου), ελεύθερα στις αποθήκες των Νοσοκομείων, με την υποχρέωση να τα μεταφέρει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία στο χώρο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 394/96.

Ο χώρος εγκατάστασης των μηχανημάτων θα είναι έτοιμος, με μέριμνα των Νοσοκομείων, πριν από την παράδοση αυτών.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνεργασθεί με τα Νοσοκομεία, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί, στην διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης, ασφάλεια λειτουργίας των μηχανημάτων (σχέδια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.).

Με την παράδοση των μηχανημάτων θα παραδοθούν και τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης.

Η παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την πλήρη εγκατάστασή του.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών εκ 1.535.108, 02 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, θα γίνει το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών.

Η δαπάνη βαρύνει για τα Νοσοκομεία :

- 1) Ν.Γ.Ν. ΕΛΕΙΣΣΑΣ το Γ.Κ.Π.Σ. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
- 2) ΠΕ.Σ.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ν.Γ.Ν. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ - Ν.Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - Ν.Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ) και Ν.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" το Γ.Κ.Π.Σ.
- 3) Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ το Π.Δ.Ε. (ΠΕΠ Ηπείρου)
- 4) Ν.Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 091/1 Αριθ. έργου 9991310)

Για τα υπόλοιπα Νοσοκομεία η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό τους.

Η προμήθεια του είδους βαρύνεται με κρατήσεις:

- 1) Για τα Νοσοκομεία Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ", Π.Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ", Ν.Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ "ΜΠΟΛΟΣΣΑΚΕΙΟ", Ν.Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Ν.Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν.Γ.Ν. ΑΛΑΜΙΑΣ, Ν.Γ.Ν. ΚΥΤΑΡΙΣΣΙΑΣ, Ν.Γ.Ν. ΠΥΡΡΟΥ, Ν.Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ν.Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ Ν.Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ", Ν.Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ, Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΣΩΜΝΟΥ, Π.Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" και Ν.Γ.Ν. ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" 7,3216%.

ΜΠΠΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΑΚΠ	ΤΑΥΓΕ	Ν.2430/96	ΣΥΝΟΛΟ
3.072	0,256	0,1024	0,3072	7,3216%

5

2) Για τα Νοσοκομεία Ν.Γ.Ν. ΕΛΕΙΣΣΑΣ, ΠΕ.Σ.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Ν.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ και Ν.Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0,1024%.

3) ΓΕΣ 4,7616%

ΜΠΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΑΚΠ	ΤΑΥΓΕ	ΣΥΝΟΛΟ
4.096	0,256	0,1024	0,3072

Δ.Κ.Α.	0,6656%		
ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΑΚΠ	ΤΑΥΓΕ	ΣΥΝΟΛΟ	
0,2560	0,1024	0,3072	0,6656 %

Από την πληρωμή του προμηθευτή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 123 του Ν.2198/94, φόρος εισοδήματος.

Σχετικά με τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.394/96.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το ΙΚΑ.

Η προμηθευτρια θα παραδώσει τα μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία, τα δε έξοδα για την μεταφορά, εγκατάσταση και επίδειξη, βαρύνουν καθ' ολοκληρίαν την ίδια.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο άρθρο 1, θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά της προμηθευτριας, σε συνδυασμό με τους τεχνικούς όρους της δίξης 247/2001 που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για τα ανωτέρω μηχανήματα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) χρόνων από την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η προμηθευτρια εταιρεία αναλαμβάνει την εκπαίδευση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσοκομείων για τα οποία προορίζονται τα μηχανήματα, στην χρήση των προσφερομένων μηχανημάτων στον τόπο λειτουργίας τους και για όσο χρόνο κρίνει απαραίτητο.

Όλα τα έξοδα εκπαίδευσης βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία.

6

ΑΡΘΡΟ 8°

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η προμηθεύτρια κατέθεσε την παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΚΔΙΔΕΙ	ΠΟΣΟ	ΥΠΕΡ ΤΗΣ
116/Δ22185/25894 1-4-2003	ALPHA BANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ	130.094, 00 ΕΥΡΩ	ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ

ΑΡΘΡΟ 9°

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των συμβάσεων (Επιτροπή Παραλαβής, Πληρωμή κ.λ.π.), σύμφωνα με την απόφαση 570/27-1-2003, θα γίνει από τα Νοσοκομεία που η παρούσα σύμβαση αφορά.

ΑΡΘΡΟ 10°

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια, η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης 247/2001, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 394/88 (ΦΕΚ 266/α/4-12-96). Υστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε δύο πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Γραφείο του Υπουργείου Ανάπτυξης και το άλλο πήρε, σαν διπλόγραφο, ο προμηθευτής, ο οποίος δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Για την Προμηθεύτρια
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ

Θεωρείται η παρούσα σύμβαση ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ
ΕΙΣΛΗΓΙΤΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ
με έργο π. προσέδοτο με αριθμό Γ. Γενικού 54. 16562 Νομ. Γραφείο
Ημερομηνία έκδοσης στα Τμήμα Γ Τηλ.Α.: 9547500 - ΑΝΑΛ. 095150743
ΔΟΥ. ΓΑΛΦΑΔΟΣ

Αθήνα 14/4/2003.

Η Προμηθεύτρια

Κ. Βλαχός

MEDICAL PRODUCTS LTD

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ.

Γ. Γεννηματά 54
165 62 Αθήνα
Τηλ: +30 1 9647500
Fax: +30 1 9650500
E-Mail: info@medicalprod.gr



Προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γεν. Γραμματεία Εμπορίου
Γεν. Δίση Κρατικών Προμηθειών
Δίση Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλ.
και Επιστημονικών Οργάνων
Τμήμα Γ
Κάνινος 20, 101 81 Αθήνα

Αθήνα, 4/7/02

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Διακήρυξη σας με αριθ. 247/01, δημόσια, ανοικτού, διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών Τεχνητού Νεφρού για το Φορέα Υπ. Υγείας- Πρόνοιας (διάφορα νοσοκομεία), που θα γίνει στις 8/7/2002 όπως ανακοίνωση 3124/10.5.02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αναφερόμενοι στην παραπάνω διακήρυξη σας τους όρους της σπείρας, αφού λάβαμε γνώση, αποδεχόμεστε ανεπιφύλακτα και ενεργούντες αποκλειστικοί αντιπρόσωποι και εισαγωγείς του Οίκου και Εργοστασίου

GAMBRO LUNDIA AB ΣΟΥΗΔΙΑΣ

έχουμε τη τιμή να σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη:

Handwritten signature and initials.


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΩΔ.ΑΡ.ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 21/04/50/00/00
Για συμβατική αμοκθάραση E1
Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού τύπου
AK-95S Gambro
Για παραλλανές της συμβατικής αμοκθάρασης E2
Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού τύπου
AK-200S Gambro

Με **Ενσωματωμένο αυτόματο πιεσόμετρο BPM**
Ενσωματωμένο όργανο μέτρησης και ένδειξης PH
Μπαταρία εφεδρικής
Δύο αντλίες αίματος

Εξοιστάσιο κατασκευής: Gambro Lundia AB, Σουηδίας.

Χώρα προέλευσης: Σουηδία.

Έτος πρώτης κυκλοφορίας: 2002 για το AK-95S
 2001 για το AK-200S

Έτος κατασκευής: 2002

Ισχύς Προσφοράς:

Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως η διακήρυξή σας.

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας:

Τρία έτη από την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία με τους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Σηρίρη. Αποδεχόμεθα όλους τους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

Τεχνική Σηρίρη:

Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς μας και αναφέρεται στους όρους συντήρησης για το διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και σε τρόπους συντήρησης των προσφερομένων μηχανημάτων για μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

...


Αντικατάσταση:

Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα για τον οποίο γίνεται η προμήθεια, να αντικαταστήσουμε ολόκληρο το μηχανήμα ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.

Επάρκεια ανταλλακτικών:

Όπως στη συντημένη τεχνική στήριξη αναφέρεται, διαθέτουμε για άμεση παράδοση, stock ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία. Για την λειτουργία των προσφερομένων μηχανών δεν απαιτούνται αναλώσιμα ανταλλακτικά ή άλλα ειδικά εξαρτήματα.

Εκπαίδευση τεχνικών:

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προσρίζονται τα μηχανήματα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για αγγλωμαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα.

Εκπαίδευση προσωπικού:

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του Ιατρικού-Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσ/μείων για τα οποία προσρίζονται τα μηχανήματα, στην χρήση των προσφερομένων μηχανημάτων στον τόπο λειτουργίας τους και για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο.

Επιδείξη:

Αναλαμβάνουμε να επιδείξουμε τα προσφερόμενα μηχανήματα, σε τόπο και χρόνο που θα μας υποδειχθεί από την Επιτροπή.

Παράδοση:

Τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι ασφαλισμένα μέχρι τις αποθήκες των διαφόρων Νοσ/μείων όπως διακρίνεται, θα παραδοθούν στο χώρο που θα μας υποδειχθεί στα Νοσοκομεία, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα πρωτότυπα εγχειρίδια δηλ.: (service manual - οδηγίες συντήρησης, operator's manual - οδηγίες χειρισμού στα Ελληνικά, ηλεκτρονικά τοπογραφικά σχέδια, κατάλογο ανταλλακτικών - spare parts list και εγχειρίδιο ρυθμίσεων-adjustment manual), όπου θα γίνει και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή (εγκατάσταση) χωρίς καμιά ξεχωριστή επιβάρυνση.

10

Τόπος Παράδοσης:

Στα διάφορα Νοσ/μεία, όπως η διακίχ σας παρ/μια Α1.

Χρόνος Παράδοσης:

Εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης για όλη την ποσότητα των ζητούμενων μηχανημάτων.

Χρόνος Παραλαβής: Όπως η διακίχ σας.


Συνημμένα, σας υποβάλλουμε:

1. Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές
2. Δήλωση περί αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού, περί συμμόρφωσης ή απόκλισης από τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης καθώς και επιστημοποίησης όλων των πληροφοριακών στοιχείων που περιέχει η προσφορά μας.
3. Δήλωση χρόνου παράδοσης.
4. Λίστα Νοσοκομείων που η Εταιρεία μας έχει εφοδιάσει με μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού Gambro.
5. Τεχνική στήριξη με όρους συντήρησης για το διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και προτάσεις συντήρησης για μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.
6. Τεχνικές Περιγραφές.
7. Φύλλα συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της διακίχς.
8. Prospectus και πιστοποιητικά CE.

Με τιμή,

Για την Εταιρεία
 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ.,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
 Διαχειριστής



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΩΔ.ΑΡ.ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 21/04/50/00/0

Για συμβατική απομάκρυνση

Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού τύπου

AK-95S Gambro

έκαστο

Ευρώ: *****

Για παραλλαγές της συμβατικής απομάκρυνσης

Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού τύπου

AK-200S Gambro

Με

Ενσωματωμένο αυτόματο πιεσόμετρο BPM
 Ενσωματωμένο όργανο μέτρησης και ένδειξης PH
 Μητάρια εφεδρείας
 Δύο αντλίες αίματος

έκαστο

Ευρώ: *****

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 18%

Εργαστάσιο κατασκευής: Gambro Lundia AB, Σουηδίας.

Χώρα προέλευσης: Σουηδία.

Έτος πρώτης κυκλοφορίας: 2002 για το AK-95S
 2001 για το AK-200S

Έτος κατασκευής: 2002

Ισχύς Προσφοράς:

Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως η διακήρυξή σας.

12

[Handwritten signature and date 12]

[Handwritten signature and date 11]

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας:

Τρία έτη από την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία με τους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Στήριξη. Αποδεχόμεθα όλους τους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

Τεχνική Στήριξη:

Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς μας και αναφέρεται στους όρους συντήρησης για το διάστημα εννέα (9) ετών καλής λειτουργίας καθώς και σε τρόπους συντήρησης των προσφερόμενων μηχανημάτων για μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Αντικατάσταση:

Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα για τον οποίο γίνεται η προμήθεια, να αντικαταστήσουμε ολόκληρο το μηχανήμα ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.

Επίδοκεια ανταλλακτικών:

Όπως στη συνημμένη τεχνική στήριξη αναφέρεται, διαθέτουμε για άμεση παράδοση, stock ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία. Για την λειτουργία των προσφερόμενων μηχανών δεν απαιτούνται αναλύσιμα ανταλλακτικά ή άλλα ειδικά εξαρτήματα.

Προκατάλογος ανταλλακτικών:

Κατατίθεται προκατάλογος ανταλλακτικών.

Εκπαίδευση τεχνικών:

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχανήματα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMERO στη Λυμιά Σουλιάς (μόνον για αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα.

Εκπαίδευση προσωπικού:

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του Ιατρικού-Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχανήματα, στην χρήση των προσφερόμενων μηχανημάτων στον τόπο λειτουργίας τους και για όσο χρόνο κρίνει απαραίτητο.

Επίδοξη:

Αναλαμβάνουμε να επιδείξουμε τα προσφερόμενα μηχανήματα, σε τόπο και χρόνο που θα μας υποδειχθεί από την Επιτροπή.

Παράδοση:

Τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι ασφαλισμένα μέχρι τις αποθήκες όπου θα διαφόρων Νοσ/μείων όπως διακρίνεται, θα παραδοθούν στο χώρο που θα μας υποδειχθεί στα Νοσοκομεία, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα πρωτότυπα εγχειρίδια δηλ.: (services manual - οδηγίες συντήρησης, operation manual - οδηγίες χειρισμού στα Ελληνικά, ηλεκτρονικά τοπογραφικά σχέδια, κατάλογο ανταλλακτικών - spare parts list και εγχειρίδιο ρυθμίσεων adjustment manual), όπου θα γίνει και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή (εγκατάσταση) χωρίς καμιά ξεχωριστή επιβάρυνση.

Τόπος Παράδοσης:

Στα διάφορα Νοσ/μεία, όπως η διακρίνεται σας παρίστα Α1.

Χρόνος Παράδοσης:

Εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης για όλη την ποσότητα των ζητούμενων μηχανημάτων.

Χρόνος Παραλαβής: Όπως η διακρίνεται σας.

Τιμές:

Λίδονται τιμές σε Ευρώ, για παράδοση ελεύθερα στα διάφορα Νοσ/μεία, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αναφέρονται στην διακρίνεται σας, πλην του ΦΠΑ. Το ποσοστό ΦΠΑ είναι 18% επί της τιμής και βαρύνει το φορέα.

Τρόπος πληρωμής:

Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή, όπως η διακρίνεται σας.

Με τιμή,

Για την Εταιρεία
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠ.Ε.,


ΚΩΝΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Διοικητής

14



Φύλλο συμμόρφωσης στους Ειδικούς Όρους της διακίνησης


1. Κατατίθενται προσPECTUS των προσφερομένων μηχανημάτων απαιτείται από την διακήρυξη.
2. Κατατίθεται πιστοποιητικό έτους πρώτης κυκλοφορίας και για τους τύπους των προσφερομένων μηχανημάτων. Και οι δύο μηχανημάτων είναι κατασκευής 2002.
3. Η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι τρία έτη με πλήρη κάλυψη όλων των απαιτούμενων όρων της διακήρυξης.
4. Ο τρόπος εκπαίδευσης του προσωπικού, ιατρικού-νοσηλευτικού και τεχνικού, αναφέρεται αναλυτικά στην σελίδα 3 της Τεχνικής Προσφοράς.
5. Ανταλλακτικά θα βρισκονται σε άμεση παραδοση για μία δεκαετία και θα παραδίδονται σε περίπτωση εισαγωγής, το αργότερο σε 15 ημέρες.
6. Η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με την διακήρυξη.
7. Δίδεται Τεχνική Στήριξη που περιλαμβάνει όρους και προτάσεις για συντήρηση τουλάχιστον για δέκα χρόνια μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.
8. Κατατίθεται τιμοκατάλογος ανταλλακτικών στην Οικονομική Προσφορά.
9. Πιστοποιητικό σύμφωνα με την Ε3/833 κατατίθεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής.



Παράρτημα Ε1

Μηχανήματα GAMBRO AK-95S & AK-200S

Φύλλο συμμόρφωσης στις Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Τεχνητού Νεφρού για συμβατική αιμοκάθαρση



1. Οι προσφερόμενες συσκευές Gambro τύπου AK-95S & AK-200S είναι καινούργιες αμεταχειρίστες και σύγχρονες τεχνολογίας. Στην τεχνική τους προσφορά επισυνάπτονται αντίστοιχα prospectus με τεχνικά χαρακτηριστικά και την τεκμηρίωση όλων των στοιχείων.
2. Εργάζονται με ρεύμα πόλης 100-240 Volt, 50 ή 60 Hz.
3. Και οι δύο τύποι μηχανημάτων κάνουν αυτόματη αεριοδιόγκωση λειτουργιών-βλαβών-καλής λειτουργίας στην εκκίνηση τους πριν κάθε συνεδρία.
4. Έχουν τέτοιους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας ώστε να προστατεύουν τον ασθενή είτε από ενδοεχόμενη βλάβη είτε από κακό χειρισμό. Και στις δύο περιπτώσεις δίνουν γραπτές οδηγίες επεξεργασίας και επίλυσης του προβλήματος.
5. Και στους δύο τύπους μηχανημάτων εμπεριέχονται τα αντίστοιχα αυτοδιαγνωστικά προγράμματα (software) για τεχνικούς. Όλοι οι έλεγχοι-διαγνώσεις-ρυθμίσεις γίνονται μέσω των πάνελ χειρισμού των μηχανημάτων. Όλες οι παράμετροι λειτουργιών των συσκευών απεικονίζονται από τις συσκευές τόσο αναλογικά όσο και ψηφιακά, από τις αντίστοιχες οθόνες πλαστικών ενδείξεων που διαθέτουν. Όλα τα μηνύματα που απεικονίζονται στις οθόνες είναι στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί με τις συσκευές θα παραδοθούν και προγράμματα επικοινωνίας για συμβατούς υπολογιστές, ώστε όλες οι ανωτέρω ενδείξεις να δύνανται να απεικονιστούν σ' αυτούς. Η σύνδεση γίνεται μέσω της ενσωματωμένης στα μηχανήματα θύρας RS-232.
6. Τόσο το AK-95S όσο και το AK-200S φέρονται σε τροχήλατες ανοξείδωτες μεταλλικές βάσεις με φρένα.
7. Και οι δύο τύποι μηχανημάτων έχουν ενσωματωμένους αναρτήρες φιαλών, φίλτρων και γραμμών που ρυθμίζονται σε ύψος.
8. Εργάζονται με οιοδήποτε τύπο φίλτρου-γραμμής οπιοιδήποτε κατασκευαστή ανά τον κόσμο.
9. Έχουν ενσωματωμένα συστήματα καθαρισμού με μια βελόνα που ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός πλήκτρου. Εργάζονται με όποιο επιθυμητό συνδυασμό χρόνου ή και πίεσης (φλεβικής).
- Το AK-95S εκτελεί μονή βελόνα με μια αντλία, το AK-200S με μια ή δύο κατ' επιλογήν.
10. Και οι δύο τύποι μηχανημάτων της Gambro διαθέτουν αντίληψη ηπαρίνης τύπου σύριγγας υψηλής ακρίβειας κατάλληλη για σύριγγες έως και 30 cc κατ' επιλογήν του χειριστή.
11. Οι συσκευές διαθέτουν συστήματα μέτρησης και ελέγχου των ορίων της φαρμακικής και φλεβικής πίεσης, με αντίστοιχα ασφαλικά όργανα αλλά και ψηφιακές ενδείξεις.

16

[Handwritten signature]



12. Και τα δύο μηχανήματα διαθέτουν ανιχνευτή αίματος ώστε να αρχίσουν την μέτρηση όγκου αίματος, μόλις εισέλθει το αίμα στις γραμμές αίματος. Η ικανότητα μέτρησης συνολικού όγκου επεξεργασμένου αίματος είναι από 0-889,9 λίτρα. Ο έλεγχος ροής γίνεται από μικροαυτολογιστή μέσω των αντλίων αίματος και των αρτηριακών-φλεβικών αισθητήρων πίεσης που διαθέτουν οι συσκευές.

13. Είναι πλήρως αυτόματες και αυτόνομες ως προς την παραγωγή διαλύματος. Αυτό γίνεται με σερβοελεγχόμενους μηχανισμούς και άνω/κάτω ανάμιξης, μέσω μικροπολογιστών, ώστε το τελικό διάλυμα να έχει σταθερότητα σύστασης άσχετα με την τυχόν διακύμανση πυκνότητας των συμπυκνωμάτων.

14. Είναι τύπου single-pass (απλής διέλευσης) διαλύματος από το φίλτρο καθαράς. Τα υδραυλικά τους κυκλώματα είναι ελάχιστα σε μήκος και όγκο νερού για καλύτερη υγιεινή των μηχανημάτων.

15. Παρασκευάζουν τόσο οξικά όσο και διττανθρακικά διαλύματα κατ' επιλογήν του χειριστή, μέσα από ένα κατάλογο (menu) έξι συνολικά διαθέσιμων τύπων συμπυκνωμάτων ώστε εάν τελειώσει ο ένας τύπος ο χειριστής να δύναται να επιλέξει άλλον, χωρίς καμία άλλη επέμβαση ή ρύθμιση στο μηχάνημα. Οι έξι τύποι συμπυκνωμάτων προεπιλέγονται στο το νοσοκομείο ή προρυθμίζονται σε αντιπαραβολή μνήμες των συσκευών.

16. Διαθέτουν συστήματα μεταβολής τόσο του Na^+ όσο και των διττανθρακικών ριζών HCO_3^- του τελικού διαλύματος κατά την διάρκεια της καθαράς. Οι επιθυμητές αλλά και οι ενδοκυκλωμένες τιμές είναι επιβεβαιωμένες σε χημειοανάλυση Na^+ και HCO_3^- για τις διττανθρακικές ριζές. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένδειξη σε mS (αγωγιμότητα).

17. Και οι δύο τύποι AK-95S & AK-200S έχουν ενσωματωμένα συστήματα παρασκευής διττανθρακικών από άνυδρο σκόνη νατρίου σε φύλλα Bicar® της Gambro AB, όλες τις φύσιγγες των άλλων κατασκευαστών, πλήρη των ειδικά κατασκευασμένων και πατενταρισμένων για συγκεκριμένα και μόνον μηχανήματα, αλλά και από υγρά συμπυκνώματα τύπου B. Ενδεικτικά μερικές από τις φύσιγγες που δέχονται και διατίθενται στην Ελληνική αγορά μέσω ανεξάρτητων από την Εταιρεία μας προμηθευτών είναι:

1. Doctacart της εταιρείας Doctum,
2. Vermacart της εταιρείας Verma Drugs
3. Niasocart της εταιρείας Nikiso
4. Altracart της εταιρείας Althin-Drake Willock

18. Διαθέτουν συστήματα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης με μικροπολογιστές μέσω αισθητήρων μέτρησης ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς άμεση επαφή με το διάλυμα για ακριβέστερη μέτρηση και ευκολότερο καθαρισμό.

19. Με το πάτημα ενός πλήκτρου εκτελούν ξηρά καθαρά αλλά και αναλασόμενη (sequential) σύμφωνα με την επιθυμία του χειριστή.

20. Διαθέτουν ενσωματωμένα ροόμετρα ροής διαλύματος, το AK-95S μηχανικό, το AK-200S ηλεκτρονικό.

21. Έχουν ενσωματωμένες αυτόματες λειτουργίες θερμικής-χημικής αποστείρωσης, απαορίσματος, πλυσίματος με νερό και αυτόματου αδειασματος του νερού στο τέλος κάθε κύκλου πλυσίματος ή αποστείρωσης.

Σχετικά με σήμανση CE

Οι προσφερόμενες συσκευές τεχνικού νεφρού είναι σύμφωνες με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ /14-6-93 και τόσο αυτές όσο και τα manual που τις συνοδεύουν φέρουν την σήμανση CE.

[Handwritten signature]


17



Παράρτημα Ε2

Μηχανήματα GAMBRO AK-200S

Φόλλο συμμόρφωσης στις Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Τεχνητού Νεφρού για παραλλαγές της συμβατικής αιμοκάθαρσης



Επιπλέον των αναφερόμενων η συσκευή AK-200S

α) Εκτελεί την μέθοδο Haemodiafiltration τόσο με σκόνη όσο και με την μέθοδο ON-LINE (προαιρετικά), υποκατάστασης όσο και με την μέθοδο ON-LINE (προαιρετικά).

β) Διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα διαχρονικού προφίλματος (profiling) για τις παραμέτρους:

- 1) Na^+
- 2) HCO_3^-
- 3) υπερδιήθησης (UF)

Ο έλεγχος γίνεται με έγχρωμα γραφήματα από την έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων.

γ) Η συσκευή AK-200S χρησιμοποιεί κάθε τύπο φίλτρου σχεδώς συντελεστή υπερδιήθησης, οιοδήποτε κατασκευαστή, ανεξάρτητα εάν προορίζεται για συμβατική ή για όπια παραλλαγή αιμοκάθαρσης.

Επιπρόσθετα:

δ) Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία επαναφορτιζόμενη που του δίνει αυτονομία λειτουργίας 30 περίπου λεπτών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ε) Διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο πιεσόμετρο (BPM) λήψης και καταγραφής της πίεσης του αρρώστου.

ς) Διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα όγκου αίματος (BVS), για την αυτόματη παρακολούθηση και καταγραφή της αιμοσφαίρινης του αρρώστου.

η) Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα παρασκευής διαλύματος από ξηρά συμπυκνώματα (SELECT) ενεργοποιούμενο κατ' επιλογήν του χειριστή.

θ) Διαθέτει ενσωματωμένο όργανο μέτρησης και ένδειξης του pH του διαλύματος αιμοκάθαρσης.

Σχετικά με σήμανση CE

Οι προσφερόμενες συσκευές τεχνητού νεφρού είναι σύμφωνες με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ /14-6-93 και τόσο αυτές όσο και τα manual που τις συνοδεύουν φέρουν την σήμανση CE.


[Handwritten signature]

18



Γ. Γεωργιάδης 54
165 62 Αθήνα
Τηλ: +30 1 9647500
Fax: +30 1 9650500
E-Mail: info@mediprod.gr

Προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γεν. Γραμματεία Εμπορίου
Γεν. Δ/ση Κρατικών Προμηθειών
Δ/ση Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλ.
και Επιστημονικών Οργάνων
Τμήμα Γ'
Κόρινθος 20, 101 81 Αθήνα



Συμπληρωματικά: Διακήρυξη σας με αριθ. 247/01, δημόσιου, ανοικτού, διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών Τεχνητού Νεφρού για το φορέα Υπ. Υγείας- Πρόνοιας (διάφορα νοσοκομεία), που θα γίνει στις 8/7/2002 όπως ανακοινώση 3124/10.5.02

ΔΗΛΩΣΗ

Ως μετέχοντες στο διαγωνισμό που γίνεται με βάση την παραπάνω διακήρυξη σας

δηλώνουμε

ότι όλα τα προσφερόμενα μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού θα παραδοθούν εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

Με τημμή,

Για την Εταιρεία
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.,

ΚΩΝΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Διαχειριστής

[Handwritten signature]
IP



Γ. Γεωργιάδης 54
165 62 Αθήνα
Τηλ: +30 1 9647500
Fax: +30 1 9650500
E-Mail: info@mediprod.gr

Προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γεν. Γραμματεία Εμπορίου
Γεν. Δ/ση Κρατικών Προμηθειών
Δ/ση Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλ.
και Επιστημονικών Οργάνων
Τμήμα Γ'
Κόρινθος 20, 101 81 Αθήνα



Συμπληρωματικά: Διακήρυξη σας με αριθ. 247/01, δημόσιου, ανοικτού, διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών Τεχνητού Νεφρού για το φορέα Υπ. Υγείας- Πρόνοιας (διάφορα νοσοκομεία), που θα γίνει στις 8/7/2002 όπως ανακοινώση 3124/10.5.02

ΔΗΛΩΣΗ

Ως μετέχοντες στο διαγωνισμό που γίνεται με βάση την παραπάνω διακήρυξη σας

δηλώνουμε

1. Ότι αποδεχόμεθα χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους, γενικούς και ειδικούς της διακήρυξης του διαγωνισμού.

2. Ότι επισημοποιούμε όλα τα συνημμένα της προσφοράς μας στοιχεία και δεχόμεθα ανεπιφύλακτα να αποτελέσουν στοιχεία κρίσεως μας όπως η βασική προσφορά.

3. Ότι τα προσφερόμενα από εμάς μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού συμπεριλαμβάνουν απόλυτα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της παραπάνω διακήρυξης (αναλυτικά περιγράφονται στα φύλλα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους) και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από αυτές.

Με τημμή,

Για την Εταιρεία
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.,

ΚΩΝΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Διαχειριστής

[Handwritten signature]
20


22

249

LATPIKA IPOIONTA ETE

21

22



ТЕХНИКА И ТЕОРИЯ

Η τεχνική στήριξη όλων των προσφερομένων μηχανημάτων-συστημάτων και γενικά η συμπαράστασή μας στις Μονάδες Τεχνητού Νεαρού είναι γνωστή ήδη στους αρμόδιους όλων των Νοσοκομείων που αναφέρονται στη Λίστα Πελατών μας.

Από πλευράς τεχνικών, έχουμε να σας γνωρίσουμε ότι διατίθενται στην Ελλάδα δεκατέσσερις πτυχιούχοι ηλεκτρονικοί, εκπαιδευμένοι στο κατασκευαστή Οίκο, με βεβαίωση.

Εξή από αυτούς καλύπτουν τον χώρο της Β. Ελλάδας.

Ο χρόνος παρέμβασης των τεχνικών μας είναι, εντός 48ώρου, και καλύπτεται ο χρόνος Κυριακών και αργιών.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγήησης καλής λειτουργίας των μηχανών η αποκατάσταση τυχούσης βλάβης περιλαμβάνει δωρεάν ανταλλακτικά, εργασία - έξοδα μετάβασης και επιστροφής. Δεν περιλαμβάνει περιττώσεις επισκευών και υλικών που οι βλάβες οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες φωτιάς, νερό, σεισμό, και κακό χειρισμό των μηχανημάτων με σκοπιμότητα ή όχι π.χ. πτώση, κτύπημα από το προσωπικό ή επισκέπτες, ή τέλος από κακή λειτουργία τροφοδοσίας ρεύματος και νερού.

Διαθέτουμε stock ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία, η δε απόστολή τους θα γίνεται εντός 24 ωρών από έγγραφη ειδοποίηση.

Κάθε τρείς μήνες θα γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση.

Ο χρόνος παρέμβασης στην εκτός λειτουργίας συσκευή δεν ξεπερνά καμία ώρα. Σε περίπτωση όμως μεγάλης βλάβης της συσκευής θα την αντικαταστήσουμε με άλλη εφεδρική που διαθέτουμε, μέχρι την επίκευή της. Πάντως, κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, η ακινητοποίηση του μηχανήματος δεν θα ξεπερνά συνολικά τις πέντε μέρες τον χρόνο.

Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα παραδοθούν τα μηχανήματα σε εύρυθμη λειτουργία.

Μετά τον χρόνο της εγγύησης υπάρχουν οι παρακάτω τρεις τρόποι συνεργασίας για την τεχνική στήριξη των Μηχανημάτων μας.

Οι τιμές που αναφέρονται παρακάτω και για όλες τις προτεινόμενες περιπτώσεις είναι σημαντικές και αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο σύμφωνα με τον επίσημο Δ.Τ.Κ. (Δελτίο Τιμών Καταναλωτή).

24

NORDKORMEIO		AK-200/S	AK-96/S	AK-10	BCM	FCM	AK-90/S	AK-100	REM	pp
NATURALI ANTIPEZZI T.N.	7	2						2	1	
NATURALI ANTIPEZZI M.KO	1	2								
LEPPEZZI ANTONOMIKH/MEFINNA	1	7	2	2			5		1	
LEPPEZZI T.N.			4	4			5			
LEPPEZZI T.N.	1									
LEPPEZZI T.N.	3	3	5	7	2		4			
BOGOLINI T.N.			10	9						
BOGOLINI T.N.	3									2
SPRATTO BKO NORDK		6								
SPRATTO T.N.	1									
TRICAVANTI T.N.			11	7	2		1			1
TRICAVANTI T.N.			7	6	2					
TRICAVANTI T.N.			10	4			2		1	
TRICAVANTI T.N.	6									
TRICAVANTI T.N.			8	1						
TRICAVANTI T.N.			12	9	4		5			
TRICAVANTI T.N.	1							3		
TRICAVANTI T.N.	5		2	4	2					

Α.- Επίσης πλήρες συμβόλαιο για συντήρηση και επισκευές χωρίς ανταλλακτικά.

Στην περίπτωση αυτή η κατά μήνα χρέωση είναι 181,41,- Ευρώ (εκατόν εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά) ανά Μηχάνημα. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι επισκευές καθώς και τέσσερις υποχρεωτικές επισκέψεις τον χρόνο για συντήρηση.

Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μετέβασης και επιστροφής των τεχνικών μας.

Δεν περιλαμβάνονται τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά των επισκευών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή καλύπτεται το συμβόλαιο με εγγυητική επίταξη ΦΠΑ.

Β.- Επίσης πλήρες συμβόλαιο για συντήρηση και επισκευές με ανταλλακτικά

Στην περίπτωση αυτή η χρέωση των επισκευών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών είναι 220,00,- Ευρώ (διακόσια είκοσι Ευρώ) ανά μήνα, ανά Μηχάνημα.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι επισκευές, όλα τα ανταλλακτικά καθώς και τέσσερις υποχρεωτικές επισκέψεις το χρόνο για συντήρηση. Η τιμή περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις πλέον του ΦΠΑ. Το συμβόλαιο καλύπτεται με εγγυητική επιστολή.

Εξοδα μετέβασης και επιστροφής βαρύνουν εμάς.

Γ.- Τιμή κλήσης κατά περίπτωση


Σε αυτή την περίπτωση η κάθε κλήση χρεώνεται με 542,92,- Ευρώ (πεντακόσια σαράντα δύο Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά) η πρώτη μέρα και εφ'όσον παραταθεί η παραμονή η κάθε μέρα επί πλέον χρεώνεται με 181,41,- Ευρώ (εκατόν εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά).

Τα έξοδα μετέβασης, διαμονής και επιστροφής βαρύνουν εμάς. Σε περίπτωση ανάγκης μεταφοράς του μηχανήματος στο εργοστάσιο, γίνεται επιπλέον χρέωση 176,08,- Ευρώ (εκατόν εβδομήντα έξι Ευρώ και οκτώ λεπτά).

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Η αναπροσαρμογή των τιμών γίνεται και εδώ τιμητικά κάθε χρόνο.

Στην περίπτωση αυτή εγγυώμεθα μόνο την εργασία που εμείς κάνουμε και όχι τυχόν άλλες παρεμβάσεις που έγιναν από τρίτους στο μηχανήμα. Τα ανταλλακτικά βαρύνουν το Νοσοκομείο σας.



Αυτόνομο service στα Νοσοκομεία

Η, κατά την γνώμη μας, συμφέρουσα λύση είναι να οργανώσουμε εμείς το service του Νοσοκομείου, δηλαδή:

Να εκπαιδεύσουμε τεχνικούς (1-2) με τους παρακάτω όρους:

- Να είναι ηλεκτρονικοί.
- Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιάς ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.
- Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους στις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο. Την υποχρέωση αυτή την υφίσταται το Νοσοκομείο.

Στη περίπτωση που θα συνεργαστούμε με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου, θα συστήσουμε τα όργανα και εργαλεία που χρειάζονται και θα βοηθήσουμε για την οργάνωση του Εργαστηρίου Συντήρησης - Επιδόξεως Τεχνικού Νεφρού.

Με το σύστημα αυτό και έχοντας πλήρη σειρά ανταλλακτικών, θα προσπαθήσουμε να γίνει το Νοσοκομείο αυτότεκτο και ανεξάρτητο.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι για την απόδειξη των ισχυρισμών μας για την ύπαρξη τεχνικών είναι στη διάθεσή σας οι μεθοδικές καταστάσεις που αποβόνται οι παραπάνω τεχνικοί από χρόνια. Για την απόδειξη της ύπαρξης stock ανταλλακτικών για μια δεκαετία, είναι στην διάθεσή σας οι επίσημες καρτέλες αποθήκης και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας για την προσωπική σας ανάλυση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
100000001	TRANSISTOR BD677AR	2.22
100000018	TRANSISTOR BUJ 32	5.84
100000022	HEX DIP IRFD113 AK100	3.74
100000082	TRANSISTOR	5.38
100002009	DIODE 3051	0.89
100002028	BRIDGE RECTIFIER GA.70V	11.24
100002043	SCHOTTKY DIODE	2.79
100005026	OPTO SWITCH	34.75
100008055	OPTO SWITCH PS250-2 AK100	4.80
100009111	OPTO-COUPLER	13.58
100007003	FILTER	38.61
100010032	IC MC1723CL	4.35
100010035	DRIVER ULN-2003A	5.58
100010037	AMPLIFIER LM324AN	5.89
100010038	IC MC1400BCEP	4.13
100010039	IC MC14002BCEP	1.63
100010046	CPU 6080 A	54.42
100010048	IC P8228	53.88
100010050	IC C8255	115.00
100010051	IC P8224	27.05
100010053	IC LM339N	2.74
100010057	IC LM 323K	28.28
100010062	IC DAC-08EZ	10.08
100010063	MC7812 CK	13.00
100010072	IC LM 148	21.04
100010073	IC REF 01CJ	14.46
100010074	IC MC1405BCEP	2.46
100010081	IC AD 7550 BD	88.25
100010082	IC AD 7502 JD	25.80
100010091	TTL SN74LS138N	2.24
100010095	RAM MB8114N	28.68
100010097	D/A CONV AD 558 JN	47.51
100010098	IC MK50816N	124.24
100010100	IC RPWM SG 3528 J	20.19
100010103	PROGR.INTER.CONT.	15.74
100010112	RAM 6116	41.74
100010113	TIMER AM 8513APC	143.75
100010116	IC SPACE TL 074	17.67
100010118	VOLTAGE REF.	14.24
100010121	RPWN	6.33
100010137	IC MICROCOMP MPD 8039	19.15
100010138	EPROM 8755 (K08200)	99.74
100010143	VOLTF. MONITOR 5 G 3543	32.50
100010147	STEPPING MOTOR DRIVER	13.03
100010163	DQ 2816 A-350	44.97
100010198	OCTAL-D-TYP	4.60
100010199	SN 75437	11.17
100010200	V/F CONVERTER VFC32KP AK100	18.20
100010239	C-MOS 74HC1574P AK100	3.01
100010240	C-MOS 74HC1245P AK100	5.02
100010276	HCT-MOS PCT74HCT14P AK100	2.13
100010288	IC PCD 8582	13.31
100010303	CPU AK100	92.00
100010318	IC AK 100	27.47
100010320	IC 4-PIN 1C16MHZ	23.22
100010326	CMOS DG509ACJ AK100	22.81
100010332	S RAM 32KB8	22.19
100010334	IC 18-PIN ULN2803A AK100	5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
100010351	IC LT1014CN	37.79
100010357	IC PC 744CT	1.08
100010375	EEPROM 8KX8 2864 AE	95.41
100010421	EEPROM	11.61
100010438	S RAM AK100	153.66
100010460	V/F CONVERTER AK 100	34.83
100010534	NON-VOLATILE RAM AK100	127.60
100010564	SAFE RAM IC66	279.29
100010669	DRIVER	53.19
100010670	SRAM	148.57
100010709	DIL 40 KEYBOARD	41.84
100010208	RESISTOR 18 OHM	2.40
100104007	RESISTOR 3R3 OHM	0.58
100104009	RESISTOR 4R7	0.58
100104045	RESISTOR 1 KOHM	1.08
100104046	RESISTOR 1K2	0.58
100104047	RESISTOR 1K5 OHM	0.58
100104060	RESISTOR 10K	0.58
100105051	RESISTOR 3K6	0.58
100105055	RESISTOR 7K2	0.58
100105010	TRIMPOT 5K	3.12
100106013	TRIMEK 50 KQ	3.12
100106014	TRIMPOT 1K	3.20
100108025	TRIMPOT 10K	3.12
100114031	CAPACITOR 47 mF	1.12
100118032	CAPACITOR 100 mF	1.11
100120018	CAPACITOR 150pf	1.11
100200019	TRANSIENT PROTECTOR 5V	7.32
100200021	RELAY 24 VDC, 8A, 220V	63.43
100200029	BAZER 12V 25MA	45.34
100200035	RELAY 12 VDC, 16 A, 380V	112.95
100200038	RELAY MONOST SA - 24V	63.31
100200042	OPTO RELAY 240D 25	93.64
100200043	RELAY 24 VDC 53104	48.63
100200046	RELAY 12 VDC 16A 380V	54.76
100200047	RELAY	48.05
100200049	BUZZER 3-15V, 20MA	21.27
100200049	RELAY 6VDC 5A BIST	70.92
100200050	RELAY 12V DC 330Q	29.74
100200051	RELAY AK100	57.50
100200055	BUZZER AK-100	27.16
100200067	RELAY 24 VDC	29.80
100200070	RELAY	54.32
100202067	FLAT CABLE CONNECTOR	24.56
100202068	CONNECTION JOINT	19.71
100202071	CONNECTORS	1.50
100202072	CONNECTOR HOUSING	1.48
100202074	CON PCB 40-POLE	45.18
100202075	CON (50-POLE)	32.86
100202088	CONNECTORS	10.88
100202102	CONNECTOR	1.53
100202103	CONNECTOR HOUSING	1.15
100202105	CABLE CONNECTOR	9.77
100202108	CONNECTOR	10.68
100202130	PC CONNECTOR	7.89
100202158	CONNECTOR D-SUB 9 POL M	9.45
100202157	CONNECTOR	0.84
100203047	CONNECTOR R PIN	1.44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
100203048	CONNECTOR SLEEVE	1.34
100203063	CONNECTOR PIN	0.87
100205042	COVER	1.45
100206004	DIP SHUNT	2.85
100208015	SIGNAL PUSH BUTTON 52015	71.53
100208016	SIGNAL PUSH BUTTON 52016	85.43
100208017	SIGNAL SWITCH	87.77
100208047	SWITCH	48.90
100208048	PUSH SWITCH	41.57
100209020	CAP. RED	4.01
100209021	LAMP LENS	4.01
100209022	GUARD	11.99
100209025	LENS	4.01
100210010	SIGNAL LAMP HOLDER 51320	30.80
100212001	FUSE HOLDER	7.53
100212002	FUSE HOLDER	8.98
100212004	FUSE HOLDER	7.85
100212005	FUSE HOLDER	7.28
100212006	FUSE INSERT	4.01
100212007	FUSE INSERT	5.12
100212011	FUSE HOLDER	7.06
100213007	FUSE F 1A (MONITOR)	0.78
100213008	FUSE 2.0 A FAST	0.78
100213009	FUSE 3.15 A FAST	0.78
100213010	FUSE 315 UA MA SLOW	0.78
100213015	FUSE 4A SLOW	1.17
100213042	FUSE 630MA SLOW	4.70
100213052	FUSE 10A FASTOW	1.17
100213055	FUSE 125 MA SLOW	1.17
100213057	FUSE 2.5A SLOW	1.17
100213073	FUSE	2.68
100213100	FUSE 6.25	2.68
100214029	CABLE GLIP	1.32
100214082	CABLE GRIP	0.63
100216024	MOTOR (PUMP)	173.05
100216012	NONRETURN VALVE	48.88
100220081	FLAT CABELING	13.34
100222016	LAMP 14V	4.52
100222017	LAMP 36V 30MA	4.83
100222026	LAMP AK-100	6.13
100222029	LAMP (ORANGE) AK-100	5.72
100222031	LAMP (GREEN) AK-100	5.72
100222032	LAMP (YELLOW) AK-100	5.72
100224006	BATTERY 9V	48.07
100224012	ACC. LI 3V 160mah AK100	20.15
100228002	MICRO SWITCH	28.34
100228009	MICRO SWITCH	33.73
100228020	PRESS. TRANSDUC.	370.75
100300016	PLASTIC WHEEL	6.13
100300017	WHEEL	7.36
100300018	PLASTIC WHEEL	5.52
100300021	WHEEL	7.68
100300046	WHEEL	3.07
100300058	KNOB	19.08
100301002	DIAL PLATE	2.63
100301004	ROUND NUT	1.19
100301006	STATOR	3.27
100301011	ROUND NUT	1.49

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
100301012	COVER PLATE	2.51
100301013	COVER PLATE	0.89
100301014	COVER PLATE	0.69
100301015	DIAL PLATE	2.69
100301016	DIAL PLATE	2.79
100301017	STATOR	3.25
100301018	ROUND NUT	1.78
100301027	COVER CUP	1.78
100304065	BOARD GUIDE	7.48
100304064	WHEEL AK-90	13.80
100307001	RUBBER FOOT	1.89
100307011	RUBBER FOOT	6.41
100307012	RUBBER FOOT	8.82
100312010	SHRINK TUBE	9.22
100312012	SIK TUBE 6X1.6	8.67
100312017	SIK TUBE 8X2.1	29.33
100312020	SIK TUBE 3X1	8.84
100312031	SIK TUBING 2X1	8.20
100312032	SILICONE TUBING	10.19
100312037	SIK TUBING 1X1	9.36
100312066	TUBE 1.5X8	11.88
100312078	ARMOURD TUBE 1.0 6MM	8.36
100312084	DEGLASSING TUBE AK100	4.89
100312093	ARM. SIK TUBING 5X30.0 MM	28.47
100312141	SANTOPRENE TUBE	7.53
100313253	PRESSURE REGULATOR	579.89
100314015	STRAP 0-18 MM	0.74
100314016	STRAP 0-30MM	0.74
100314060	BUSH	0.74
100314088	STRAP	0.74
100314189	INSULATE CASE	0.86
100314181	CLAMP BCH 10	1.18
100314184	CLIPS	1.26
100316001	PLASTIC SCREW 3X15	0.70
100316004	NYLON NUT M3	0.70
100316015	DISTANCE TUBE	0.50
100316027	INSERT AK90	3.23
100316030	SLEEVE	1.26
100316034	PLASTIC SCREW MCS 3X20	0.63
100316061	PLASTIC NUT 10M	1.26
100316074	SPACER	1.89
100316081	SPACER	3.84
100316107	FILTER HOUSING	119.72
100316134	PLASTIC NUT	0.77
100318010	O-RING 4.1 X 1.6	0.71
100318051	O-RING (15.3X24)	0.36
100318054	O-RING (55X1.6)	1.40
100318056	O-RING 98.6X1.6	3.78
100318061	ORING 22.1 X 1.6	0.70
100318064	ORING 11.5 X 1.9	0.70
100318085	O-RING (5.28X1.78)	0.85
100318086	V-RING-STIRER DFUD	6.73
100318090	O-RING (3.2X1.78)	0.69
100318084	O-RING (10.5X1.6)	0.73
100318085	RING 107.32X5.34	3.08
100318086	V-RING 11.5-12.5	2.09
100318091	O-RING 19.1 X 1.6	1.85
100318102	WASHER	2.87

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤ/ΚΟΥ
100318107	O-RING 74.61X3.53	1.32
100318109	O-RING BICART	0.71
100318110	O-RING (BICART) AK-100	13.39
100318111	O-RING EPDM	4.78
100318001	O-RING (38.2X3) STIRER	2.93
100318002	O-RING 3.3X2.4	2.78
100318003	ORING 7.1 X 1.8	0.73
100318004	CEM O-RING	2.00
100318006	O-RING (42X2.5)	1.93
100318007	O-RING (19.2X3)	1.53
100318008	O-RING (8.3X2.4)	0.89
100318009	O-RING (12.37X2.82)	1.45
100318010	O-RING	1.53
100318011	O-RING (37.7X2.82)	2.78
100318012	O-RING (15.6X1.78)	3.35
100318013	O-RING (19.1X1.5)	3.35
100318014	O-RING (4.1X1.6)	2.18
100318015	O-RING (45X2)	2.78
100318016	O-RING 5.28 X 1.78	1.78
100318019	O-RING (8.1X1.6)	1.40
100318020	O-RING (10.1X1.5)	1.40
100318022	O-RING	2.01
100318023	O-RING	1.40
100318024	O-RING 10X3	3.68
100318025	O-RING 6.1X6.1	1.40
100318026	O-RING 7.3X2.4	1.40
100318027	O-RING 9.1X1.5	1.40
100318028	O-RING 10.3X2.4	2.01
100318029	O-RING 15.3X2.4	1.51
100318030	O-RING 59.5X3	3.70
100318031	O-RING 6.07X1.78	2.51
100318032	O-RING ELECTRODE	2.85
100318033	O-RING 13.3X2.4	3.53
100318037	O-RING 23X1.5	4.38
100318038	O-RING 27X1.5	4.31
100318039	O-RING 5.3X2.44	1.51
100318042	ORING 22.3 X 3 SILICON	2.09
100318044	ORING 34.2 X 3.0	3.23
100318046	O-RING AK-100	1.58
100318047	O-RING AK-100	2.51
100318048	O-RING 22.1X1.5	1.51
100318050	O-RING 44.2X3.0	2.79
100318051	O-RING 0.5X1	3.35
100318054	O-RING AK100	2.05
100318055	ORING 17.3 X 2.4	2.09
100318056	O-RING 6.3X2.4	1.40
100318051	O-RING 4.85 X 1.78	1.40
100320008	SA SP PIN	0.84
100320010	PIN AK-100	0.71
100320020	EXPAND PIN BMM	0.84
100320022	CYLINDRICAL PIN (DOWEL-PIN)	1.23
100320023	PIN	1.40
100320033	PIN 1.5X10	1.40
100320057	CYLINDRICAL PIN	1.40
100320061	CYLINDRICAL PIN	1.40
100320065	PIN	1.40
100320076	CYLINDRICAL PIN (BP COVER)	1.40
100320078	PIN	1.40

31

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤ/ΚΟΥ
100322003	LOCKWASHER	10.89
100322008	LOCKING WASHER	1.40
100322007	NYLON WASHER	1.40
100322012	WASHER	1.40
100322049	WASHER 7.8 X 8 X 1 WULG.FIB	1.00
100322050	LOCKING WASHER	0.70
100322060	LOCKING RING	0.69
100328013	FAN AK-10	205.93
100329004	O-RING STIRER	6.57
100329008	GASKET	1.56
100329009	DRIVE MAGNET	28.33
100329056	GEAR BOX (PUMP) BCM	220.42
100329059	BASE PLATE BCM	123.21
100329061	FRONT PLATE	138.62
100329062	COVER PUMP BCM	13.69
100329072	MOUNTING PLATE	105.42
100329087	PUMP WHEEL AK-100	161.81
100329083	BELT AK100	24.44
100330009	GROVER RIDER	1.42
100330012	LOCKING WASHER BCM PUMP	0.71
100330014	GROVE RIDER	0.71
100330015	GROOVE RIDER AK100	0.64
100330021	C-CLIP BCH	1.45
100332019	RUBBER PAD	8.07
100334015	TUBE CLAMP	4.03
100334037	ANGLE CONNECTOR	7.39
100334038	CONNECTORS	6.85
100334039	CONNECTOR STRAIGHT	8.49
100334040	STRAIGHT PIECE	9.26
100334041	Inlet	13.86
100334042	V-JOINT PIECE	10.68
100334043	T-JOINT PIECE	15.11
100334044	T-CONNECTORS	12.59
100334049	TUBE CLAMP	4.22
100334067	PROTECTIVE PLUG	0.89
100334068	SA COVER (OBSOLETE)	2.57
100334199	Y-PIPE	8.62
100334199	SERVICE KIT FOR PRESS.REGULATOR	167.13
100335001	O-RING T-PIECE	1.23
100335002	LOCKING RING	1.40
100335003	EXPANDER RINET	1.26
100346002	PRESSURE SPRING	1.40
100346012	SPRING	0.61
100346020	SPRING BCH	8.38
100346045	SPRING AK-100	1.40
100346054	PRESSURE SPRING	2.79
100366308	SCREW PTKA 3 X 8	0.58
100366390	SCREW MCS 2X4	0.63
100370204	SCREW MCS 2X8	0.58
100370208	SCREW MCS 2X10	0.56
100370210	SCREW MCS 2X16	0.56
100370304	SCREW MCS 3X4	0.58
100370306	SCREW MCS 3X6	0.58
100370308	SCREW MCS 3X8	0.58
100370310	SCREW	0.56
100370312	SCREW	0.56
100370314	SCREW S 3X14	0.56

32

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
100370316	SCREW MCS 3X16	0.58
100370320	SCREW MCS 3X20	0.58
100370325	SCREW MCS 3X25	0.58
100370330	SCREW MCS 3 X 30	0.58
100370335	SCREW MCS 3X35	0.58
100370406	SCREW MCS 4 X 6	0.58
100370408	SCREW MCS 4 X 8	0.58
100370410	SCREW MCS 4X10	0.58
100370412	SCREW MCS 4X12	0.58
100370416	SCREW MCS 4X16	0.58
100370425	SCREW MCS 4X25	0.63
100370430	SCREW MCS 4X30	0.63
100370450	SCREW MCS 4X50	0.63
100370460	SCREW MCS 4X60	0.65
100370514	SCREW MCS 5X14	0.63
100370516	SCREW MCS 5X16	0.63
100370530	SA SCREW MCS 5 X 30	0.63
100370908	SCREW	7.17
100371001	SCREW	1.23
100372609	SCREW 6X9	0.63
100372613	SCREW RXSB 6X13	0.63
100372616	SCREW RXSB 6 X 16	0.63
100372625	SCREW 6X25	0.65
100373420	SCREW N 4X20	1.88
100373432	SCREW RX-PTN 4X32	2.52
100374306	SCREW MFS 3X6	0.61
100374308	SCREW MFS 3X8	0.63
100374508	SCREW MFS 5X8	0.63
100374510	SCREW MFS 5X10	0.63
100378508	SCREW MRS 5X8	0.63
100378510	SDREW	0.61
100380304	SCREW	1.32
100380405	SCREW SK6SS 4X5	0.63
100388612	SCREWMV MCS 6X12	0.63
100380200	NUT M6M2	0.63
100390901	NUT M8M2.5	0.61
100391003	NUT M16M 20X1.5	1.42
100391005	NUT	1.79
100392301	WASHER 3.2X6	0.63
100392802	WASHER 4.3X6	0.63
100392904	WASHER 8.4X16	0.63
100392906	WASHER	3.15
100830005	MEMBRANE FOR PRESS. REGULATOR	76.80
100850002	CONC. NIPPLE MALE A AK90	28.46
100850003	CONC. NIPPLE MALE B AK90	28.48
100850004	CONC. NIPPLE FEMALE A AK90	37.79
100850005	CONC. NIPPLE FEMALE B AK90	37.79
100850007	PICK UP TUBE "A" AK90S	41.07
100850008	PICK UP TUBE "B" AK90S	41.07
100850009	COVER CONC. INTAKE A AK90S	5.98
100850021	TUBE AK90	41.07
100850026	O-RING 2-8 AK90	1.53
100850027	O-RING 2-5 AK90	1.53
100860001	OVER PRESSURE GUARD	110.21
113911034	CONN. PANEL	20.07
113911001	MAINTENANCE KIT AK-10	798.43
113900552	BODY CASTING EB AEA/FEA	903.57
113502500	2500H MAINTENANCE KIT AK95S	151.37


33

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
113602500	2500H MAINTENANCE KIT AK 90S	151.50
113601500	1500H MAINTENANCE KIT AK100	151.82
120110120	PIPE 1/2 X3/4	2.52
120815040	PLUG-INTERNAL THREAD-1/4"	2.52
120816480	PLUG CONN. 8MM	2.61
124462480	CONNECTOR 8MM	2.61
124463484	UNION Y HOSE CONNECTOR (8MM)	2.61
124468480	STR. CON. 8MMX1/4	2.71
124468486	STR. CON. 8MMX3/8	2.82
124468488	STR. CON. 8MMX1/2	2.82
220800040	SOCKET	8.85
260010010	6X12 ARMORED TUBE	1.93
260010030	8X14 ARMORED TUBE	1.93
300333014	SAMPLING KIT (DX)	160.00
300333015	REF. SOL. 13.4mS/CM	51.13
300333018	REF. SOL. 1000 uS	51.13
00002555E	BATTERY 9V ALKALINE	5.86
04012280-	FAN CLF825 8X8X2.5 24VDC 8025	15.84
10010564E	SAFE RAM	78.97
10030405E	POAES STAND	2.42
10031810E	ΦΙΑΤΡΟ SENIOR DUPLEX 3P 3/4"	36.75
10033404E	T-CONNECTORS 5/16"X1/8"PL	12.93
112200-0E	INITIAL PB SUNLIGHT POWER 12V-7.2 AH	30.12
1497-000E	ACCUMULATOR	322.37
1KK1PTL--	P Φ100X32MM 81ΔA M10X25 FKPI	30.40
21-17002E	BATTERY PD	105.28
21-871576	OPTO BOARD PD100	435.72
21-87879R	REPAIRED DISPLAY BOARD PD 100	884.55
2KPTPTL--	P Φ100X32MM BIA+OP M10X25 FKPI	37.33
3003331CR	CALIBRATION OF REFER INSTRUMENT	1020.98
3354-000E	MEATING SAFT 9V 8.4 BLISTER	25.24
500229001	HANDLE PUMP AK-10	10.18
500248A--	ROTOR PUMP	846.96
K01515002	NIPPLE	2.10
K02691001	RUBBER MOUNTING	7.49
K0302800E	KNOB	1.22
K03343A--	ARMORED TUBE AK-10	8.65
K04274001	COVER PANEL AK-10	21.60
K04315001	COVERS FOR PW10	45.36
K04387A--	LOCKING SLIDE AK-10	22.10
K04403001	CLAMPS	3.91
K04405001	COVER CLAMP	4.44
K04405003	COVER AK95	4.35
K04406001	HOUSING (CLAMP)	5.04
K04407002	HOUSING HALF AK95	12.59
K04438001	HOUSING + UFER DEGASS	42.91
K04438002	HOUSING + LOW DEGASS	42.91
K04437001	BRACKET (VESSEL)	3.70
K04438001	FLOATER (DEGASS.) DFUD	19.93
K04471C--	CONTROL LOGIC BMM	492.17
K04475004	MOTOR CONTROL BOARD BMM	866.33
K04502001	COVER DFUD/UDM	39.70
K04507A--	COMPRESS. SOLENOID (CLAMPS)	418.05
K04508A--	MAGNET ASS. CL UNIT	987.52
K04510A--	ARTERIAL PRESS MON BMM	49.29
K04511A--	SWITCH ASS. (A.P. MONITOR)	166.34
K04513002	TRANSISTOR B0677AR	6.30
K04578001	MOUTHPIECE PLATE	47.31

39

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K04518001	VALVE INSERT	10.68
K04520001	VALVE HOUSING	112.61
K04521001	PLUG	25.63
K04528E-	ANALOG+GYAR BOAR DFM	1177.38
K04528ER-	PCB	427.14
K04538011	POWER SUPPLY BARD DFM	1240.90
K04538F-	POWER SUPPLY BOARD	287.88
K04538H-	POWER SUPL BMM	605.98
K04544E-	CABLING	94.48
K04551001	SPRING MOUNT	22.04
K04555001	SCREW AIR DETECTOR	15.66
K04557A-	KNOB+BMM	22.51
K04559A-	HEATING ELEMENT DFUDM	252.59
K04561A-	PUMP ROTOR HEP BMM	64.07
K04569A-	CABLING CHASSIS	41.07
K04571A-	FLAT CABLING (PANEL)	92.41
K04572C-	FLAT CABLING	95.83
K04577A-	CABLING+DFUD 117	99.26
K04621A-	DEGASSING UNIT	425.98
K04622A-	FLOW METER 119.47	102.68
K04629BR-	COND. CELL A	566.78
K04629CR-	REPAIRED COND.CELL BCM	566.78
K04629ER-	REPAIR CONDUCTIVITY CELL BCM	291.98
K04630A-	TEMP.TR.HEAT	17.80
K04646A-	STRAINER DFUD	508.21
K04647001	BLOOD.FLOW METER BMM	1012.00
K04648001	VEN.PRESS METER	747.50
K04649001	NEG.PRESS METER	816.07
K04650001	TEMP METER DFUDM	827.67
K04651001	CONTACT. METER	180.71
K04684A-	WATER VESSEL	7.23
K04706001	DIAL PLATE	1285.00
K04721A-	MOTOR AK-10	171.68
K04723005	PRESSOSTAT	127.38
K04723007	PRESSOSTAT	146.71
K04724001	PRESSOSTAT DFUD	20.95
K04737001	SCREW	2.05
K04749E-	AIR FILTER (REAR PANEL)	82.14
K04779A-	CABLING (BOARDS)	65.71
K04803001	FLOAT UNIT (DEGAS)DFUD	5.58
K04811001	SPACER	92.41
K04812001	PUMP HOUSING 112.29 DF	25.74
K04813001	PUMP MOUNTING PLATE DFM	16.77
K04817001	QUICK LOCK (MICR.PUMPT) DF	18.26
K04818001	FLEXIBLE MOUNTING	28.16
K04847A-	SA DIAL PLATE	3.27
K04857001	P7-100 TEMP. TRAN SD	258.75
K04884001	COVER (P PACK)	17.03
K04898003	CLUTCH HALF	97.20
K04898A-	CLUTCH HALF AS	59.55
K04898E-	CLUTCH HALF ASS.	81.67
K04899001	CLUTCH HALF	31.32
K04901001	CLUTCH INSERT	7.94
K04905001	POT. COVER (H.VESSEL)DF	5.89
K04968001	POTENTIOMETER	28.06
K0497001	SWITCH	11.19
K0497001	POTENTIOMETER	2



33

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K05041001	CHOKE BUZE	11.83
K05047001	NIPPLE (H.VESSEL)DFUDM	17.41
K05230001	BUSHING	17.60
K0523000E	BUSHING	16.83
K05287A-	CABLING	14.24
K05288001	SHAFT STIRER	28.48
K05299001	HOLDER (STIRrer UDM)	28.90
K05314001	NIPPLE	3.56
K05316001	PLASTIC STOP	34.58
K05320EE-	STIRER ASS (114/51)	510.46
K05329A-	FLOW REDUCING BLOCK	13.81
K05355001	BUTTON TRAY (STAND)	172.50
K05397001	COVER PLATE	3.42
K05473001	PLUG	27.60
K0547900E	NUT	1.76
K05522001	SCREW	18.89
K05525001	PRESSURE BAR	62.40
K05571003	LEVEL BLOCK DF	39.87
K05788A-	TRANSIENT PROT.	19.17
K05780002	TUBE	8.82
K05795001	NIPPLE	54.16
K05796001	NUT	10.35
K05824A-	CABLING (BOARDS)	209.00
K05895001	ROTOR W/BMM FINGERGRIP	5.46
K058957D-	CONCENTR.FILTER	24.35
K05989A-	CODE SWITCH HFM	370.49
K06014001	MOUNTING PLATE	11.39
K06124A-	FRONT PANEL HFM	219.98
K06155001	TEMP. TRANSD.HFM	62.98
K06184001	HOUSING B.L.D.	56.53
K06165001	FILTER	49.84
K06170B-	PRES. TRAN. BOARD	114.34
K06176A-	UPPER PART (STAD) AK-10	263.87
K06183002	RECEIVER BOARD AK-10	66.63
K06200001	RETAINING CATCH COVER	2.34
K06271001	PRES. TRANSD.H.	153.65
K06272001	CABLING	50.33
K06296001	COVER	13.63
K06511001	ADJUSTING RING	7.53
K06528001	COVER (B. PLATE)	99.06
K06734001	O-RING FILTER HSNG	4.95
K06944001	10POLE EXT.CABLE INB.	52.90
K07030001	STEP.MOTOR BMM	262.82
K07070001	PRESSURE REGULATOR	413.23
K07106001	DIAL PLATE	7.56
K07116001	TRANSMITTER BOARD	138.55
K07118001	RECEIVER BOARD HFM	157.44
K07155001	NIPPLE	65.93
K07315001	SPRING	1.59
K07316001	WASHER	1.56
K07329001	WASHER	16.90
K07421001	WASHER	2.85
K07422B-	OVERHEAT GUARD (H.VESSEL)	85.43
K07427001	FUSE BOARD	135.12
K07434001	PLUG	3.32
K07484001	DIAL PLATE	4.23
K07485404	GPU BOARD (2)	1047.94
K07571001	HOLDEF	28.39



36

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K07542001	NUT	18.62
K07642001	PRESSOSTATE	238.63
K07657001	HOLDER	27.52
K07659001	MOTOR 4.1 WRO 10-01	2036.55
K07674001	SLIDE BEARING	0.90
K07688002	BACK PANEL BOARD	124.65
K07688003	POWER SUP BCM	1136.75
K07688003R	REPAIR PCB	537.40
K07720001	SCALE PLATE	6.16
K0772003R	PCB	625.98
K0772205R	COND. CONTROL	504.77
K07728001	STEERING	22.18
K07758005	POWER PACK	1275.30
K078443001	MAGNET HUB ASS.	140.19
K07860001	COVER FCM BCM	42.17
K0790804R	REPAIR PCB	712.62
K07908003	DC-DC BOARD	1322.42
K07908003R	DC-DC BOARD UFM	662.46
K07915001	PANEL BOARD	330.57
K07918002	CABLING INT.	257.72
K07928001	CABEL SER.INT.	19.21
K07931001	WIRE SYSTEM	78.46
K07937001	CABLE STEM	28.68
K07994001	POTENTIOMETER	17.0
K08008001	PACKING	10.8
K08038001	PR. TRAD. HOUSING	12.22
K08056C-	DISTANCE PLATE	12.48
K08056C-	VALVE MEMBRANE	372.30
K08062002	VALVE UNIT	244.75
K08093001	INTERFACE UFM 10-2	230.00
K08137001	PRES. TRANSD. BOARD	7.39
K08168001	COVER 114.17 DFJUD	180.71
K08171002	CABLAGE 3.41 BCM	32.17
K08177001	SCREW	195.45
K08178001	DISPALY BOARD	72.56
K08214001	NIPPLE	58.13
K08215001	NIPPLE	24.84
K08219001	TUBE	1.81
K08227001	SEALING WASHER	65.49
K08298A-	TUBE FOR FCM	8.87
K08351001	CABLING	176.95
K08410A-	FRONT PANEL DFJUDM	6.57
K08447001	FLOW REDUCER	11.59
K08500A-	NON RETURN VALVE	0.94
K08502001	SPRING	8.22
K08542001	LOCKING SLIDE	8.22
K08542002	LOCKING SLIDE	103.15
K0879800E	MAGN. VALVE (1L344S57X & 1L530A220AC)	105.94
K08940001	REB. KIT DFJUD	3.42
K08961001	TUBE A FOR BCM	2.90
K08962001	TUBE B	50.38
K08965001	TUBE KIT B.C.M.	39.10
K08995001	POSITION PLATE	31.49
K09032004	TULE-NIPPLE	36.62
K09032004	IFC CABLAGE 14P 210MM	125.95
K09033002	AIR DET. CABLING BMM	18.89
K09057001	CABLING DFJUD	7.81
K09059001	TUBE HOLDER	

37

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K09080001	NIPPLE	2.55
K09081001	NIPPLE	9.45
K09084001	BOTTOM PLATE	233.28
K09086003	MOTHER BOARD BMM	261.35
K09078001	VALVE HALF-M.V	6.13
K09077001	VALVE HALF-M.V	5.09
K09078001	VALVE HALF-M.V	5.91
K09089001	VALVE HALF-M.V	4.38
K09097001	TUBE HOLDER	77.46
K09099001	INF UNIT VALVE	450.73
K09210A-	PUMP ROTOR BCM	162.31
K09283001	BLOODLEAK DETECTOR FM AK100	489.43
K09347A-	BLOCK HALF UFM	28.60
K09351B-	BLOCK HALF FCM	34.23
K09365001	A/D CONVERTER	244.02
K09424001	PLATE	5.18
K09540001	POTENTIOMETER	46.00
K09863004	TUBE SENS. TRANSMITTER AK 100	103.50
K09866004	TUBE SENS. RECEIVER AK 100	113.97
K09881001	FAN COMPL.	129.48
K09889001	CONNECTORS	2.55
K09977B-	LEVEL SWITCH	157.30
K10010001	TRANSDUCER	9.69
K10040001	CHOKE COIL AK100	28.93
K10091001	MAGNET	108.57
K10094001	MAGNET CUP	29.58
K10095001	MOUNTING PLATE	485.20
K10140001	MICROPROCESSOR	374.05
K10158001	TUBE HOLDER	85.06
K10229001	MICROPR. BOARD	970.24
K10229002	MICROPROS. BOARD	1088.69
K10345001	COVER PLUG PRES	22.45
K10488A-	MAGNET HUB	64.40
K10592001	UNIT SERV. KIT	324.33
K10607001	V-RING	11.58
K10640001	SERVICE KIT WRO	1701.58
K10688001	AIRFILT. HOLDER	18.55
K10677001	TUBE	43.15
K10707002	DC FAN	298.64
K10727001	NIPPLE	48.60
K10728001	IN-OUT BLOCK	8.88
K10731001	NIPPLE	45.38
K10768001	ARMoured TUBE	12.32
K10771001	TUBE	11.06
K10784001	PUMP HEAD WRO STD	907.49
K10815001	TUBE NIPP. FCM	17.63
K1082401R	CONTROL LOGIC (R)HFM	320.47
K10857001	FILTER (SUCTION)	16.10
K10929001	HOUSING FOR KUWANO INSTR.	85.87
K10943A-	SCREEN FILTER UFM	25.60
K10988001	STRAIGHT CONNECTION	4.34
K10988002	TUBE CONNECTOR	6.82
K11014001	FLOATER HOUSING	15.09
K11021001	NIPPLE	101.25
K11437001	AIR DET. C.BMM.	5.58
K1137002	AIR DETECTOR HEAD (GREY)	5.58
K11222001	FRONT PANEL BMM	184.80
K11236001	BCM PUMP BRACK	19.58

38

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K11329001R	DISTR BOARD AK-100	415.64
K11332001	CLAMP DRIVER BOARD	304.75
K11335003	PRIMING+BOARD DET.	98.57
K11344004	DIS. BOARD AK100	881.25
K11344004R	REP.DISTR BOARD BPA	450.96
K11347004	DISTR BOARD BPV	861.41
K11415001	PH DRIVER BOARD FM AK-100	410.72
K11488001	CLAMP AK100	2.34
K1150300E	AIR FILTER	2.05
K11504A-	COVER FILTER AK100	68.45
K11504B-	COVER (FILTER)	8.22
K11505001	TUBE AK100	5.89
K11508001	HOUSING AK100	50.27
K11507001	SPACER AK100	6.90
K11508001	RUBBER PLATE AK-100	30.71
K11513001	NIPPLE AK100	18.52
K11521001	NIPPLE AK-100	14.18
K11562001	SCREW AK100	10.71
K11579001	WASHER AK100	1.82
K11586002	FLOW REDUCER 500ML	95.38
K11615001	BRACKET	16.87
K11641001	SHAFT	28.18
K11643001	HOLDER HEP PUMP AK-100	85.03
K11647A-	PUMP HOUSING AK100	27.12
K11670001	COVER FILTER FM AK100	32.17
K11670002	COVER FILTER BM AK100	40.22
K11670003	AIR FILTER HOLDER	12.87
K11682001	LOCKING SLIDE AK100	4.27
K11682002	LOCKING SLIDE AK100	23.93
K11717001	GASKET	319.01
K11732001	DISTANCE	12.31
K11782001	MOTOR AK100	3.18
K11825001	COVER	3.39
K11830002	LUER NUT BLUE AK100	368.41
K11830003	LUER NUT RED	543.13
K11845A-	LEVEL S AK-100	450.42
K11849A-	TEMP. TRANSDUSER AK100	970.87
K11849C-	TEMP. TRANSD AK200	20.90
K11866A-	SOLENOID	62.98
K11874001	DISTANCE	28.75
K11876001	ADAPTER AK-100	59.10
K11885001	FLEXIBLE MOUNTING DFUDM	6.65
K11913A-	NIPPLE PP	6.28
K11982001	ANGLECONNECTOR	7.83
K11982002	ANGLED CONNECTOR	37.02
K11982003	ANGLED CONNECTOR	38.73
K12054001	SUCTION TUBE	3.94
K12055001	SUCTION TUBE A BCM	123.87
K12055002	SUCTION TUBE B BCM	471.09
K12073001	PIN	256.53
K12074001	HEPARIN PUMP HOUSING	18.51
K12105002	INTER BCM	32.53
K1210500R	INTERFACE BCM 10-3	29.90
K12138001	CLIP	1
K12138001	SHAFT COUPLING	9
K12164001	NIPPLE	
K12185003	PAIR DET. HEAD	

3P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K12185005	AIR DETECTOR HEAD AK 85	176.20
K12185008	AIR DETECTOR HEAD AK-90	184.48
K12185008	AIR DETECTOR AK85 AK200	184.48
K12188001	WASHER	41.58
K12225001	GUIDE	56.24
K12233001	PLATE DEGASSING CHAMBERT	3.56
K12268A-	CLAMP	22.18
K12284001	CONTROL LOGIC BMM	709.49
K12284003	CONTROL L BMM	930.19
K12281001	MAGNET	92.00
K12299001	PH SENSOR	415.64
K12312002	REAL PANEL	100.78
K123820CH	ROTARY SWITCH	47.45
K12388A-	NIPPLE	41.40
K12508001	MAGNET FOR B.P.	3.76
K12540001	COVER LOWRAK 10	287.50
K12540003	COVER BMM	287.50
K1261400E	ANGLE CONNECT.	11.87
K12711001	HANGER L AK90	10.10
K12712A-	ARM DIA-FILTER AK90	12.21
K12717001	SEALING STRIP AK 80	33.54
K12718001	HANGER R AK90	58.87
K12731A-	INSERT LEFT	12.21
K12732001	PIN AK 80	20.28
K12753A-	FAN COMPL BSM	8.80
K12763001	PRESSOSTATE BSM	170.66
K12763002	PRESSOSTATE	252.46
K12781A-	TEMP UNITAK90	255.68
K12785001	PT-100 TEMP. TRANSD.	415.64
K12786001	SAFETY BYPASS HOUSE AK90	203.45
K12808001	HOUS. LOWER BCH	4.27
K12807001	COVER LOWER BCH	67.73
K12808001	COVER UPPER BCH	20.29
K12809001	HOUS. UPPER BCH	36.68
K12812001	FLOW REDUCER BSM	63.09
K12812003	FLOW REDUCER	47.23
K12812008	FLOW REDUCER (5B)	47.23
K12812011	FLOW REDUCER (1)	47.23
K12812012	FLOW REDUCER AK 200	49.27
K12813001	LOCKING +BCH KNOB	5.28
K12833001	NIPPLE AK90	23.40
K12841001	PACKING AK-100	9.43
K12833001	VALVE HOUSING	82.58
K12833002	VALVE HOUSING AK90	71.43
K12840001	COVER BCM 10-3	3.07
K12950001	DEGASSING UNIT BCM 10-3	188.93
K12950002	DEGASSING UNIT AK90S	195.77
K12950007	DEGASSING UNIT UDM	347.46
K12951001	TUBE CONNECTOR	5.56
K12981001	JOINT B.S.M.	9.29
K12981004	CONNECTOR	18.40
K12963A-	INSERT RIGHT AK 90S	24.56
K1286600E	AIR FILTER AK-90	2.05
K12970001	FILTER HOLDER	71.83
K12866002	VALVE HOUSING	12.87
K12990001	NUT FOR HANSECONN.	3.08
K12997001	NUT	12.57

40

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K13036001	BATT.HOLDER	35.30
K13094001	RELAY BOARD AK90	434.26
K13257001	OVERLAY DISPLAY GB AK100	248.18
K13272001	COVER AK 100 F.CELL	29.70
K13303001	VALVE HALF BICART	83.90
K13304001	VALVE HALF BICART	212.55
K13305001	NIPPLE ABC-10	10.15
K13321001	INNER MAGNET 100	123.21
K13325A--	MAGNET CUP AK-100	40.94
K13344001	CABLING BICART	60.37
K1334800E	CABLING BICART	74.69
K13350001	MAGNET SENSOR BICART	40.54
K13350002	MAGNET SENSOR BICART	65.39
K13355001	REDUCER MEMBRANE	30.48
K13357001	FLOW REDUCER AK100	65.81
K13412001	GASKET	3.18
K13429A--	END BRACKET AK100	57.50
K13451001	PIN AK-100	1.34
K13452001	VALVE HOUS AK-100	4.85
K13452002	VALVE HOUSING	8.21
K13453001	VALVE HOUSING	4.93
K13453002	VALVE HOUSING	14.20
K13467001	SUCTION TUBE FM-100/102AK	79.41
K13467002	SUCTION TUBE FM-100/102AK-100	79.41
K13474001	COVER BICART	14.49
K13563A--	LEVELGUAD	176.68
K13568A--	WATER VESSEL AK100	138.77
K13569B--	WATER VESSEL AK200	132.06
K13574001	TUBE	11.34
K13588001	PROTECTION PLATE BM AK100	29.57
K13588001	FRONTNIPPLE	97.26
K13891001	BAR GRAPH-AK100	629.28
K13993001	KEYTOP (KEYBOARD) AK100	19.98
K13700001	LED DISPLAY (KEYBOARD) AK100	52.57
K13718001	LAMP AK 100	10.24
K13735001	FILTERHOUSE AK-100	3.28
K13736001	FILTER NIPPLE	3.28
K13739001	NIPPLE AK-100	2.83
K13798001	DISTANCE	19.52
K13828001	BLOOD PUMP COVER KIT	32.03
K13847001	NIPPLE AK-100	18.52
K13893A--	HOLDER BCH 10	70.48
K13895001	COVER (COND.CELL) AK-100	30.02
K13908001	POSITION BLOCK BCM 10-3	58.12
K13942001	INFO DISPLAY AK100	442.09
K14028001	NIPPLE AK 90	4.24
K14028002	NIPPLE AK 95	4.24
K14032001	NIPPLE FOR AK-10	5.18
K14033001	NIPPLE FOR GAMERO CONN.AK100	5.94
K14034003	DRIP CHAMPER HOLDER	39.43
K14034005	DRIP CHAMBER HOLDER	33.95
K14041001	PRESSURE TRANS.D HOUSING AK100	7.83
K14057001	CABLING BCH	74.94
K14061001	QUICK CONNECTOR RED	66.99
K14061002	DIA CONN RED/GREY	66.99
K14062001	QUICK CONNECTOR BLUE	66.99
K14062002	DIA CONN BLUE/GREY	66.99
K14068001	HOLDER BCH 10	96.72

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K14131A--	NIPPLE FOR 8MM TUBE BCM	31.49
K14132A--	NIPPLE FOR 8mm TUBE	31.49
K14136001	NIPPLE	3.87
K14181001	MOTOR CONTROL BOARD	982.04
K14179001	PRESSURE TRANS.D HOUSING AK100	23.66
K14179002	PRESSURE TRANS.D HOUSING AK100	23.00
K14188001	EA-EE FROM ADAPTOR	153.14
K14207001	FETING PUMP BCM	1305.09
K14207006	DOSING PUMP AK 200	1540.18
K14318001	CABLING FCM	44.43
K1431900E	RELAY BOARD FCM	228.85
K14323001	B-CONCENTRATE NIPPLE AK-100	26.94
K14355002	CONTROL LOGIC 8MM 10-HP	1028.10
K14359001	ANALOG GUARD BOARD HP	1081.58
K14363001	CHONICAL TUBE AK-100	4.65
K14387A--	COVER AK-100	88.78
K14402001	TUBE HOLDER	14.57
K14425001	BYPASS VALVE BCH AK-80	31.05
K14437002	SPIKE HOUSING	126.38
K14508001	LAMP AK-100	9.20
K14540002	GASKET	2.68
K1450503R	UF-MEASURING UNIT AK100	1594.00
K1450601R	FLOW CELL FCM	1772.20
K14508001	VALVE REPAIR KIT	42.80
K14608002	VALVE REPAIR KIT	2657.10
K14621001	STEPPING MOTOR	595.50
K1463801R	CONDCELL AK-100	575.28
K1463701R	COND.CELL 2 AK 100	862.50
K14648001	LAMP (RED) 24V	9.86
K14649001	LAMP(GREEN) 24V	9.86
K14650001	LAMP (YELLOW) 24V	9.86
K14651001	LAMP (ORANGE) 24V	9.86
K146780C--	BLOOD FLOW KNOB AK200	14.05
K14687A--	AIR FILTER AC/DC UNIT AK100	18.25
K14711001	CHAMBER AK100	13.14
K14711002	CHAMBER AK100	13.14
K14711004	CHAMBER BUBBLETRAP 2 AK90S	13.80
K14712003	DIST.BOARD 90	416.27
K14715002	EXPANSION CONN.BOARD AK-80	832.34
K1471501R	REPAIR EXPANSION CONN.BOARD AK-80	386.40
K1471502R	REPAIR EXPANSION CONN.BOARD AK-80	377.04
K14723001	CABLING W.MICROSWITCH AK80	75.90
K14805001	NIPPLE	2.52
K14834001	LIGHT GUIDE 1 AK100	41.09
K14835001	LIGHT GUIDE 2 AK-100	35.60
K14837001	PRIMING DETECTOR AK-100	102.92
K14837002	PRIMING DETECTOR AK-95	104.27
K14898001	OVERLAY AK90S ENGLISH	213.49
K14808002	SPIK HOUSING	145.10
K14908001	BYPASS NIPPLE	6.35
K14910001	CABLING BCH AK100	98.24
K14920001	QUAD-RING CONN.	3.22
K14944001	FILTER BCH AK100	13.84
K1494701R	COND.CELL OFMUDM	394.29
K1494702R	REPAIRED COND.CELL BCM	394.29
K15035001	MAGNET	89.44
K15035002	MAGNET	107.95
K15038001	GASKET	8.24

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K15049001	SPACER AK100	24.53
K15059001	TUBE SET	23.96
K15083002	MIXING H COMPLET AK100 ULTRA	139.32
K15087001	WASHER FOR FEEDING PUMP AK-100	14.37
K15107A-	COVER AK100	9.45
K15107C-	COVER AK100	44.08
K15114001	COVER AIR DET.(WHITE)	7.25
K15114002	COVER AIR DET.GREY	7.25
K15120001	WASHER	1.51
K15120002	WASHER	1.51
K15131001	EXCENTER	176.08
K15143001	VENOUS PRESS.LINE AK100	24.56
K15144001	SYSTEM PRESS.LINE AK100	26.18
K15146001	DISC FILTER AK-100	16.76
K15146A-	DISC FILTER AK100	18.80
K15162001	MOTOR HOLDER REDUC.	13.10
K15168001	PRESSURE MONITORING LINE BSM	17.80
K15170001	DEGASS.UNIT KIT	437.82
K15232001	NIPPLE	5.29
K15235A-	2 WAY VALVE HOUSING	79.88
K15267A-	PUMP HOUSING AK-100	34.01
K15284002	SIGN. AK 90S	10.51
K15300001	WASHER	23.60
K15318001	BLOOD PUMP MOTOR	1514.50
K15391C-	VALVE MOUNTING TOOL	183.00
K15393A-	MOUNTING PLATE AK100	111.45
K15457A-	MOUNTING PLATE RED.UNIT AK100	114.80
K15510001	REDUCING UNIT AK100	1341.67
K15514001	SPECIAL VALVEHOUSE AK100	113.37
K15514002	VALVEHOUSE	128.89
K15541A-	NIPPLE	24.53
K15541B-	LUNDIA ARM	23.66
K15552001	CLIP	20.26
K15595001	DIA CONNECTOR RED	76.67
K15595002	DIA CONNECTOR BLUE	76.67
K15610001	ART.BLD PUMP BEARING	448.51
K15610002	VEN.BLD.PUMP BEARING(REP/ICES B00282002)	448.51
K15610004	BEARING UNIT	236.13
K15622001	VALVE UNIT AK100	195.77
K15623001	VALVE UNIT AK100	158.62
K15627001	HOUSING LOWER	43.52
K15670003	ROTOR GUARD BRD.	59.85
K15684005	HEATER 220V	1232.14
K15691001	WASHER AK100	7.94
K15722A-	LOCK PIN	22.79
K15723001	PUMP HOUSING GABLE	83.44
K15724001	PUMP HOUSING STIRRER	101.84
K15740007	AC/DC UNIT 230V/AX95	2310.46
K1574001R	AC.DC.POWER SUP	1301.14
K1574004R	AC/DC UNIT REPAIRED 220V AK-85	1301.14
K1574007R	AC/DC UNIT 230V AK-95	1301.14
K15761001	HEPARIN PUMP COMPL.	1386.16
K1576101R	REP.HEP.PUMP	710.97
K15848A-	FLOATER AK 80	87.28
K15876002	HEAT EXCHANGER AK-90	542.14
K15937001	VALVE HOUSING	16.39
K15938001	TRANSM.BOARD	95
K15943001	BLOOD LEAK DETECTOR AK80	54

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K16001002	LUER HOUSING BLUE AK100	3.18
K16001003	LUER HOUSING RED	3.36
K16089001	GUIDE ROLLER	12.84
K16090001	GUIDE PIN	15.40
K16148A-	TUBE	73.04
K16162001	SUPP.NIPL. AK-80	21.36
K16178001	ENCODER UNIT HEP PUMP	476.84
K16211A-	TUBE UNIT AK100	188.56
K16214001	O-RING	5.67
K16215001	BLOOD LEAK DET.	30.72
K16232A-	STEPPING MOTOR	286.93
K16273002	OUTLET NIPPLE	16.28
K16273003	INLET NIPPLE	18.78
K16385001	NIPPLE	9.61
K16386001	NIPPLE	13.31
K16415002	POWER FAIL EXTENSION BOARD	278.00
K16513004	HOLDER AK95	11.96
K16538A-	FILTER (SUCTION TUBE)	15.33
K16655004	MM I/O BOARD AK 95	1231.44
K16658003	MM I/O BOARD AK 95	1410.71
K1665803R	I/O BRD AK 95	584.93
K16812001	PROTECTION COVER	47.23
K16884002	EXPANSION CHAMBER	35.49
K16884004	EXPANSION CHAMBER AK95	34.01
K16952A-	DEGAS TOP VALVE	29.75
K16963001	HOLDER FILTER	22.04
K16980001	PRESS. TRANS.AK200	5850.63
K1710300E	AIR FILTER	0.81
K17113A-	LEVEL GUARD AK80	166.35
K17237001	T-CONNECTOR BCH AK 200	9.01
K17481001	SHAFT BCH AK 200	23.66
K17552002	PROTECTION DRIVER BOARD AK95	2020.70
K17552AR-	REPAIRED PROTECTION DRIVER BOARD AK95	986.21
K17725001	SILICON CONNECTOR	10.69
K17878001	NON.RET.VALVE AK100	14.17
K17980007	CONC.NIPPLE MALE A AK90/95	35.85
K17990008	CONC.NIPPLE MALE B AK90/95	35.85
K17991007	COVER CONC.INTAKE A AK90/95	31.54
K17991008	COVER CONC.INTAKE B AK90/95	31.54
K18002001	TOPP.TRAY AK100	228.51
K18004002	AC/DC UNIT AK-200	2847.62
K1800401R	REPAIRED AC/DC AK200	1415.60
K1800402R	REPAIRED AC/DC AK 200	1536.07
K18047001	HOLDER PRIMING AK200	28.37
K18048001	DOOR	35.24
K18048002	DOOR	31.21
K18048002	CLAMP UNIT	132.25
K18084001	DRIP CHAMBER HOLDER	53.42
K18124001	COND.CELL 2	1637.38
K1812401R	REPAIRED CON CELL 2	891.67
K18188001	COVER BLOODPUMP	74.94
K18191001	NON RETURN VALVE	282.86
K18195001	CONDUCTIVITY CELL	1338.44
K18196001	TUBE HOLDER AK 200	5.69
K18205001	CABLING PT8H AK 95	98.57
K18206001	CABLING PT AK 90	98.57
K18222002	RELAYBOARD AK95	440.83
K18253001	TOP IT AK200	190.98

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K18264001	PT SENSOR BOARD AK 80/AK 95	57.93
K18310001	BLOODLEAK DETECTOR FM AK200	410.72
K18381001	SENSOR PIN	40.97
K18384001	SILICON COVER	35.05
K18401001	CABLING AK-200 -PC(Ø POL DSUB)	204.67
K18430001	CABLING AK-200 EXTERNAL ALARM	165.63
K18440001	CONCENTRATE CON KIT AK90	413.90
K18457001	REPAIRED DISTR BOARD AK 200	595.81
K18498A-	FAN COMPL. AK100	163.57
K18470A-	MOTOR WITH DRIVING GEAR	373.75
K18471A-	MOTOR AK-100	166.46
K18472A-	REAR COVER AK95	288.32
K18493A-	BCH CLIP KIT	904.28
K18608001	AK 90 MOTOR	14.37
K18668001	PRESSURE TRANSDUCER	369.98
K18670001	SET KNOB AK200	1201.15
K18760001	LUER CONE	13.09
K1880802R	REP.CPU BOARD CPL BM AK 200	5.91
K1880701R	AK-200 FM CPU REP.	1637.38
K1880702R	REP.CPU BOARD CPL FM AK-200	1437.50
K1889100E	FILTER AC/DC AK-200	1437.50
K18913001	PLASTIC CYLINDER TW3	2.05
K19012001	ADAPTOR FOR PRESTAN	16.37
K19013001	WASHER	48.07
K19049001	MAGNET	9.39
K19101001	BOTTLE OGM SWEDEN	21.22
K19140001	BICART HOLDER KIT AK60	287.80
K19140002	BICART HOLDER KIT AK100/AK10	636.81
K19145001	FLUIDPUMP AK100/AK200	350.37
K19157001	AK95 PUMP HEAD+DRIVING MAGNET	407.88
K19282001	PRESSURE TRANSDUCER KIT	468.21
K19312002	LCD DRIVER BRD AK200	1196.76
K19359001	DISPLAY KIT	1533.63
K19409001	FLOW GUARD	45.04
K1943601R	REPAIRED OPERATORS PANEL AK 200	1471.74
K19693A-	BLOOD PUMP 200	78.50
K19693B-	BLOOD PUMP COVER AK200 (BLUE)	78.50
K19788001	ADAPTION KIT AK-95	1185.59
K19835001	FLOW SENSOR AK95	171.13
K19844001	PROTECTIVE COVER	52.90
K19880005	SPIKEHOUSE UPPER 200	157.44
K19880007	SPIKEHOUSE CPL (PEEK/LOWER) AK 200	119.52
K19880008	AK95 SPIKEHOUSE UPP	140.39
K19981001	Magnet	11.32
K19980001	BICART HOLDER	737.82
K19980003	BICART HOLDER AK-95	737.82
K20042002	STIRER	584.31
K20442001	HOLDER	55.88
K2053502R	REPAIRED CPU COMPL SELECT	1739.20
K20855001	FLUID PUMP AK100/AK200	488.75
K20700001	MAINT.KIT AK 200 1500 HOURS	115.00
K20700002	MAINT.KIT AK 200 2500 HOURS	426.12
K20750003	MAINT.KIT AK 30 5000 HOURS(LED)	739.28
K20800001	MAINT.KIT AK 95 2500 HOURS	145.27
K20800002	MAINT.KIT AK 95 5000 HOURS	734.91
K21455B-	VALVE MEMBRANE	22.61
K21095002	PUMPHEAD KIT FOR AK 100/200	1128.53



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K21095003	PUMPHEAD KIT AK 90/95	1104.02
K21131001	SERVICE KIT RUBBER STRIP	3.38
K21145001	AK-200 DRAINAGE KIT	13.14
K21168001	CABLE AIR DETECTOR AK 95	31.21
K21393001	Bicart arm assembly (AK200)	15.75
K21394001	Spike House Holder	12.60
K21400001	PRESSURE TRANSDUCER	1090.00
K21486001	Spacer	18.00
K21554001	BICART ARM ASSY upper steel AK200	282.66
K21554003	BICART ARM ASSY lower peek AK95/200	139.64
K21554006	BICART ARM ASSY	157.44
K21554007	BICART ARM ASSY	79.72
K21854008	BICART ARM ASSY	139.40
K21557004	Bicart Arm Complete	159.00
K21733001	SEAL KIT AC/DC AK 200	446.43
K30000004	MAINT.KIT AK 100 5000 HOURS (LED)	85.37
K30000006	MAINT. KIT AK 100 10,000 HOURS (LED)	157.33
L05172001	CONNECTOR	11.00
L07419001	SIK TUBING 4.75X1.6	21.22
L50668004	CAP CONG INTAKE	1.20
L50824001	FILTER	1.12
M90308461	XX OPTICAL SWITCH	95.22
N01870001	LUNDIA MULTI HOLDER	441.70
N01870003	MULTI HOLDER GREY	120.47
P03014101	PAL CIRCUIT	35.85
P03014102	PAL CIRCUIT AK-100	35.73
P03015102	POWERPAL AK-90	83.81
P03015105	POWERPAL	84.46
P03018102	PAL CIRCUIT	32.88
P03021102	PAL CIRCUIT 3.81 AK100	41.44
P03021104	PAL CIRCUIT	39.15
P03023103	PAL AK90	21.99
P03122103	PAL CIRCUIT AK95	32.88
P03124108	PAL CIRCUIT IC 48	170.04
P03128104	PAL CIRCUIT	35.59
P03144101	PAL CIRCUIT	20.91
P03183102	PAL CIRCUIT IC 48	141.70
P03217101	PAL CIRCUIT IC 3	31.49
P03217102	PAL CHIP AK95	38.24
P05033103	WATCH DOG AK100	103.28
Z530A24DC	THINIO Z530A-24DC	18.20




45

46

GAMBRO AK - 95 S

Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα

- Γρήγορες διαδικασίες προετοιμασίας
 - ☐ Λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών
 - ☐ Αυτόματο γέμισμα γραμμών φίλτρου αίματος με ορό
 - ☐ Προρυθμιζόμενες παράμετροι καθαράσης
- ☐ Απλότητα αιματοκάθαρσης
- ☐ Επίβλεψη με μία ματιά
- ☐ Πρόσβαση σ' όλες τις παραμέτρους οποιαδήποτε στιγμή
- ☐ Έξυπνη διαχείριση συναντηρών
 - ☐ Σχεδιασμένο για κάθαρση με BiCart®
 - ☐ Αυτόματη μεταγωγή από ξηρά κάθαρση σε κανονική
 - ☐ Έλεγχος υπερδιήθησης
 - ☐ Μονή βελόνα/μονή αντλία με πολύ μικρή επανακυκλοφορία αίματος
- ☐ Αποστειρώσεις όπως ο χειριστής επιθυμεί
- ☐ Αυτόματες αποστειρώσεις
- ☐ Προκαθορισμένοι τύποι αποστειρωτικών
- ☐ Αποστείρωση με Clean Cart® (προαιρετικά)
- ☐ Θερμική αποστείρωση με προαιρετική χρήση Clean Cart®
- ☐ Μηνήμη χημική αποστείρωσης
- ☐ Αυτόματα αδειασμα της μηχανής στο τέλος κάθε αποστείρωσης
- ☐ Απλότητα επισκευών
- ☐ Ελάχιστες ρυθμίσεις και ανήγνευση βλαβών
- ☐ Σύνδεση RS - 232



gambro®

47

GAMBRO AK - 95 S

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το AK-95 S της Gambro είναι η νέα πρόταση για αιματοκάθαρση κατ' οίκον αλλά και στο Νοσοκομείο. Είναι τόσο αυτόματο και εύκολο στην λειτουργία του που είναι δυνατόν να το χειριστεί ο ίδιος ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά πληρεί τις αυστηρότερες απαιτήσεις για ακρίβεια, αξιοπιστία, υγιεινή και ασφάλεια στην αιματοκάθαρση. Μία και είναι τόσο εύκολο να λειτουργήσει στο σπίτι είναι και εύκολο να εργαστεί στο Νοσοκομείο επίσης. Όλες οι σημαντικές λειτουργίες χειρισμού γίνονται αυτόματα. Το συμπαγές της κατασκευής του (34 cm φάρδος, 60 Kg βάρος) το κάνουν εύκολο στην μετακίνησή του από κρεβάτι ή και ακόμη σε άλλη αίθουσα.

Το AK-95 S αποδίδει τα μέγιστα αν και είναι μια μικρή σε μέγεθος συσκευή. Τα ενσωματωμένα κυκλώματα ευρύας του AK-95 S το καθιστούν ικανό να εκτελεί οποιοδήποτε είδος αιματοκάθαρσης. Η χωρίς συμβιβασμούς ακρίβεια των κυκλωμάτων παρασκευής υγρών και υπερδιήθησης (UF) είναι χαρακτηριστικό της όπως όλων των μηχανημάτων της Gambro. Ομοίως το προσεκτικά σχεδιασμένο υδραυλικό τους κύκλωμα, η λειτουργία με BiCart® και η μοναδική αποστείρωση με Clean Cart® βεβαιώνουν για τα υψηλότερα διατηρούμενα standards υγιεινής.

Η απλότητα του AK-95 S ισχύει για όλα τα σημεία. Εύκολο να λειτουργήσει, εύκολο να συντηρηθεί. Η μακροζωία του χωρίς προβλήματα σημαίνει οικονομία για τον ασθενή κύκλο ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που το καθιστά οικονομικό.

Το AK-95 S σκέπτεται. Γι' αυτό είναι τόσο εύκολο στη χρήση του. Απλώς ρυθμίζονται τα επιθυμητά απόβλητα βάρους και την ταχύτητα της αντίστροφης αιμάτας και αφήστε το μηχανήμα να κάνει τα υπόλοιπα.

Το AK-95 S θυμάται. Όλες οι παράμετροι αιματοκάθαρσης της συγκεκριμένης Μ.Τ.Ν είναι αποθηκευμένες στην μνήμη και ενεργοποιούνται με την εκκίνηση της μηχανής.

Το AK-95 S γλυτώνει χρόνο. Σε κάθε έναρξη λειτουργίας της (άντα) η μηχανή κάνει αυτοδιάγνωση όλων της των λειτουργιών. Όταν της δοθεί εντολή για λήξη της λειτουργίας της (σβήσιμο), πρώτα εκτελεί τον καθορισμένο κύκλο αποστείρωσης και κατόπιν τίθεται εκτός λειτουργίας (σβήνει) αυτόματα. Όλο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θερμικών - χημικών αποστειρώσεων και πλυσμάτων είναι δυνατόν να προκαθοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χειριστών της.

Το AK-95 S είναι γρήγορο. Η λειτουργία γεμίματος γραμμών αίματος-φίλτρου με ορό είναι δυνατόν να εκτελεστεί αυτόματα. Κατά την διάρκεια αυτής της λειτουργίας όλοι οι συναγερμοί απονεργοποιούνται ώστε να μην ενοχλούν.



gambro®

48

GAMBRO AK - 95 S

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για μηχανήματα βασισμένα στην τεχνολογική γνώση και εμπειρία της Εταιρείας, το οποίο είναι ακόμα πιο απλό από τα προηγούμενα, πιο μικρά και εύκολα στη χρήση, να θυσιάζει τίποτα από την ασφάλεια του αρρώστου και τις διευκολύνσεις για τον ασθενή χειριστή.

Το AK-95 S είναι μηχανήματα υπεράυχου - υπεραυτόματα και το μικρότερο (σε μέγεθος) στον κόσμο. Με έτος έναρξης παραγωγής λοιπόν το 2002, είναι το μοναδικό νόμιμο ότι είναι μελετημένο για την επόμενη δεκαετία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του βασίζεται σε αυτή της σειράς AK-200. Δηλαδή να μπορεί ο χειριστής να το χειρίζεται εύκολα και με μια απλή κίνηση, με μια δεξιά στο ΠΑΝΕΑ να έχει πλήρη εικόνα του μηχανήματος. Ο έλεγχος γίνεται από το πάλιν με την απλή μέθοδο των οκτώ εντολών. Με αυτόν τον τρόπο εκτός από την άμεση αντίληψη που έχει ο χειριστής, μπορεί να έχει και άμεσο έλεγχο της περιστασιακής παραμέτρους με μια κίνηση. Για τον παραπάνω λόγο, το AK-95 S διαφέρει σε εσωτερικές μνήμες, ακόμη και όταν είναι εκτός λειτουργίας (αφού) μεταξύ των χρήσεων, όλες τις σημαντικές παραμέτρους της μνήμης. Αυτό διευκολύνει στην διατήρηση των σημαντικών αυτών παραμέτρων της μνήμης του και την εισαγωγή τους εκεί μία μόνο φορά. Το ως άνω πάνελ είναι τύπου πλήκτρων επαφής (touch button) αδιάβροχο και ανθεκτικό στην χρήση.

Όλες οι σπουδαίες παράμετροι εμφανίζονται συνεχώς στις οθόνες υγρών στοιχείων τύπου στήλης (LCD-bargraphs). Όλες οι επιθυμητές τιμές έχουν πράσινο χρώμα, οι πραγματικές κίτρινο και τα όρια (μεγίστου-ελαχίστου) συναγερμών κόκκινο. Για αυτό και ο χειριστής έχει οπτική αντίληψη για αυτές, ακόμα και από απόσταση.

Η συνεχής ένδειξη του κυκλώματος ροής διαλύματος-αιματος, με αντίστοιχους χρωματισμούς στο σχετικό διάγραμμα στο ΠΑΝΕΑ δείχνει την κατάσταση τους ανά πάσα στιγμή π.χ. by-pass του διαλύματος, αν οι τιμές τους δεν είναι σωστές.

Εργάζεται και πραγματοποιεί καθαρή συμβατική - ξηρή ή και παραλλαγές αυτής (π.χ. High-Flux, single pump-Haemodiafiltration).

gambro®



43

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το AK-95 S - λόγω της πληθώρας των αυτοματισμών - διευκολύνει τον παρέχει - είναι σε θέση να εκτελεί κάθε τύπου αιμοκάθαρση με οξικά ή διπλανθρικά διαλύματα, ξηρή αιμοκάθαρση (χωρίς διάλυμα) και κάθε παραλλαγή τους. Εργάζεται με κάθε τύπου και είδους φίλτρα οιοδήποτε κατασκευαστή με συντελεστή υπερδιήθησης (UF coef) έως 80 ml/h, min/hg. Αυτό το καθιστά ικανό να εργάζεται με φίλτρα High-Flux, Haemodiafilters ακόμη και Haemofilters.

Επίσης, εκτελεί κάθε είδους και τύπου αποστείρωση με οποιοδήποτε αποστειρωτικό μέσο αφού το αραιώσει στην επιθυμητή αναλογία με αποκλειστικά για κάθε είδος αποστειρωτικό αυτόματα προγράμματα αποστείρωσης.

Χρησιμοποιεί ένα από τρία συμπυκνώματα (επιλογή του χειριστή) για να παρασκευάσει διάλυμα αντίστοιχα είτε οξικά είτε διπλανθρικά (συνολικά έξι τύπους συμπυκνωμάτων). Είναι, δίνει την ευελιξία στο νοσοκομείο και στην χειριστή να αλλάξει τύπο συμπυκνώματος χωρίς επέμβαση τεχνικού στο μηχάνημα ανά πάσα στιγμή (δεν δεσμεύεται από έναν προμηθευτή συμπυκνωμάτων).

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Μνήμη έναρξης

Το AK-95 S μπορεί να προγραμματιστεί με τις συγκεκριμένες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για την καθαρή και κάθε φορά που ξεκινά μία διαδικασία απαιτούνται ελάχιστα χειρίσματα.

Αυτόματος έλεγχος

Πριν από κάθε χρήση η συσκευή κάνει έλεγχο λειτουργικότητας και ασφαλείας. Όλα της τα εξαρτήματα και υδραυλικά κυκλώματα. Είναι δεν υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί βλάβη κατά την καθαρή.

Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο

Προγραμματίζοντας την ώρα και την ημέρα (υπάρχει ενσωματωμένο ρολόι) το AK-95 S, μπορεί, να προγραμματιστεί να εκτελεί ένα πλήρη κύκλο θερμικής αποστείρωσης ή πλύσιματος χωρίς την παρουσία του χειριστή. Μπορεί επίσης, αφού τελειώσει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα και να σβήσει αυτόματα.

Αυτόματο κλείσιμο

Μετά από κάθε λειτουργία αποστείρωσης το AK-95 S είναι δυνατόν, εάν ο χειριστής το επιθυμεί, να κλείσει μόνο του αυτόματα.

Αυτόματη αραιώση διάφορων αποστειρωτικών

Τα διάφορα χημικά αποστειρωτικά που χρησιμοποιούνται στο AK-95 S, αραιώνονται αυτόματα στις επιθυμητές συγκεντρώσεις. Πάντοτε υπάρχει ενεργή μνήμη και μνήμη προηγούμενης αποστείρωσης. Για αυτό και δεν πρέπει να διακόπτονται οι κύκλοι αποστείρωσης πριν το τέλος τους. Το AK-95 S μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν αποστειρωτικό μέσο οποιαδήποτε χημική ουσία κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση και σε οποιαδήποτε συγκέντρωση. Η επιθυμητή αραιώση προπρογραμματίζεται.

gambro®



50

Μνήμη συνεδρίας

Είναι ενεργή κατά την διάρκεια της συνεδρίας. Σε αυτήν αποθηκεύονται συνεχώς οι σημαντικές τιμές παραμέτρων όπως π.χ. ο ολικός όγκος επεξεργασμένου αίματος ή ο χρόνος ανανέωσης, που είναι ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο στην συνεδρία διακόπεται είτε η ροή αίματος είτε η ροή διαλύματος προς το φίλτρο.

Αυτόματος έλεγχος πίεσης

Τα όρια συναγερμών μεγίστου-ελαχίστου για τις τιμές της αρτηριακής, της φλεβικής και της TMP ρυθμίζονται αυτόματα στις προκαθορισμένες τιμές με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Το μηχανήμα είναι σε θέση να εργαστεί με σιδήριστες με σιδήριστες τύπου φίλτρου σιδηρήριστες κατασκευαστή.

Μονή βελόνα

Στη λειτουργία με μια βελόνα είναι δυνατόν να εργαστεί με μία αντλία αίματος και με οποιοδήποτε συνδυασμό τύπου πίεσης - χρόνου. Το μηχανήμα υπολογίζει και δίνει συνολικό όγκο επεξεργασμένου αίματος αυτόματα.

Αυτόματος και ακριβής έλεγχος υπερδιηθήματος

Ο προκαθορισμός από τον χειριστή του χρόνου καθαρισμού και της ποσότητας υπερδιηθήματος, πάντα τηρείται από το μηχανήμα και επαληθεύεται από το αποτέλεσμα.

Το AK-95 S αυτόματα υπολογίζει και αφαιρεί τους χρόνους καθαρισμού από το διαθέσιμο χρόνο για την επεξεργασία για διάφορους λόγους και ελαττώνει το αποτέλεσμα ρυθμίζοντας ανάλογα τον ρυθμό υπερδιήθησης.

Μνήμη αποστείρωσης

Το AK-95 S αποθηκεύει και "θυμίζει" τον χρόνο που πέρασε από την προηγούμενη αποστείρωση. Μπορεί λοιπόν να προγραμματιστεί μέγιστος χρόνος χρήσης μεταξύ δύο αποστειρώσεων και όταν αυτός συμπληρωθεί, η μηχανή να ζητήσει από τον χειριστή την σχετική λειτουργία.

Ψηφιακή οθονή επικοινωνίας

Σε αυτήν την οθονή αναγράφονται όλα τα μηνύματα επικοινωνίας (στα ελληνικά εάν επιλεγεί). Επίσης, σε αυτή δίνονται όλες οι λεπτομερείς πληροφορίες της συνεδρίας, π.χ. όπως οι πραγματικές ή επιθυμητές τιμές μιας παραμέτρου ή τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού για αυτή την παράμετρο.



Πλήκτρο συμβουλών

Όταν αυτό το πλήκτρο ανάβει, σημαίνει ότι το μηχανήμα έχει να μας δώσει μια συμβουλή, σχετική με τα όσα γίνονται. Πατώντας το, φαίνεται στην οθονή η αντίστοιχη συμβουλή (σε κείμενο).

Αυτοματισμός σταματημένης αντλίας αίματος

Όταν η αντλία αίματος είναι προσωρινά σταματημένη, ο χρόνος αυτός καταγράφεται από την μηχανή και εάν υπερβεί κάποιο μέγιστο (προκαθορισμένο) χρόνο θα δοθεί συναγερμός.

Όταν ξαναεναρμόσουμε την αντλία, τότε αυτή θα εργασθεί με την ίδια ταχύτητα που δούλευε και πριν.

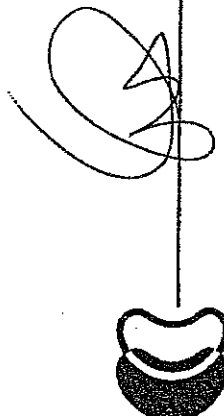

gambro®

15

Προσωρινή παύση υπερδιηθήματος

Εάν για κάποιο λόγο το επιθυμούμε, ο ρυθμός υπερδιήθησης μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο με το πάτημα του αντιστοίχου πλήκτρου, για έναν μέγιστο χρόνο μετά τον οποίο θα έχουμε συναγερμό.


Αυτόματος καθορισμός έναρξης - λήξης συνεδρίας

Το AK-95 S "βλέπει" αυτόματα την έναρξη της καθαρισμού (την στιγμή που πρωτακυκλοφορεί αίμα στις γραμμές) και ειδοποιεί αυτόματα για την λήξη της, κανονίζοντας να έχει όλα τα ζητούμενα αποτελέσματα μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Ο χρόνος διάρκειας της συνεδρίας καθορίζεται από τον χειριστή.

Αυτόματη διάγνωση βλαβών μέσω δικτύου DTE

Ενσωματωμένο στο software του μηχανήματος είναι και ένα πρόγραμμα ανίχνευσης- εντόπισης βλαβών και ελαττωματικών εξαρτημάτων μέσω επικοινωνίας από το τηλεφωνικό δίκτυο με οποιοδήποτε υπολογιστή τύπου PC-IBM compatible. Αυτό γίνεται και από το ίδιο το μηχανήμα (ενδείξεις στην ψηφιακή οθονή) είτε με PC επί τόπου.


Με το ίδιο πρόγραμμα, μπορούμε να πάρουμε και τα δεδομένα κάθε καθαρισμού για το τυχόν αρχείο ασθενών που χρησιμοποιούμε στον υπολογιστή μας και να ενημερώσουμε την καρτέλα του με το ιστορικό του.



gambro®

52

ΟΙ ΟΚΤΩ ΕΝΤΟΛΕΣ

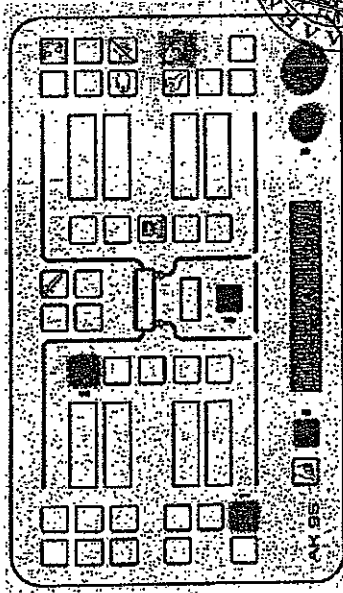

1. Όταν ανάβει ένα μπλε πλήκτρο, δείχνει ότι η αντίστοιχη λειτουργία εκτελείται.
2. Όταν ανάβει ένα κόκκινο πλήκτρο, υπάρχει αντίστοιχος συναγερμός.
3. Όταν ένα πλήκτρο αναβοσβήνει, ζητά να το πιέσουμε.
4. Η ψηφιακή οθόνη δείχνει πληροφορίες μόνο όταν το ζητήσουμε.
5. Για να πάρουμε μια πληροφορία μιας παραμέτρου, πιέζουμε το αντίστοιχο πλήκτρο.
6. Για να μεταβάλλουμε μια παράμετρο στην οθόνη, την επιλέγουμε πιέζοντας το πλήκτρο που έχει το βέλος. Η αντίστοιχη παράμετρος αναβοσβήνει.
7. Η παράμετρος που αναβοσβήνει μεταβάλλεται με το ρυθμιστικό SET.
8. Η ταχύτητα της ανάλυσης αιμάτος ρυθμίζεται ανά πάσα στιγμή από το ρυθμιστικό BLOOD FLOW.



gambro®

53

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΟΥ ΑΡΡΟΣΤΟΥ ΣΤΟ AK-95 S

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το AK-95 S σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα σημερινά standards για τα μηχανήματα αιματοκάθαρσης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όλες οι μεταβαλλόμενες παράμετροι (π.χ. αγωγιμότητα, θερμοκρασία, υπερδιήθημα) ελέγχονται από ένα σύστημα και παρακολουθούνται από ένα άλλο ξεχωριστό προστατευτικό σύστημα, με δικό του αισθητήριο, ηλεκτρικά κυκλώματα και μικροεπεξεργαστές. Η λειτουργικότητα των προστατευτικών συστημάτων ελέγχεται από το AK-95 S πριν από κάθε συνεδρία. Εάν στον αρχικό αυτό έλεγχο διαπιστωθεί πρόβλημα τότε το AK-95 S "μπλοκάρει" και δεν επιτρέπει την διεξαγωγή συνεδρίας.

Για να βεβαιωθεί ο χειριστής ότι τα αντίστοιχα κυκλώματα ελέγχου και προστασίας εργάζονται σωστά, με τις σωστές τιμές παραμέτρων, το μηχανήμα τον οδηγεί στο να συγκρίνει τις ενδείξεις των οργάνων και της ψηφιακής οθόνης. Τα όργανα δείχνουν την επιθυμητή, την πραγματική τιμή και τα όρια συναγερμού της παραμέτρου, ενώ η ψηφιακή οθόνη δείχνει όλες τις αντίστοιχες τιμές που "βλέπει" το προστατευτικό κύκλωμα.

Το σύστημα μέτρησης και ελέγχου της φλεβικής πίεσης είναι το κύκλωμα που προστατεύει από τυχόν απώλεια αίματος προς το περιβάλλον. Το σύστημα αυτό αυτοελέγχεται πριν από κάθε συνεδρία για πίεση 0 mmHg. Εάν ο έλεγχος είναι αρνητικός, τότε δεν είναι δυνατόν η μηχανή να ξεκινήσει για κάθαρση. Επιπλέον, ο χειριστής παίρνει οδηγίες για να ελέγξει το φίλτρο για τυχόν διαρροή αίματος, συγκεκριμένη πίεση. Αυτός ο έλεγχος είναι και λειτουργικό test για το περιβάλλον φλεβικής πίεσης.

Το σύστημα ανίχνευσης διαρροής αίματος στο διάλυμα το οποίο εγχέεται στο σπινικό αισθητήριο, ελέγχεται αυτόματα πριν από κάθε συνεδρία για το εάν υπάρχει θέση να διακρίνει μεταξύ διαφάνειας (όχι αίμα) και αδιαφάνειας (αίμα), στο ίδιο σημείο. Εάν το σύστημα δεν μπορεί να διακρίνει αυτές τις καταστάσεις, τότε το μηχανήμα τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόματα και δεν μπορεί να κάνει αιματοκάθαρση. Επιπλέον, το σύστημα διαρροής αίματος ελέγχεται κάθε 6 λεπτά κατά την διάρκεια της συνεδρίας για το εάν μπορεί να διακρίνει αδιαφάνεια. Εάν όχι, τότε η μηχανή θα θεωρηθεί ότι υπάρχει διαρροή αίματος και θα δώσει συναγερμό κάνοντας τις αντίστοιχες ενέργειες για την ασφάλεια του αρρώστου.

Ο αναγκαστής αέρος εργάζεται με υπέρηχα αισθητήρια στα οποία ένας μικροεπεξεργαστής ελέγχει τον πομπό και ένας ξεχωριστός μικροεπεξεργαστής το δέκτη. Το όλο σύστημα ελέγχεται συνεχώς για το εάν μπορεί να ανιχνεύσει αέρα και, σε περίπτωση αδυναμίας, δίνει συναγερμό και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια του αρρώστου.

Για τον ηλεκτρικό συναγερμό χρησιμοποιεί δύο βοηθητές που ελέγχονται ηλεκτρονικά με υπερευαίσθητο μικρόφωνο. Στην περίπτωση που ο ένας έχει βλάβη τότε αφ' ενός το μηχανήμα ενεργοποιεί αυτομάτως τον δεύτερο και αφ' ετέρου προειδοποιεί τον χρήστη.



gambro®

54

GAMBRO AK - 95 S

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έλεγχος ροής αίματος

Διπλή βελόνη

Ταχύτης

Ακρίβεια ροής

Ολικός όγκος αίματος

Ακρίβεια όγκου

0 & 15-500 ml/min (-150mmHg πίεση πριν από την ανάλυση με στοιχείο γραμμής 7,9 mm)
 ± 10 ml/min ή $\pm 10\%$ όποιο είναι υψηλότερο
 0-999 λίτρα
 $\pm 10\%$

Μονή βελόνη

Ταχύτης

Ακρίβεια ροής

Έλεγχος χρόνου

Έλεγχος πίεσης

Ολικός όγκος αίματος

Ακρίβεια όγκου

0 & 15-500 ml/min (-150mmHg πίεση πριν από την ανάλυση με στοιχείο γραμμής 7,9 mm)
 ± 10 ml/min ή $\pm 10\%$ όποιο είναι υψηλότερο
 2-20 sec αρτηριακός και φλεβικός
 10-500 mmHg (± 5 mmHg ή $\pm 3\%$ όποιο είναι υψηλότερο)
 με έλεγχο της φλεβικής πίεσης
 0-999 λίτρα
 $\pm 10\%$

Επιτοπεία πίεσης αίματος

Φλεβική πίεση

Περιοχή πίεσης

Όρια συναγερμού

Ακρίβεια


± 750 mmHg
 10-500 mmHg στην διάρκεια κάθαρσης
 (-100) -500 στο γέμισμα γραμμών (priming)
 ± 500 mmHg (± 5 mmHg ή $\pm 3\%$ όποιο είναι υψηλότερο)

Διαπιστική προστασία

-500 (-50) mmHg

Όρια συναγερμού

μηχανικά ρυθμιζόμενα



gambro®

55

Διαπιστική πίεση

Περιοχή πίεσης

Όρια συναγερμού

Ακρίβεια

± 750 mmHg
 (-400) - 400 mmHg
 ± 500 mmHg (± 5 mmHg ή $\pm 3\%$ όποιο είναι υψηλότερο)

Δυναμική αέρας

Μέθοδος ανήγχισης

Διάμετρος

Ευσταθισμός

Υπέρηχος αισθητήρας ενσωματωμένος στην βάση του φλεβικού θαλάμου (ποτηράκι) ανήγχισης. Η καλή λειτουργία του εμποδίζεται-επιβεβαιώνεται από μικροπυλολογιστές 22 mm
 Δίνεται συναγερμός για +0,5 ml αέρα το λεπτό με ροή αντλίας αίματος 300ml/min

Χορήγηση ηπαρίνης

Ροή

Ακρίβεια ροής

Μέγεθος σύριγγας

0 -10 ml/h
 $\pm 0,2$ ml/h ή $\pm 5\%$ όποιο είναι μεγαλύτερο. Η ακρίβεια βασίζεται σε μετρήσεις με σύριγγες 20 & 30 ml.
 Οι σύριγγες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ISO 7886. Το μηχανήμα από το εργοστάσιο είναι ρυθμισμένο για σύριγγα 20 ml, είναι όμως εύκολο να ξαναρυθμιστεί για όποια σύριγγα σιουδρήστε κατασκευαστή.
 Ο ηπαρίνισμός σταματά από 0,00 - 9,59 h
 Max 400 mmHg
 0-999 λίτρα

Τέλος έγχυσης

Μέγιστη πίεση

Όγκος ηπαρίνης

Παροχή νερού

Ροή

Κατά την συνεδρία 550 ml/min

Κατά την απαστρέφωση και πλήσιμο άδειασμα μια έπαυλη παροχή 550 ml/min απαιτείται


0,12 MPa (1,2 bar)

0,8 MPa (8 bar)

+5 - +30 °C

Διαμέτρου 8 mm

Το νερό θα πρέπει να πληρεί κάποιες διεθνείς προδιαγραφές όπως πχ. ANSI/AAMI. Για καλύτερα αποτελέσματα η μέγιστη αγωγιμότητα του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50μS/cm. Ιδανικό νερό είναι αυτό που παράγεται με την μέθοδο της αντιστροφής όσμωσης. Είναι δυνατόν να εργαστεί και με νερό πόλης με τις αντίστοιχες υποχωρήσεις σε ποιότητα αιμοκάθαρσης.



gambro®

56

Αποχέτευση
Μήκος αποχέτευσης
Περιοριστής εξόδου

Μέγιστο ύψος 1,2 m πάνω από τον σύνδεσμο του μηχανήματος χωρίς επαφή με την αποχέτευση για καλύτερη υγιεινή
< 5 m
Διάμετρος 1,3 mm

Παρασκευη διαλύματος

Ρυθμιστές πίεσης

1ος ρυθμιστής 80 kPa (0,8 bar)
2ος ρυθμιστής 120-125 mmHg

Θερμοκρασία

Ρυθμιζόμενη από 35 - 39 °C

Ορια συναγερμού

Ρυθμιζόμενα από 33 - 41 °C
στους 41 °C

Σταθερό όριο
συναγερμού
Ακρίβεια
Ισχύς θερμαντικών στοιχείων

±0,5 °C στην έξοδο προς το φίλτρο

1000 W (±10 % / -5 %) στα 100 V
1300 W (±10 % / -5 %) στα 110 V
1750 W (±10 % / -5 %) στα 230 V

Προστασία υπερθέρμανσης

στους 80 °C κατά την κάθαρση μέσω προγράμματος
στους 89 °C κατά τις αποστειρώσεις μέσω προγράμματος

Ροή

500 ml/min

Ακρίβεια ροής

±10%

Απασφάλιση

Με χρήση αερητικής πίεσης -810 mmHg. Ρυθμιζόμενη από -500 έως -700 mmHg

Περιοχή πίεσης διαλύματος
Ανάλυση συμπυκνωμάτων

(-400) - +300 mmHg
Το σύστημα είναι αεροστεγές από την αγωγιμότητα
Τα συμπυκνώματα αναρροφώνται με μαζικό αποστειρωμένο σκελετικό αντίλη. Τα υγρά αναρροφώνται χωρίς εξωτερική υποβοήθηση με μέγιστη πίεση 150 kPa
Na+ 130-180 mol/l (οξικά υπολογιζόμενα από το νάτριο)

Na+ 130-160 mol/l
HCO₃ - 20-40 mol/l (± mol/l)
12-16 mS/cm.

Διπλανθρακικά

Περιοχή μέτρησης
Ορια συναγερμού

±5% της υπολογιζόμενης επιθυμητής τήξης αγωγιμότητας

gambro®



57

ΡΗ-ΜΕΤΡΟ (ορίον)

Ακρίβεια
Ορια συναγερμού

1-9,9 pH μετρούμενο πριν από το φίλτρο
±2 Ph
5,0 - 9,0 pH

Ελεγχος υπερδότησης

Ελεγχος όγκων

Απ' ευθείας μέτρηση όγκου διαλύματος πριν και μετά το φίλτρο με ηλεκτρομαγνητικό τρόπο
Ρυθμιζόμενος 0 - 10,00 λίτρα

Όγκος υπερδότη-θήςματος

Ακρίβεια όγκου

±50 ml/h ή ±10% όποιο είναι μεγαλύτερο
Max 80 ml/h / mmHg

Συντελεστής φίλτρου

Ρυθμός υπερδότη-θής

0,0 - 4 l/h με δεδομένες τήρες όγκου υπερδότησης και διάρκειας συνεδρίας

Χρόνος συνεδρίας

Ελεγχος απομείνοντος χρόνου έως 5h 59 min

TMP

Ορια συναγερμού

Ακρίβεια

Ως TMP ορίζεται ως Pb-Pd όπου Pb είναι η φλεβοειδική και Pd πίεση διαλύματος πριν το φίλτρο
(-100) -500 mmHg
±500 (±10 mmHg ή ±5% όποιο είναι μεγαλύτερο)

Αυτοανθερμική διαφορά

Μέθοδος ανίχνευσης

Ευστάθεια

Υπερθερμική ανίχνευσης
+0,5 ml αλβιματος το λεπτό με ροή διαλύματος 500 ml/min ενεργοποιείται συναγερμός μετά από 5 sec

gambro®



58

Αποστείρωση και καθαρισμός

Χημική αποστείρωση

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες

Χλωρήνη κονή	Υποχλωριώδες 10%	Υπεροξικό οξύ 3,5-5%
Χρόνος 47 min	47 min	57 min
Θερμοκρασία + 60 °C κατά το ξέπλυμα 550 ml/min (μέγιστη)		

Θερμική αποστείρωση


Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες

Θερμική	Κιτρικό οξύ 20%	Clean Cart®
Χρόνος 100 V 110 V 230 V	55 min 45 min 41 min	72 min 61 min 57 min
Θερμοκρασία + 93 °C (μετρημένη στο θερμαντικό στοιχείο) ≥ + 80 °C (μετρημένη στην αποχέτευση) Οι θερμοκρασίες επαληθεύονται για κανονική τάση δικτύου και θερμοκρασία περιβάλλοντος + 20 °C		
Ροή 550 ml/min (μέγιστη)		

Ξέπλυμα/Αδειασμα/Αποσβεστική

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες

Θερμική	Κιτρικό οξύ 20%	Clean Cart®
Χρόνος Θερμοκρασία Ροή	10 min + 60 °C κατά το πλύσιμο με Clean Cart® 550 ml/min (μέγιστη)	52 min 47 min
Καθαρισμός αισθητήρα υπερδότησης Εξωτερικός καθαρισμός	σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης Όλα τα εξωτερικά μέρη καθαρίζονται με αθανάλη 70% ή ισο-προπανάλη 60%. Ο διακος στο πάνω μέρος της μηχανής και οι αντλίες αίματος είναι δυνατόν να αποστειρωθούν με κλίβανο	



5P

Ηλεκτρική τροφοδοσία

Τάση δικτύου	100 V (50 ή 60 Hz), 110 V (50 ή 60 Hz), ή 230 V (50 ή 60 Hz), ~ AC ± 12%. Καθορίζεται πριν την εγκατάσταση
Κατανάλωση	2025 W στα 230 V 1575 W στα 110 V 1275 W στα 100 V
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	3 m
Εξωτερικές ασφαλείες	για 100/110 V 2X10 AT για τα θερμαντικά για 230 V 2X10 AT για τα θερμαντικά τύπου IEC 83 AS-15 για 100/110 V τύπου IEC 83 C4 με διπλή γείωση τύπου Σούκο για 230 V 150 mikroA (110 V), 205 mikroA (230 V)
Ρευματολήπτης	
Μέγιστη διαροή ρεύματος προς γη	11 mikroA (110 V), 20 mikroA (230 V)
Μέγιστη διαροή ρεύματος προς άρρωστο	
Σημείωση	Τα ρεύματα διαροής ισχύουν χωρίς συνδέσεις άλλων συσκευών πάνω στο AK- 95

Συνδέσεις άλλων συσκευών

Εξωτερικός σύνδεσμος	25 ακίδων τύπου D-sub με RS 232 ή βρόγχο ρεύματος Οπτικά απομονωμένοι σύμφωνα με πρότυπο IEC 601-1
Εξωτερικές συσκευές	Οι συσκευές που θα συνδεθούν στο AK-95S (100/110 V) πληρούν τα διεθνή στандαρς συμβατότητας με τα αυτολογιστές-Ακόμεη τα τατρικά συστήματα πρέπει να πληρούν IEC 601-1-1
Εξωτερικός συννεγερμός RS 232	Μάκ τάση 24V AC/DC Max-ρεύμα 100mA AC/DC Μέγιστη τάση εισόδου ±15 V DC Μέγιστο ρεύμα εξόδου ±5 mA DC Ρεύμα 20 mA DC Μέγιστο 50 mA DC
Βρόγχος ρεύματος	
Διαστάσεις και βάρος	

Πλάτος	Μηχανής 35cm, Βάσης 57,4cm
Βάθος	Μηχανής 42cm, Βάσης 62,6cm
Υψος	120cm
Βάρος	60 Kg

Αναρτήσεις φιαλών /ορών

Μέγιστο βάρος	2 Kg



5P

Ασφάλεια - Προδιαγραφές
Το μηχάνημα πληρεί τις προδιαγραφές :

- α) IEC 601-1 και προστατεύει από ηλεκτροπληξία σύμφωνα με την τάξη αξιολόγησης B
β) IEC 601-2-16 προδιαγραφές για συστήματα αιμοκάθαρσης
γ) IEC 601-1, για ηλεκτρικό θόρυβο
IEC 601-1-2, EN55011

Το μηχάνημα φέρει την σήμανση CE0086


Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία +10 - +35 °C
Σχετική υγρασία 30 - 85% RH
Ατμοσφαιρική πίεση 700 - 1060 hPa

Περιβάλλον αποθήκευσης-μεταφοράς

Θερμοκρασία -20 - +70 °C
Σχετική υγρασία 10 - 96% RH
Ατμοσφαιρική πίεση 500 - 1060 hPa

Εάν ο χρόνος αποθήκευσης ξεπερνά τις 15 εβδομάδες πρέπει να πληθούν τα μεγέθη για το περιβάλλον λειτουργίας. Μέγιστη θερμοκρασία κατά την μεταφορά αποθήκευση σε σχετική υγρασία 98% είναι +40 °C



Handwritten signature



gambro®

61

GAMBRO AK - 200S

Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα

- Άμεση προετοιμασία
☐ Λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών
☐ Προρυθμιζόμενες παράμετροι θεραπείας

Προσαρμογή στις ανάγκες αιμοκάθαρσης

- ☐ Προρυθμιζόμενη σύσταση διαλυμάτων σε οξικά / διπλανθρικά
☐ Ρυθμιζόμενη ροή διαλύματος
☐ Αυτόματη μεταβολή (profile) της συγκέντρωσης Na⁺ και K⁺
☐ Αυτόματη μεταβολή (profile) του ρυθμού Υπερδιήθησης
☐ Σχεδιασμένο για το σύστημα Bieart® και τις επόμενες γενιές συμπτυκτικωμάτων SelectCar®.
☐ Λειτουργία Μονής βελόνης με μία ή και δύο αντίκες αίματος με πολύ μικρή επανακυκλοφορία
☐ Ξηρά κάθαρση
☐ Αιμοδιαδιήθηση
☐ Ενσωματωμένος αισθητήρας όγκου αίματος (αιμοσφαίρινη) BVS
☐ Ενσωματωμένο αυτόματο πιεσόμετρο BPM
☐ Ενσωματωμένο όργανο μέτρησης και ένδειξης PH

- ☐ Μπαταρία εφεδρείας

Τέλεια υγιεινή - προσαρμοζόμενες απαιτήσεις

- ☐ Χημική και θερμική αποστείρωση
☐ Αυτόματη αποστείρωση, ομαδική αποστείρωση
☐ Καθαρισμός με Clean Car®, αποσβεστήση, αποστείρωση
☐ Προρυθμιζόμενες επιλογές αποστείρωσης
☐ Μνήμη χημικής αποστείρωσης
☐ Επιβεβαίωση σωστής εκτέλεσης αποστείρωσης


Handwritten signature



gambro®

62

ΟΙ ΟΚΤΩ ΕΝΤΟΛΕΣ



1. Όταν ανάβει ένα μπλε πλήκτρο, δείχνει ότι η λειτουργία εκτελείται.
2. Όταν ανάβει ένα κόκκινο πλήκτρο, υπάρχει ανώμαλος συναγερμός.
3. Όταν ένα πλήκτρο αναβοσβήνει, ζητά να το πιέσουμε.
4. Η ψηφιακή οθόνη δείχνει πληροφορίες μόνο όταν το ζητήσουμε.
5. Για να πάρουμε μια πληροφορία μιας παραμέτρου, πιέζουμε το αντίστοιχο πλήκτρο.
6. Για να μεταβάλλουμε μια παράμετρο στην οθόνη, την επιλέγουμε πιέζοντας το πλήκτρο που έχει το βέλος. Η αντίστοιχη παράμετρος αναβοσβήνει.
7. Η παράμετρος που αναβοσβήνει μεταβάλλεται με 10 ρυθμιστικό SET.
8. Η ταχύτητα της ανάλυσης αίματος ρυθμίζεται ανά πάσα στιγμή από το ρυθμιστικό BLOOD FLOW.



gambro®

63

GAMBRO AK-200S

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Η δημιουργία διαδόχου, για το Gambro AK-200, ήταν μία πραγματική πρόκληση για τους σχεδιαστές της Gambro. Η αποστολή τους ήταν ο σχεδιασμός διαδόχου γενιάς σε μία γενιά μηχανημάτων που ξεχώρισαν για την λειτουργικότητα και την αξιοπιστία τους. Η ακρίβεια στους ελέγχους και η τεχνολογία μετρήσεων ήδη υπήρχε. Ο τρόπος αποτίεας της καθαριότητας ήταν ήδη ευρέως γνωστός και αποδεκτός. Βελτιώσεις-Πρόβλεψη που η σχεδιαστική φιλοσοφία παραμένει η ίδια, το Gambro AK-200S είναι ευδιάκριτα ένα νέο μηχανήμα αιμοκάθαρσης.

Οι αλλαγές στη σχεδίαση και στον τρόπο επικοινωνίας με τον χειριστή προέκυψαν από την απόδοση, την ταχύτητα και την ευκολία όλων των λειτουργιών. Τα νέα χειριστήρια διαθέτουν νέα, μεγαλύτερη έγχρωμη οθόνη (TFT) για την απεικόνιση των παραμέτρων καθαριότητας, ταυτόχρονα σε γραφική και ψηφιακή μορφή. Τα νέα χειριστήρια διαθέτουν επίσης, νέο τρόπο ελέγχου ροής του διαλύματος. Το ύψος γωνία θέασης του πάνελ του μηχανήματος είναι ρυθμιζόμενο για να αερίσει η εργονομικότητα. Η σχεδίαση του εμπρόσθιου μέρους είναι τέτοια ώστε να καθαρίζεται ευκολότερα.

Εμπειρία. Σαν φυσικός διάδοχος του AK-200, το Gambro AK-200 S, ενσωματώνει τεχνολογίες, αποδεδειγμένα αξιόπιστες, μετά από 10 εκατομμύρια καθάρσεις. Η συμβατότητα υλικών και κατασκευής με τα προηγούμενα μοντέλα, σιδηρεί απλούστευση στην εξυπηρέτηση βλαβών και συντήρησης. Όταν αφορά τον χειριστή, η εμπιστοσύνη του προς το μηχανήμα έχει ήδη κερδίσει. Αυτό σημαίνει αξιοπιστία.

Για τον ασθενή, ο απλός χειρισμός του μηχανήματος AK-200 S, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν υπάρχουν άσκοποι συναγερμοί που να προκαλούν σύγχυση καθώς επίσης και ο έλεγχος του μηχανήματος είναι σε πολύ χαμηλή στάθμη. Το πάνελ χειρισμού προσφέρει μια πλήρη εικόνα των παραμέτρων καθαριότητας. Η ύπαρξη της εφεδρικής μπαταρίας, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, σημαίνει περισσότερη ασφάλεια.

Προσαρμογή στις ανάγκες αιμοκάθαρσης. Ο σχεδιασμός του AK-200 S βασίζεται στις απαιτήσεις της κλινικής. Εκτελεί όλες τις παραλλαγές της αιμοκάθαρσης καθώς και αιμοδιαδιήθηση. Η λειτουργία μονής βελόνης γίνεται με μία ή δύο αντλίες. Το μηχανήμα προσαρμόζεται πλήρως σε εξατομικευμένη θεραπεία, διαθέτοντας συστήματα αυτόματης μεταβολής των συγκεντρώσεων στο διάλυμα καθαριότητας και του ρυθμού υπερδιήθησης. Επίσης διαθέτει έλεγχο υπερδιήθησης και εύκολη παρακολούθηση των παραμέτρων καθαριότητας. Νέα χαρακτηριστικά όπως ο έλεγχος ροής του διαλύματος καθαριότητας (300-700 ml/min), εντοπίζονται στο πάνελ χειρισμού.



gambro®

64

Απλός χειρισμός. Ο έξυπνος σχεδιασμός του πάνελ χειρισμού του μηχανήματος προσδίδει άμεση επίβλεψη ακόμα και από μακρινή απόσταση.

Η ευκολία στον χειρισμό οφείλεται επίσης και στην βελτιωμένη σχεδίαση των καινούργιων βάσεων για τα φίλτρα των διαλυμάτων κάθαρσης, στο BiCart[®], στο Clean Cart[®] καθώς και όλες τις επόμενες γενεές συμπυκνωμάτων της Gambro, όπως το SelectCart[®]. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, το μηχανήμα καταλαμβάνει μικρότερο χώρο.

Η πλήθώρα των αυτοματισμών που διαθέτει μειώνει το χρόνο προετοιμασίας. Η λειτουργία αυτοδιαγνώσης βλαβών δεν απαιτεί επίβλεψη από τον χειριστή. Οι μεταβλητές και οι σταθερές παράμετροι της κάθαρσης είναι προρυθμιζόμενες, όπως επίσης και τα διαφορετικά προγράμματα αποστείρωσης.

Οι λειτουργίες αποστείρωσης και πλύσιματος μπορούν να ρυθμιστούν να ξεκινήσουν αυτόματα, αρκετό χρόνο πριν την έναρξη της κάθαρσης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και ημέρα.

Παρακολούθηση κάθαρσης. Η επιτήρηση είναι εύκολη, ακόμα και από μακρινή απόσταση. Το πάνελ χειρισμού προσδίδει στον χειριστή την δυνατότητα πρόσβασης και ελέγχου όλων των παραμέτρων οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι τιμές καταγράφονται τα όρια συναγερμών απεικονίζονται γραφικά, ψηφιακά και ελαστικά. Η κατάσταση εύκολα την ανάγνωση τους. Η ροή αίματος και διαλύματος απεικονίζεται συνεχώς, καθώς επίσης και ο εναπομένον χρόνος κάθαρσης.

Όταν απαιτούνται λεπτομερείς πληροφορίες, όλες οι τιμές εμφανίζονται σε ψηφιακή μορφή. Στην οθόνη απεικονίζονται έγχρωμα γραφήματα με καμπύλες για τον έλεγχο της αυτόματης μεταβολής της συγκέντρωσης του νατρίου και των διαπυρρακικών στο διάλυμα κάθαρσης καθώς και της υπερδιήθησης.

Εμπρόσθετα, καμπύλες και διαγράμματα απεικονίζονται όταν ζητηθούν, ενώ όλες οι σημαντικές τιμές αποθηκεύονται στην μνήμη του μηχανήματος.

Ακρίβεια. Η σχεδιαστική φιλοσοφία του μηχανήματος έχει στόχο την ακρίβεια των λειτουργιών του. Το διάλυμα που παρασκευάζεται ελέγχεται ως προς την αγωγιμότητα και ρυθμίζεται κατ' αναλογία από δύο ξεχωριστές αντλίες με υψηλή ογκομετρική ακρίβεια.

Η απαέρωση του διαλύματος παίζει βασικό ρόλο στην ακρίβεια. Για την απαέρωση του διαλύματος κάθαρσης χρησιμοποιείται αρνητική πίεση. Ο αέρας στη γραμμή διέλευσης διαλύματος αντράγεται (με υπέρηχους) και αποβάλλεται σε δύο ξεχωριστούς θαλάμους φυσιοαπογίνων.

Η ροή του διαλύματος κάθαρσης μετρείται και παρακολουθείται πριν και μετά την διέλευση του από το φίλτρο, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια τον έλεγχο του όγκου. Η μέτρηση των ροών γίνεται με ηλεκτρομαγνητικό τρόπο 400 φορές το δευτερόλεπτο, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα για τον έλεγχο της υπερδιήθησης και της ροής. Ένα σύστημα που αποτελείται από τρεις διαφορετικές αντλίες, διασφαλίζει μία σταθερή ροή υγρών μέσα από το φίλτρο καθόλη τη διάρκεια της κάθαρσης, διευκολύνοντας σε εξαιρετικό βαθμό τον έλεγχο της διάχυσης και υπερδιήθησης.

gambro[®]



65

διόφορος λόγω σταματά η κάθαρση. Αυτός 6μη ενεργός χρόνος και ο συνολικός όγκος αίματος κάθαρσης υπολογίζονται και εμφανίζονται στην οθόνη.

Το AK-200 S διαθέτει έναν αισθητήρα όγκου αίματος (blood volume sensor), διασφαλίζοντας με απλό τρόπο την αποφυγή υπότασης και τον ακριβή υπολογισμό του ξηρού βάρους.

Ο σχεδιασμός του μπροστινού τμήματος του μηχανήματος είναι έξυπνος και διασφαλίζει εύκολα, την εξωτερική του καθαριότητα.

Βελτιωμένος ποιοτικός έλεγχος. Το πλήκτρο "Clinic Automation", στο πάνελ χειρισμού, χρησιμοποιείται για επικοινωνία με εξωτερικό συμβατό υπολογιστή. Όταν το μηχανήμα συνδέει με τα συστήματα Gambro MedGSS[®] και MedRec[®], το πάτημα του πλήκτρου παρουσιάζει όλες τις παραμέτρους κάθαρσης του ασθενούς στην οθόνη.

Μετά την ολοκλήρωση της κάθαρσης, οι παράμετροι συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ιατρικούς φακέλους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τοποικό έλεγχο. Το σύστημα ελαχιστοποιεί την γραφική εργασία και προσφέρει κατάλληλη πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα της κάθαρσης.

Το φιλικό στον χρήστη πρόγραμμα, βασισμένο στα Windows, κάνει οποιαδήποτε ζητούμενη πληροφορία εύκολα προσβάσιμη.

Απλότητα επισκευών. Οι περισσότερες επισκευές δεν απαιτούν το "άνοιγμα" του μηχανήματος: calibration, προρύθμιση, έλεγχος (-oi) λειτουργίας, κλπ. εν-χυσση μηχανικών βλαβών, εκτελούνται από το πάνελ ή μέσω HUY.

Το εσωτερικό του μηχανήματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει την εύκολη την πρόσβαση στα μέρη που το αποτελούν, οποιαδήποτε χρειαστεί. Καμία απόδειξη αποτελεί ο σχεδιασμός του μόνιμο διαλύματος.

Οικονομία. Το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλό. Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά πολύ μέσω ενάλλακτη θερμότητας. Η χρήση ψηφιακής οθόνης (TFT, VGA), αντί λυχνιών, μειώνει τα έξοδα συντήρησης. Τα εξαρτήματα του μηχανήματος, έχουν μεγάλο χρόνο ζωής, μειώνοντας τις επιδιορθώσεις και αυξάνοντας τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των συντηρήσεων. Η συμβατότητα υλικών με άλλα μοντέλα μηχανημάτων της Gambro, απλοποιεί την συντήρησή τους και κάνει ευκολότερη την πρόσβαση στη χρήση ανταλλακτικών.

Επειδή "ο χρόνος είναι χρήμα", ο άνετος και απλός χειρισμός του μηχανήματος AK-200 S: η προρύθμιση, οι αυτόματες λειτουργίες, η μείωση χρόνου έναρξης, οι ευρείες συναγερμοί, η αποτελεσματικότητα της εναλλακτικής αποστείρωσης με Clean Cart[®], σημαίνουν οικονομία σε όλα τα επίπεδα.

gambro[®]



66

Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο

Προγραμματίζοντας την ώρα και την ημέρα (υπάρχει ενσωματωμένο ρολόι) το AK-200 S, μπορεί να προγραμματιστεί να εκτελέσει ένα πλήρη κύκλο θερμικής αποστείρωσης ή πλύσιματος χωρίς την παρουσία του χειριστή. Μπορεί επίσης, αφού τελειώσει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα και να σβήσει αυτόματα.

Αυτόματα αραίωση διάφορων αποστειρωτικών

Τα διάφορα χημικά αποστειρωτικά που χρησιμοποιούνται στο AK-200 S, αραιώνονται αυτόματα στις επιθυμητές συγκεντρώσεις. Πάντοτε υπάρχει ενεργή μνήμη και μνήμη προηγούμενης αποστείρωσης. Για αυτό και δεν διακόπτονται οι κύκλοι αποστείρωσης πριν το τέλος τους. Το AK-200 S μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν αποστειρωτικό μέσο οποιαδήποτε χημική ουσία κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση και σε οποιαδήποτε συγκέντρωση. Η επιθυμητή αραίωση προπρογραμματίζεται.

Μνήμη συνεδρίας

Είναι ενεργή κατά την διάρκεια της συνεδρίας. Σε αυτήν αποθηκεύονται συνεχώς οι σημαντικές τιμές παραμέτρων, όπως π.χ. ο ολικός όγκος επεξεργασμένου υγρού ή ο χρόνος αναμονής, που είναι ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο στην συνεδρία διακόπτεται είτε η ροή αίματος είτε η ροή διαλύματος προς το φίλτρο.

Αυτόματος έλεγχος πίεσεων

Τα όρια συναγερμών μεγίστου-ελαχίστου για τις τιμές της αρτηριακής, της φλεβικής και της TMP, ρυθμίζονται αυτόματα στις προκαθορισμένες τιμές, με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Μονή βελόνα

Στη λειτουργία με μια βελόνα, είναι δυνατόν να εργαστεί με μία ή και δύο βελόνες αίματος και με οποιοδήποτε συνδυασμό τύπου πίεσης - χρόνου. Οι ταχύτητες των αντλιών μπορούν να ρυθμίζονται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα.

Αυτόματος και ακριβής έλεγχος υπερδιήθησης

Ο προκαθορισμός από τον χειριστή του χρόνου καθαρισμού και της ποσότητας υπερδιήθησης, πάντα πρέπει από το μηχανήμα και επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα. Το AK-200 S, αυτόματα υπολογίζει και αφαιρεί τους χρόνους καθαρισμού από τους οποίους διακόπτεται η υπερδιήθηση για διάφορους λόγους και ισοσταθμίζει το αποτέλεσμα ρυθμίζοντας ανάλογα τον ρυθμό υπερδιήθησης.

Μνήμη αποστείρωσης

Το AK-200 S αποθηκεύει και "θυμάται" τον χρόνο που πέρασε από την προηγούμενη αποστείρωση. Μπορεί λοιπόν να προγραμματισθεί μέγιστος χρόνος χρήσης μεταξύ δύο αποστειρώσεων και όταν αυτός συμπληρωθεί, η μηχανή να ζητήσει από τον χειριστή την σχετική λειτουργία.

Ψηφιακή οθόνη επικοινωνίας

Σε αυτήν την οθόνη αναγράφονται όλα τα μηνύματα επικοινωνίας. Η γλώσσα επικοινωνίας επιλέγεται από τον χειριστή. Μία από τις επιλογές είναι και η Ελληνική γλώσσα. Επίσης, σε αυτή δίνονται όλες οι λεπτομερείς πληροφορίες της συνεδρίας, π.χ. όπως οι παραγματοί ή επιθυμητές τιμές μιας παραμέτρου ή τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού για αυτή την παράμετρο. Είναι έγκυρη και εκτός των άλλων παρουσιάζει με πίνακες και γραφήματα κάθε μεταβολή (ζητούμενη ή εκτελεσθείσα) όλων των παραμέτρων.

GAMBRO AK - 200S

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έλεγχος ροής αίματος

Οι τιμές για τις αντλίες βασίζονται σε πίεση -150mmHg πριν την αρτηριακή αντλία αίματος με στοιχείο γραμμής 7,9 mm και σύρηνες 20ml ή 30ml

Διπλή βελόνα

Ροή αίματος στην αμφοδιάλυση
μονή αντλία
Ροή αίματος στην αμφοδιήθηση/αμφοδιήθηση
Ολικός όγκος αίματος

20-500 ml/min (± 10 ml/min ή $\pm 15\%$)
20-500 ml/min (± 10 ml/min ή $\pm 15\%$)
0-327 λίτρα ($\pm 15\%$)

Μονή βελόνα Μονή αντλία (αμφοδιάλυση, αμφοδιήθηση μόνος)

αρτηριακή ροή
έλεγχος χρόνου
έλεγχος πίεσης
Ολικός όγκος αίματος

20-500 ml/min (± 10 ml/min ή $\pm 18\%$)
2-20 sec. Αρτηριακής & φλεβικής πίεσης
10-800 mmHg με έλεγχο της φλεβικής πίεσης (± 50 mmHg ή $\pm 9\%$)
0-327 λίτρα ($\pm 18\%$)

Μονή βελόνα Διπλή αντλία (αμφοδιάλυση μόνος)

δπλή αντλία - A
δπλή αντλία - V
μέση ροή - SN/DP
Ολικός όγκος αίματος
Ογκος κύκλου SN/DP

20-800 ml/min (± 10 ml ή $\pm 10\%$)
20-800 ml/min (± 10 ml ή $\pm 15\%$)
10-400 ml/min (± 10 ml ή $\pm 15\%$)
0-99,9 λίτρα ($\pm 15\%$)
20-60ml/κύκλος ($\pm 15\%$)

Επιτοπίεση πίεσης αίματος

Φλεβική πίεση
Ορια συναγερμού ρυθμιζόμενα
Ακρίβεια

± 750 mmHg περιοχή λειτουργίας (-50)...+10...+600 mmHg
 ± 500 mmHg (± 5 mmHg ή $\pm 3\%$)

Αρτηριακή πίεση
Ορια συναγερμού ρυθμιζόμενα
Ακρίβεια

± 750 mmHg περιοχή λειτουργίας 250 - +250 mmHg
 ± 500 mmHg (± 5 mmHg ή $\pm 3\%$)

gambro®

gambro®

Πίεση συστήματος
Ορια συναγερμού SN/DP
ρυθμιζόμενα
Ορια συναγερμού DN ρυθμι-
ζόμενα
Ορια συναγερμού HDF με
ακόους ρυθμιζόμενα
Ακρίβεια

Ανίχνευση αέρος

Ανίχνευση αέρος

Ποτηράκι φλεβικής (διάμετρος)

Χορήγηση ηπαρίνης

Ηπαρίνιας

Τέλος έγχυσης

Μέγιστος σύρραγος ρυθμιζόμενο

Μέγιστη αντίθετη πίεση

Αισθητήρας Ογκού Αίματος

Ακρίβεια ΔΒV

Παρασκευή διαλύματος

Θερμοκρασία διαλύματος

Συναγερμός θερμοκρασίας

ρρυθμιζόμενα

Συναγερμός θερμοκρασίας

σταθερός

Ροή διαλύματος

Na+

Ορια συναγερμού στα οξικά

Na+

διπλανθρακικά

HCO₃-

Ορια συναγερμού στα

διπλανθρακικά

Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας

συμπληρωμάτων

Επιτοίχεια pH διαλύματος

Πίεση απελευθέρωσης ρυθμιζόμενη

$\pm 750 \text{ mmHg}$ περιοχή λειτουργίας
 $+10 - +175 (-200 - +300) \text{ mmHg}$
 $+300 (0 - +800) \text{ mmHg}$
 $-100 - +300 (0 - +800) \text{ mmHg}$
 $\pm 500 \text{ mmHg} (\pm 5 \text{ mmHg} \text{ ή } \pm 3\%)$

$\geq 0,5 \text{ ml}$ έγχυση αέρα στο αισθητήρα με ροή
αίματος 300 ml/min θα προκαλέσει συναγερμό.
22 mm

Η ακρίβεια βασίζεται σε τεστ με σύρραγες των
20 & 30 ml.
 $0/0,5 - 10 \text{ ml/h} (\pm 1 \text{ ml/5h} \text{ ή } \pm 5\%)$
0-4 h

6 - 30 ml
 $+ 400 \text{ mmHg}$

$\pm 3\%$
Ειδικός αισθητήρας για ροή αίματος $\geq 180 \text{ ml/min}$
και $Hp \geq 80 \text{ g/h}$

$30 - 39^\circ \text{C} (+0,5/- 1,5^\circ \text{C})$

$28 - 40^\circ \text{C}$

28 και 40°C

$300 - 700 \text{ ml/min} (\pm 10 \text{ ml/min})$

$115 - 160 \text{ mmol/l} (\pm 4 \text{ mmol})$

$\pm 5\%$ της επιθυμητής τιμής

$130 - 150 \text{ mmol/l} (\pm 6 \text{ mmol})$

$20 - 40 \text{ mmol/l} (\pm 6 \text{ mmol})$

$\pm 5\%$ της επιθυμητής τιμής

$+150 \text{ KPa}$

$1 - 9,9$ μονάδες pH ($\pm 0,2$)

$-630 \text{ mmHg} (-500 - -700 \text{ mmHg})$

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Μέγιστο ύψος
Μήκος σωλήνα
Ικανότητα ροής

Ηλεκτρική τροφοδοσία

Τάση δικτύου

Συχνότητα

Κατανάλωση

Καλώδιο

τροφοδοσίας

Συνδεση

Ρευματολήπιτης

Ρεύμα διαροής προς

γη

Ρεύμα διαροής προς

άρρωστο

Σημείωση Τα ρεύματα διαροής που αναφέρονται ισχύουν χωρίς συνδέσεις αν-
συσκευών πάνω στο μηχάνημα
2 X T 10 A

Συνδέσεις εξωτερικών συσκευών

Εξωτερική σειριακή θύρα

Βύσμα σύνδεσης RS 8 ακίδων, REDEL μαύρο, RS 232 ή RS 422 σύμβατη
σύνδεση. Οπτικά απομονωμένος σύμφωνο με την
προδιαγραφή IEC 601-1

Εξωτερικές συσκευές

Καλώδια σύνδεσης 2,5 m
Οι εξωτερικές συσκευές που θα συνδεθούν στο AK-200 S
πρέπει να τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές (π.χ. IEC 950
για συσκευές επεξεργασίας δεδομένων). Οι καρτικές
συσκευές πρέπει επιπλέον να τηρούν τις IEC 601-1. Ενα
σπουδαίο θέμα που πρέπει να προσεχθεί είναι το ρεύμα
διαροής του συνθέτου συστήματος να μην ξεπερνάει τα
επιτρεπτά όρια.

RS 232

Μέγιστη τάση εισόδου $\pm 15 \text{ V}$ DC

Μέγιστη τάση σήματος $+ 5 \text{ V}$ DC

Ελάχιστη τάση σήματος $- 5 \text{ V}$ DC

Μέγιστο ρεύμα εξόδου $\pm 5 \text{ mA}$ DC



gambro®

70

CP

RS 422

Μέγιστη τάση εισόδου ± 7 V DC
Κατώφλι διαφορικής τάσης εισόδου ± 0,2 V DC
Μέγιστη διαφορική τάση εξόδου 5 V DC
Ελάχιστη διαφορική τάση εξόδου 2 V DC
Ρεύμα εξόδου σε βραχυκύκλωση 100 mA DC

Εξωτερική καλωδίωση

Βύσμα σύνδεσης P79 8 ακίδων, REDEL κέρνιο, δύο διακόπτες και μια μεταγωγική επαφή μέσα relay ή δύο μεταγωγικές επαφές Καλώδιο σύνδεσης 2,9 m

Εξωτερικές συσκευές Οι εξωτερικές συσκευές που θα συνδεθούν στο AK-200 S πρέπει να τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές (πχ. IEC 950 για συσκευές επεξεργασίας δεδομένων). Οι ιατρικές συσκευές πρέπει επιπλέον να τηρούν τις IEC 601-1. Ένα σπουδαίο θέμα που πρέπει να προσεχθεί είναι το ρεύμα διαρροής του συνδέτου συστήματος να μην ξεπερνάει τα επιτρεπτά όρια.

Ικανότητα επαφών Μένιστη τάση 24 V AC ή DC
Μέγιστο ρεύμα 100 mA AC ή DC

Εξωτερική σύνδεση I/O

Βύσμα σύνδεσης P76 8 ακίδων, REDEL μπλέ, οπτικά απομονωμένα με την προδιαγραφή IEC 601-1 Καλώδιο σύνδεσης 1,5 m

Εξωτερικές συσκευές Σύνδεση με την μονάδα ρύθμισης (calibration) UF της Gambio. Μόνο για χρήση από το *service*.

Εξωτερική σειριακή σύνδεση

Βύσμα σύνδεσης P64 8 ακίδων, REDEL γκρι Καλώδιο σύνδεσης 2,0 m

Εξωτερικές συσκευές Σειριακή θύρα σύνδεσης του συστήματος CCM-100 της Gambio. Μόνο για χρήση από το *service*.

Επεξεργασία μπαταρίας

Τροφοδοσία 24 volt, 5/10 Ah
Διάρκεια 15 min
Ασφάλεια T 15 A

gambio®



71

Διαστάσεις και βάρος

Βάθος 610 mm
Πλάτος 570 mm
Ολικό ύψος Ρυθμιζόμενο ύψος 1080, 1190 ή 1300 mm
Ρυθμιζόμενο από 1175-1340 mm
573 x 753 mm

Επιφάνεια Βάρος μονάδας αίματος 16 -18 Kg
Βάρος μονάδας υγρών 40 Kg
Βάρος βάσης 24 -31 Kg
Σταύτη μηχανής Υψος 1300 -2150 mm
Μέγιστο βάρος 10 Kg
Μεταφέρεται από ένα άτομο και χωρά σε κανονικό αυτοκίνητο τύπου station-wagon

Μεταφορά

Περιβάλλον λειτουργίας

Σε λειτουργία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +18... +35 °C
Σχετική υγρασία 15 - 85% RH
Ατμοσφαιρική πίεση 700 - 1060 hPa

Μεταφορά - Αποθήκευση

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 ... +70 °C
Σχετική υγρασία 10 - 95% RH
Ατμοσφαιρική πίεση 500 - 1060 hPa

Εάν ο χρόνος μεταφοράς - αποθήκευσης ξεπερνά τις 15 εβδομάδες πρέπει να τηρηθούν τα μέγιστα για το περιβάλλον λειτουργίας. Μέγιστη θερμοκρασία κατά την μεταφορά - αποθήκευση σε σχετική υγρασία 98% είναι +40 °C

Ασφάλεια

Το μηχάνημα πληρεί τις εξής προδιαγραφές :

- α) IEC 601-1 Γενικές προδιαγραφές ασφαλείας
- β) IEC 601-2-16 Ειδικές προδιαγραφές για αιμοκάθαρση
- γ) IEC 601-1-1 Ασφάλειας για συστήματα
- δ) IEC 601-1-2 Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
- ε) EN55011 Εκπομπής για συσκευές ISM και προστασία από ηλεκτροπληξία σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 601-1 τάξη Ι τύπος Β

Το μηχάνημα φέρει την σήμανση CE0086

gambio®



72



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΠΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
ΚΑΝΙΤΙΟΣ 20 Τ.Κ. 101 81
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ. : 01033 05 029
ΑΡΙΘΜ. FAX : 01038 02 044

ΑΘΗΝΑ 10-5-2002
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3124
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την Δ/ση 247/2001

ΘΕΜΑ: Καθόρισμός ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού
Δ/σης 247/2001

Ανακοινούμε ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός της Δ/σης 247/2001, με κλήση
καταχώρισης την συμμερότερη προσφορά, περιλήψας είδους ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΝΕΦΡΟΙ, για
τις ανάγκες του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Διάφορα Νοσοκομεία),

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ


08-07-02

Σύμφωνα με την αριθ. 2642/9-5-2002 απόφαση μας για την 08-07-02
Ημέρα Δ/σης 247/2001 ώρα 10.30 π.μ. (Κανόνες 20, Γραφείο 1) στο Ιατρείο του
Υπουργείου Ανάπτυξης με τις παρακάτω τροποποιήσεις των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών της Δ/σης :

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α αντικαθίσταται με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
ανακοίνωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 αντικαθίσταται με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
ανακοίνωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1.
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Παράρτημα 17

"Να παρασκευάζει διάλυμα διττανθρακικών και από πυκνό διάλυμα και από
διττανθρακικό νάτριο σε στερεά μορφή (σκόνη), των περισσότερων μέχρι σήμερα
γνωστών τύπων και εργοστασίων, ή τριών τουλάχιστον γνωστών τύπων και
εργοστασίων" (Να δηλώνουν ονομαστικός).


Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 247/2001 Διακήρυξη.
Λοχική στην Ε.Ε. 08.11.01
Παρούσα >> >> 114-05-02



Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Γ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

73

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΝ 05-05-02



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΤΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ	21 / 04 / 50 / 00 / 0 /
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Α) 7 Στοιχεία Συμβαρτικής Αμοιβή 8000 Β) 86 Στοιχεία Παραλ. των Συμβαρτικής Αμοιβή 8000
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Διάφορα Νοσοκομεία) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Α) 1.382.946, 00 ΕΥΡΩ Από τον τακτικό προϋπολογισμό κάθε Νοσοκομείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1) Β) 234.776, 00 ΕΥΡΩ - Ν.Γ.Ν.ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ "ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" από Π.Δ.Ε. (Γ.Κ.Π.Σ.) Γ) 70.433, 00 ΕΥΡΩ - Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ από Π.Δ.Ε. (ΠΕΠ Ησίδου) Δ) 29.347, 00 ΕΥΡΩ - Ν.Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ από Π.Δ.Ε. (Σ.Α.Ε 09/1/ Αριθ. Εργασ. 9991310)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. εξοφλούμενο του μισός Αυγούστου.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Αποθήκες των Νοσοκομείων
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του είδους
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	Α) 1024% Ν.Γ.Ν.ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ "ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ και Ν.Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β) 73216%. Από τα Νοσοκομεία Παραρτήματος Α1
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24	Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος.



74

75

[Handwritten signature]

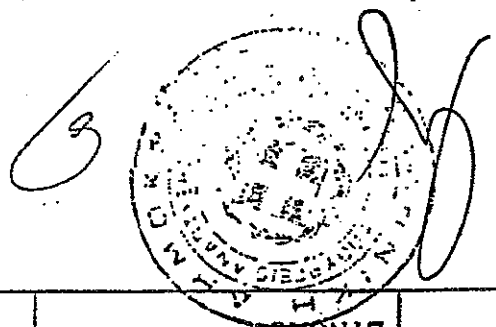

A/A	ՆՕՏՕՔՕՄԵԼԻ	ԿԱԹԻՕՐԻԱ ԸՄԵԲԱՏԻՔԻ ԱՅՄՕԿԱԹԱՐԵԻ	ԿԱԹԻՕՐԻԱ ՊԱՐԱՆԱԴՐՆ ԸՄԵԲԱՅՄ/ԷԻ	ԸՆՈՎՈ	ԸՆՈՎ	ԸՆՈՎ
1	ՈՒՆ.ԱՏԻՔԻ	-	5	5	51,944,24	
2	ՈՒՆ.ՓԷՆԻՔԻ	-	8	8	234,776,00	
3	ՈՒՆ.ԸՆՈՐՈՐ	-	8	8	190,755,69	
4	ՈՒՆ.ԸՆՈՐՈՐ	-	5	5	70,432,87	
5	ՈՒՆ.ԸՆՈՐՈՐ	-	6	6	105,649,3	
6	ՈՒՆ.ԱՅԿԱԿ	-	7	7	102,714,6	
7	ՈՒՆ.ԱՆԿԱՅ	3	4	7	123,257,52	
8	ՈՒՆ.ԱՄԻԱ	-	7	7	113,279,53	
9	ՈՒՆ.ԿՅԱՊԻՔԻ	-	3	3	46,955,25	
10	ՈՒՆ.ՊԵՐԵԶ	-	-	-	70,432,87	
11	ՈՒՆ.ՏՐԻԿԱՆ	-	-	-	29,347,03	
12	ՈՒՆ.ԻՄՓՐ	-	-	-	70,432,87	
13	ՈՒՆ.ԿԱՆԱԿԱՏ	4	-	-	88,041,09	
	ՈՒՆ.ԱՐՓՐ	-	3	3	44,020,54	
	ՈՒՆ.ԲԱՅԵՐՆԱ	-	10	10	146,735,14	
	ՈՒՆ.ԶԵՐՐՈՆ	-	2	2	33,273,66	
	ՈՒՆ.ՔՅՄՈՐ	-	8	8	117,390,00	
	ԸՆՈՎ	7	86	93	1639438,20	

ՊԱՐԱՐԻՄԱ ԱԻ

Ανήκει στη Δίξη 247/2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

ΑΘΗΝΑ 7-11-2001
Αριθ. Δίξης 247/2001
Αριθ. Πρωτ : 7890

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Κάνιγγος 20

Ταχ. Κώδικας : 10181

Πληροφορίες : Ιωάννα Παπαθανασίου

Τηλέφωνο : 33 05 029

FAX : 38 02 044

ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(Διάφορα Νοσοκομεία)

ΕΙΔΟΣ :

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Ημερομηνία αποστολής Για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.	Ημερομηνία Δημοσίευσης Στον Ημερ. Τύπο
ΝΑΙ	ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	08-11-01	09-11-01
ΔΕΙΓΜΑ	ΟΧΙ	08-11-01	09-11-01

ΑΠΟΦΑΣΗ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

1.2. Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου πρὸς το Κοινοτικό Δίκαιο".

1.3. Του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (Κ.Π.Δ.).

1.4. Του Π.Δ. 397/98 (Φ.Ε.Κ 185/Α/98) Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου

1.5. Του Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ 102 /Α/95) Οργανισμός Γεν. Δίνας Κρατικών

Προμηθειών.

2. Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ191/2-96). Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,

Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

3. Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/96) "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της."

4. Την Κοινή Απόφαση 303/5-5-2000 (ΦΕΚ 594/Β/5-5-2000) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης."

5. Την υπ' αριθμ. Β3/135/26-7-2000 (ΦΕΚ 977/Β/9-8-2000) απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης "Περί Εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού."

6. Το άρθρο 24 του Ν.2188/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.3.1994) σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος" στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις."

7. Το άρθρο 84 του Ν. 2362/95 " Περὶ Προκαταβολών Δημοσίου"

8. Το Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-97) περὶ Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/685 Ε.Ο.Κ.

9. Την κοινή απόφαση Π1/1346/9-4-2001 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Ανάπτυξης περὶ "έγκρισης ενάγειας προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2001."

10. Την κοινή απόφαση Π1/1937/2001 των Υφυπουργών Ανάπτυξης περὶ "Εφαρμογής Ε.Π.Π. 2001".

11. Τον Ν. 2842/00 περὶ " λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ", καθώς και τις ΚΥΑ αριθ. Ζ-288 και Ζ1-412 περὶ εφαρμογής του.

12. Τα ΔΥΔΑ/ΟΙΚ.Γ.Π.6926/24-9-2001 και ΔΥΔΑ/Γ.Π./ΟΙΚ. 23516/31-10-2001 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και απαιτούν αναπόσπαστο μέρος της Δίξης αυτής.


Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από "κανονική προθεσμία Πενήντα Δύο (52) ημερών απο την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο και στο τεύχος Δίξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της κυβέρνησης.

2

Αθήνα στη Δ/η 24.7./2001

2. ΤΟΤΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ -ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		
Υπουργείο Ανάπτυξης			
Κάννυος 20			
Γραφείο 1 Ισόγειο	14-01-02	Δευτέρα	ΜΕΧΡΙ 10.30 π.μ



Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιτρέπονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

3. Δικαιώματα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
- β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
- γ) συνεταιρισμοί.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

- 4.1. "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ " ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
- 4.2. "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
- 4.3. "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
- 4.4. "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
- 4.5. "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - Ε.1
- 4.6. "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΥΓΗΤ. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
- 4.7. "ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'
- 4.8. "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑ 310/96".

5. Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' απαιτείται κατάθεση δεσμεύσεων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του Κ.Π.Δ.

Αθήνα στη Δ/η/2001

6. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαπα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται α' αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη της αιτήσεως.


7. Εφόσον ζητηθούν έγκαπα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

8. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

9. Τα έξοδα δημοσιεύσεως, στο μεν Ελληνικό, τόσο βαρύνουν το Δημόσιο στη δε εξωτερική εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ε. ΠΕΤΕΜΗ

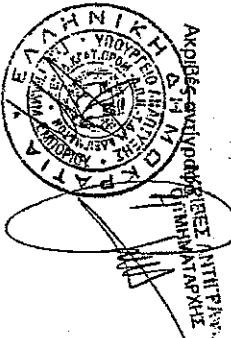

Ακριβές αντίγραφο της Δ/ξης ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Ανήκει στη Διακήρυξη... 24/12/2001.

Ανήκει στη Διακήρυξη 247/12001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ	21 / 04 / 50 / 00 / 0 /
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Α) - 8 Συσκευές Συμβετικής Αιμοκάθαρσης Β) 52 Συσκευές Παράλληλων Συμβετικής Αιμοκάθαρσης ΤΕΜΑΧΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Διάφορα Νοσοκομεία) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1)
ΠΡΟΤΥΠΣΑ ΔΑΔΑΝΗ ΠΡΟΤΥΠΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	1.022.157,01 ΕΥΡΩ Από τον τακτικό προϋπολογισμό κάθε Νοσοκομείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Αποθήκες των Νοσοκομείων
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του είδους.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	7,3216%.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ N.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24	Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος.

Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα, η βάση της μίμης του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% αυτής, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί και η προμήθεια θα επανταγορευματοποιηθεί.

78

5

Α/Α	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΛΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΒΑΛΙΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΠ.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
1	Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"	-	5	5	61.944 , 24
2	Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ "ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"	-	8	8	146.735 , 14
3	Π.Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	-	8	8	190.755 , 69
4	Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ"	-	5	5	70.432 , 87
5	Ν.Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ "ΠΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"	-	6	6	105.949 , 3
6	Ν.Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	-	7	7	102.714 , 6
7	Ν.Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	3	4	7	123.257 , 52
8	Ν.Γ.Ν. ΔΑΜΙΑΣ	5	2	7	113.279 , 63
9	Ν.Γ.Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ	-	3	3	46.955 , 25
10	Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	-	4	4	70.432 , 87
	ΣΥΝΟΛΟ	8	52	60	1.022.157,01

۶

Ανήκει στη Διακήρυξη... 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 1.1. Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελλο σφραγισμένο, δικτυλογραφημένες σε δύο αντίγραφα και στην Ελληνική γλώσσα,
 1.2. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσημεριούμενες από την επίσημη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναμετρούμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.3. Στο φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- 1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
 1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Μέσα στο φάκελλο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

- 1.4.1. Στον κυρίως φάκελλο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί πλαισίωσης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
 1.4.2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και της ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.

Ανήκει στη Διακήρυξη... 2001.

1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και της λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.

1.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυσθείσας ποσότητας ή για κάθε είδος χωριστά.

1.6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

1.7. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.

1.7.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελλοι καθώς και οι φάκελλοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο.

Οι φάκελλοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελλο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.7.2. Οι φάκελλοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.

1.7.3. Οι φάκελλοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κλήθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών

Ανήκει στη Δίεση...../2001.

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- 2.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που - λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνο με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
- Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

2.3 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητείται η Δίεση.

2.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 394/96).

Επιστημονίζεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συντημένο υποδείγμα.

Επίσης οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής θα ισχύουν έως την επιστροφή τους στην Τράπεζα.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αναγραφή της ανα μονάδα τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφ' όσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο

Ανήκει στη Δίεση...../2001.

στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.8 Η προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 και 18 του Π.Δ. 394/96 δικαιολογητικά.

1.8.1. Στοιχεία πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε των τεχνικών προδιαγραφών υποβάλλονται συνημμένα στην τεχνική προσφορά.

1.8.2. Επίσης στον φάκελλο της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και δύο(2) αντίγραφα της οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ.

1.9 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

1.10 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επιουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιαστική απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12 Επιστημονίζεται ότι:


1.12.1. Ανεπισημασμένες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.12.2. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικά όργανα, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Ανήκει στη Δ/ση.../2001

δεκαδικά ψηφία προς τα δύο εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

3.4 Προσφορά που θέτουν δύο ανταγωνισμούς της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.5 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

1. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

1.1. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τους % στο οποίο υπάγεται το είδος.

(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένως Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

3.6 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερους φορείς ή και περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά κατά φορέα.

3.7 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος αντιστα σύμφωνα με την παράγραφο 3.5.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του είδους και όχι στις τιμές των μερών.

3.8 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


4.1 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το αργότερο μέχρι του 1/4 αυτού με επιβάρυνση των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (Άρθρο 26 του Κ.Π.Δ.).

4.2 Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράδοσης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτων.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

- Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους,
1. Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασης με κάρτεση ισότιμης Εγγυητικής Επιστολής



Ανήκει στη Δ/ση.../2001

Προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 394/96).

1. Σε περίπτωση επιβολής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εσπραχέλης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψης μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του υλικού.

Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου προσυμφημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες δωδεκάμηνης διάρκειας (απόφ. 2037288/808/0026/30-5-96 Υπ. Οικονομικών).

11. Το υπόλοιπο 50% της αξίας με τον αναλογούντα στη συνολική συμβατική αξία Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή του είδους.

Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο έτος από τους δύο τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

Υ) Ως τρόπος τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 394/96).

δ) Σύμφωνα με την Π1/1347/16-3-01 εγκύκλιο Γεν. Γραμματέα Εμπορίου, οι πληρωμές μέχρι 31-12-2001, θα γίνονται μόνο σε δρχ. και από 1-1-2002 μέχρι 28-2-2002 σε δρχ. ή σε ΕΥΡΩ, ανάλογα με τις δυνατότητες.

Μετά τις 28-2-2002, μόνο σε ΕΥΡΩ.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με την ΚΥΑ Ζ1-412, τα τιμολόγια μέχρι 28/2/2002 θα εκδίδονται μόνο σε δροχμές ή σε δροχμές και ΕΥΡΩ. ε) Η "τιμή μεταπωλητής" είναι η συνολογιστική ισότητα δροχμής-ΕΥΡΩ και συγκεκριμένα 1ΕΥΡΩ=340,750 δρχ.

6. ΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενοστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 394/1996 ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/Β-9-97)

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7.1 Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.

Ανήκει στη Δ/ξη 247/2001

7.2 Η Υπηρεσία διατηρεί τοδικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%.

7.3 Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστό 30% όπως και αύξηση της προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 30%

7.4 Ο προμηθευτής στον οποίο ανακοινώνεται η κατακύρωση, κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένο το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ (που επισυνάπτεται στην παρούσα) με την υποχρέωση να τηρούν απόρρητα τα αναφερόμενα σε αυτό στοιχεία από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Συμμερφότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Λ = Συγκριτική τιμή : Σταθμισμένη βαθμολογία

1. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης – λειτουργίας και συντήρησης αν προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή.
2. Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.

Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόματα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των ομάδων.


Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς

Ανήκει στη Διακήρυξη.../2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τεχνικές που απαιτείται εγύνηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών, των χρόνος εγύνησης, καλής λειτουργίας ή συντήρησης ισχύει ο αναγραφόμενος στο παράρτημα Ε των τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα, για τον οποίο έγινε η προμήθεια, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.

2. Το Διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα έντονης στον προαρκτω διαγωνισμό και άλλων Νοσοκομείων, πέραν των όσων αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', είτε κατά το στάδιο της κατακύρωσης, είτε κατά τη διαδικασία των συμβάσεων, κατόπιν αιτήματος των Νοσοκομείων στην Υπηρεσία μας και με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠ.



Τα προσυμφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να τηρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Δ/ξης αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ανήκει στη Διακήρυξη.../2001.

13- 4/4/91 ΣΥΗ 247/01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

1. Η Συσκευή να είναι πλήρης, καινούρια, αμεταξέρσιμη και σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τεχνικά κ.λ.π. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να τεκμηριώνονται απαραίτητα με αντιστοιχία prospectus του κατασκευαστή, εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση.
2. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220V/50Hz.
3. Η λειτουργία της να βασίζεται σε μικροεπεξεργαστές (microprocessors) και η συσκευή να αυτοελέγχεται πριν την έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης.
4. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς είτε από βλάβη είτε από εσφαλμένο χειρισμό.
5. Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή λαθών για τη γρήγορη επίσκεψη από τους τεχνικούς. Οι ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας της συσκευής μπορούν να παρέχονται είτε από ψηφιακά είτε από αναλογικά όργανα είτε από θόνη. Στην περίπτωση της θόνης οι αναγραφόμενες ενδείξεις είναι επιθυμητή να είναι στα Ελληνικά (Ο προμηθευτής να αναφέρει εάν όλες ή μέρος των παραμέτρων θα αναγράφονται στα Ελληνικά).
6. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση και να είναι εύκολη στη μεταφορά της με δυνατότητα ανηφόρησης των τροχών.
7. Να φέρει αναρτήρες φιαλών, φίτρων και γραμμών.
8. Να χρησιμοποιεί φίλτρα και γραμμές όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων.
9. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με μονή βελόνα.
10. Να έχει αντλία ακριβούς χορήγησης ηπαρίνης.
11. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων της αρτηριακής και φλεβικής πίεσης του αίματος.
12. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου της ροής του αίματος. Θα εκπληθεί η δυνατότητα μέτρησης του συνολικού όγκου αίματος που επεξεργάστηκε η συσκευή.
13. Να είναι, ως προς την παρασκευή του διαλύματος, αυτόματη και αυτόνομη.
14. Να είναι τύπου Single pass (απλή διέλευση) διαλύματος από το φίλτρο καθαρός.
15. Να παρασκευάζει διάλυμα οξείων και διττανθρακικών.
16. Να έχει σύστημα μεταβολής τόσο του Na⁺ όσο και των διττανθρακικών ριζών (HCO₃⁻) του τελικού διαλύματος, κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες εκάστου αρρώστου.
17. Να παρασκευάζει διάλυμα διττανθρακικών και από πυκνό διάλυμα και από άνωδρο διττανθρακικό νάτριο σε σκόνη, όλων των μέγεθων δυνατών τύπων.
18. Να έχει σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης.
19. Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος (ξηρά κάθαρση).
20. Να έχει ροόμετρο ροής του διαλύματος αιμοκάθαρσης.
21. Να έχει ενσωματωμένες: αυτόματες λειτουργίες θερμικής και χημικής αποστείρωσης και πλυσίματος με νερό.

21/4/91 21/4/91 17

-14-


4/4/91 ΣΥΗ 247/01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
(Hemodiafiltration)

Επι πλέον των αναφερομένων για τη συσκευή συμβατικής αιμοκάθαρσης:

- Να εκτελεί τη μέθοδο Hemodiafiltration.
- Να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με διαχρονικό προγραμματισμό (profiling) αγωγιμότητας (Na⁺) και υπερδιήθησης.
- Να χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα φίλτρα για παραλλαγές της συμβατικής αιμοκάθαρσης.

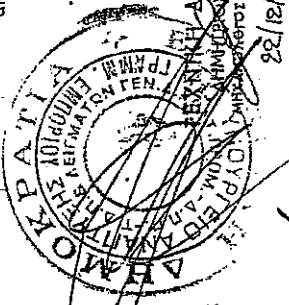

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
22/12/97

Ε.Δ. ΚΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
22/12/97

ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΝΙΚ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΑΔΗΣ
22/12/97

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
12-11-98

Ε.Δ. ΚΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
12/11/98

ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΝΙΚ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΑΔΗΣ
22/11/98

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
21/9/99

Ε.Δ. ΚΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
21/9/99

ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΝΙΚ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΑΔΗΣ
21/9/99

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
21/11/00

Ε.Δ. ΚΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
22/11/2000

ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΝΙΚ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΑΔΗΣ
22/11/2000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
9/8/01

Ε.Δ. ΚΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
10/8/01

ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΝΙΚ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΑΔΗΣ
10/8/01

-15-

Αριθμός 21/4/94 247/01

-16-

Αριθμός 21/4/94 247/01

Σχετικά με αίτηση ΟΕ

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες Τεχνολογίες Νεφρού θα είναι

ούμενες προς τις απαιτήσεις της ΔΥΤ/2480/94 (ΦΕΚ


679/Β'/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β'/7-10-94 και ΦΕΚ 757/Β'/10-10-

94) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) "περί ενδεδειγμένων της

Ελληνικής Νομοθεσίας, προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93"

και τον χρόνο παράδοσης των, και θα φέρουν οποιοδήποτε την

παρασημειώνεται από την ανωτέρω Κ.Υ.Α. σύμφωνα ΟΕ.

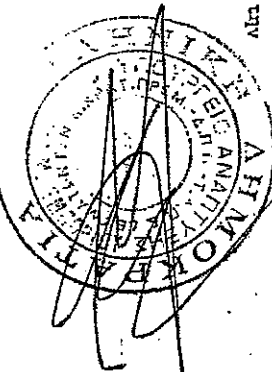

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

1. Οι προσφερόμενες είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά τους να καταθέσουν ειδικό έντυπο (prospectus), στο οποίο θα απεικονίζονται σε σχεδιάγραμμα ή σχέδιο τα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος για να πιστοποιείται η τωρινή του προσφερόμενου είδους.
2. Οι προσφερόμενες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου (το οποίο να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου).
3. Να προσφέρεται εργασία καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Η εργασία καλής λειτουργίας θα περιλαμβάνει δωρεάν service, ανταλλακτικά και αναλώσιμα - ανταλλακτικά του μηχανήματος. Να αναφέρεται ο χρόνος αναπόδοσης ανεξάρτητα εσόδων ή αργίων.
4. Οι προσφερόμενες να αναφέρουν τον τρόπο εκπαίδευσης του Ιατρικού - Νοσηλευτικού και Τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου στο Χειρισμό του μηχανήματος.
5. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση παράδοση, για μία δεκαετία. Σε περίπτωση εισαγωγής θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο σε 15 ημέρες.
6. Η παράδοση και οριστική παραλαβή των μηχανημάτων, σε πλήρη λειτουργία, θα γίνει στις Μ.Τ.Ν. του κάθε Νοσοκομείου. Τα μηχανήματα θα συνοδεύονται, κατά την παράδοση, από πιστοποιητικό (όχι φωτοτυπία), τεχνικό εγχειρίδιο (service manual), κατάσταση κυκλοφορούντων ανταλλακτικών (part list), εγχειρίδιο ρυθμίσεων (adjustment manual), οι οποίοι στην Ελληνική γλώσσα.
7. Να δοθεί το πλήρες κόστος συντήρησης (τακτική συντήρηση και επισκευή, βλαβών, service, ανταλλακτικά και αναλώσιμα ανταλλακτικά μηχανήματος), για τα επόμενα οκτώ (8) χρόνια, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η πρόταση πλήρους συντήρησης, θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, εφόσον το Νοσοκομείο την κρίνει συμφέρουσα και την επιλέξει.
8. Να κατατεθεί τιμοκατάλογος ανταλλακτικών, αναλωσίμων ανταλλακτικών μηχανήματος και λοιπών αναλωσίμων. Να αναγράφεται η συχνότητα αλλαγής των παραπάνω υλικών και να δίνεται πρόταση επίσημης αναπροσαρμογής του τιμοκαταλόγου.
9. Οι Προσφερόμενες θα πρέπει να δηλώνουν να συμπεριφέρονται με την Υ.Α. Ε3/833/99 όπως τροποποιήθηκε: (α) Περὶ συντήρησης διατεταγμένων νοσημάτων των εταιρειών διακινητών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

21/4/00

9/8/01

21/9/99

19

21/4/00

9/8/01

21/9/99

20

Ανήκει στη Δείη/2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...

Κατόστημα.....

Ημερομηνία Εκδόσης.....

ΕΥΡΩ.....

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ

ΔΙΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ.

ΚΑΝΙΤΟΣ 20

101 81 ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τήρη να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαρρέσεως και διενεργείας μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... υπέρ της Εταιρείας..... ΔΙΝΣΗ..... δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της..... για την προμήθεια..... Δείη σας..... σύμφωνα με την υπ' αριθμ..... Δείη σας..... Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή, εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της..... Το παρόντως ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντήρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμενα να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την..... Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑ.ΤΗΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσαφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δείη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α'	
1. Σύγχρονη Τεχνολογία Αυτοελεγχός - Μικροδουλολογιστές - Αυτοματισμός αυτοδιάγνωσης - ενδείξεις βλαβών για ασφάλεια & προστασία ασθενούς	35%
2. Εργονομία οργάνων ελέγχου - ενδείξεων διπτανθρακικών	15%
3. Ρύθμιση συγκέντρωσης Na ⁺ HCO ₃ ⁻ Παραγωγή HCO ₃ ⁻ από πυκνό διάλυμα και από άνυδρο διπτανθρακικό Na ⁺ σε σκόνη. Single pass	
4. Ελεγχόμενη υπερδιήθηση	5%
5. Πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς διαδο διαλύματος	
6. Ελεγχος αρτηριακής - φλεβικής πίεσης	10%
7. Ανάληψη ιπταρίνης	
8. Σύστημα μέτρησης ροής αίματος - Συνολικού όγκου αίματος	
9. Μονή βελόνη	5%
10. Θερμική και Χημική αποστείρωση	70%
11. ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ	
12. ΟΜΑΔΑ Β'	
13. Χρόνος παράδοσης	5%
14. Τεχνική υποστήριξη - Service (επάρκεια - αξιοπιστία)	10%
15. Εγγύηση	10%
16. Εκπαίδευση προσωπικού	5%
17. ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ	30%

Για τις συσκευές παραλλαγών της συμβατικής αιμοκάθαρσης προστίθενται:

στη παρ. 3 της Α' ομάδας: Hemodiafiltration και στη παρ. 4 της Α' ομάδας: Profiling Na⁺ και υπερδιήθησης

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

21/9/99

ΠΑΡ. ΣΑΛΙΑΡΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΝΙΚ. ΚΑΤΙΣΟΡΑΛΗ

22/12/97

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

21/9/99

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

22/12/97

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

21/9/99

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' 2.

Ανήκει στη Δ/νση 2001.

Περιεχόμενο δήλωσης ΝΑ 1599/86 από ΑΕ με μετοχές ανώνυμες

Ότι

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "....." και υπό την ιδιότητά μου αυτή ότι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των μετόχων.....

..... που αντιπροσωπεύουμε από κοινού ποσοστό..... του κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και στο πρόσωπο των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συντρέχει το συμβιβαστο της παρ. 11 του Ν. 2328/85 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2644/88.

Στην παρούσα επισυνάπτω

- α) Κωδικοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία
- β) ΦΕΚ ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου
- γ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκπροσώπησης της εταιρείας επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία

Αθήνα

Ο ΔΗΛΩΝ

Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος

Σημείωση

Σε περίπτωση που μετόχων των μετόχων περιλαμβάνεται ΑΕ απαιτείται ανάλογη δήλωση με δικαιολογητικά του νόμιμου εκπροσώπου αυτής κ.ο.κ. μέχρι φυσικού προσώπου.

Ανήκει στη Δ/νση 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' 1.

Περιεχόμενο δήλωσης ΝΑ 1599/86 από ΑΕ με μετοχές ονομαστικές

Ότι

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "....." και υπό την ιδιότητά μου αυτή ότι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των λοιπών μετόχων και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συντρέχει το συμβιβαστο της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2328/85 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2644/88.

Στην παρούσα επισυνάπτω

- α) Κωδικοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία
- β) Μετοχολόγιο
- γ) ΦΕΚ ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου
- δ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκπροσώπησης της εταιρείας επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία


Αθήνα

Ο ΔΗΛΩΝ

Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος

Σημείωση

Σε περίπτωση που μετόχων των μετόχων περιλαμβάνεται ΑΕ απαιτείται ανάλογη δήλωση με δικαιολογητικά του νόμιμου εκπροσώπου αυτής κ.ο.κ. μέχρι φυσικού προσώπου.



Ανήκει στη Δ/ση/2001.

ПАРАРТНМА Н. 3.

Περιεχόμενο δήλωσης ΝΔ 1599/86 από Ε.Π.Ε.

1990年12月

Είναι διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με

την επωνυμία ".....ΕΠΕ" και υπό την ιδιοτητα μου αυτή

ότι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των λοιπών εταίρων

δεν συντρέχει το συμβαστο της παρ. 11 του άρθρου 1 του

N. 2328/95 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2644/98.

Επισυνάπτονται

- α) Καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις νομίμως θεωρημένο
β) Κατάσταση εταιρικών
γ) ΦΕΚ διορισμού διαχειριστού

Βεβαιούται το

γνήσιο της υπογραφής.

25

Ανήκει στην Δ/ση 241/2001.

ПАРАРТНМА Н' 4.

Περιεχόμενο δήλωσης ΝΔ 1599/86 από Ο.Ε.

δηλώνω ότι

Είμαι Ομόρρυθμος εταίρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "..... ΟΕ" και υπό την ιδιότητά μου αυτή ότι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των λοιπών Ομόρρυθμων εταίρων δεν συντρέχει το συγγιζαστό της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2328/95 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2644/98.

Επιλαμβάνονται

- α) Καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις νομίμως θεωρημένο
β) Κατάσταση Ομόρρυθμων εταιριών
γ) Νομιμοποίηση διαρισμού εκπροσώπων

Βεβαιούται το

γνήσιο της υπογραφής.

22

Ανήκει στη Δ/ση: 257/2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'. 5.

Περιοχόμενο δήλωσης ΝΑ 1699/86 από Ε.Ε.

δηλώνω ότι .


Είμαι Ομόρρυθμος εταίρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ".....ΕΕ" και υπό την ιδιότητά μου αυτή ότι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των Ετερόρρυθμων εταίρων δεν συντρέχει το συμβεβαιο της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν.2328/85 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2644/88.

Επισημαίνονται

- α) Καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις νομίμως θεωρημένο
- β) Καρτόταξη Δοτών εταίρων
- γ) Νομιμοποίηση διορισμού εκπροσώπου.

20

Βεβαιούται το
γνήσιο της υπογραφής

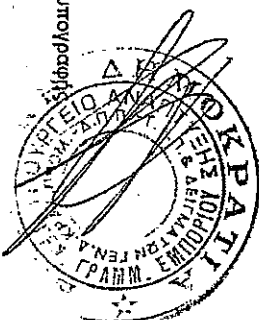

Ανήκει στη Δ/ση: 257/2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'. 6.

Περιοχόμενο δήλωσης Ν.1599/86 από ΑΕ εισηγμένη στο Χρηματιστήριο

Ότι

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία και υπό την ιδιότητά μου αυτή ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και τα διευθυντικά στελέχη αυτής δεν συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο ως μέτοχοι και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε επιχείρηση παρομοίων ή τήλεφασης ή έκδοσης εφημερίδας από τις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2328/85.

Στην παρούσα επισημαίνω


- α) Καδικτοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία
- β) Μετοχολόγιο
- γ) ΦΕΚ ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου
- δ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκπροσώπησης της εταιρείας, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία.

[Handwritten signature]

[Large handwritten X mark]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός απόφασης: 5667/2013

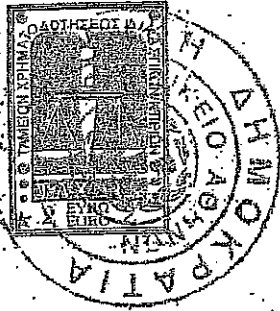

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ευαγγελία ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χριστίνα ΑΥΓΕΡΗ, Πρωτοδίκη, Ευαγγελία-Μαρία ΘΩΜΑ, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, τους οποίους όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη γραμματέα του Μαριάνθη ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24-4-2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α' ΑΓΩΓΗ: ΣΤ5-16 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 12358/463/2012)

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές -Αντιπροσωπείες-Service)» και το διακριτικό τίτλο «SERCO LTD», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της, Δημητρίου ΤΕΜΠΕΡΗ και Ιλβας ΜΙΣΙΟ.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: 1. Εταιρείας με την επωνυμία «GAMBRO LUNDIA AB», που εδρεύει στην πόλη Lund της Σουηδίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της, Παυλίνας ΓΑΛΑΤΗ και Αντωνίου ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, 2. Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ», και το διακριτικό τίτλο «MEDICAL PRODUCTS LTD», που εδρεύει στην Άνω



Γλυφάδα Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε μετά των νομίμων εκπροσώπων της Κων/νου ΒΛΑΧΟΥ και Αγγέλου ΒΛΑΧΟΥ, οι οποίοι διόρισαν τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, Κωνσταντίνο ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ και Δόμνα ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΥ.


Β' ΑΓΩΓΗ: ΣΤ5-18 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 198352/6208/2012)

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές -Αντιπροσωπείες-Service)» και το διακριτικό τίτλο «SERCO LTD», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της, Δημητρίου ΤΕΜΠΕΡΗ και Ιλβας ΜΙΣΙΟ.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Εταιρείας με την επωνυμία «GAMBRO LUNDIA AB», που εδρεύει στην πόλη Lund Σουηδίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως προς την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. 2. Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ», και το διακριτικό τίτλο «MEDICAL PRODUCTS LTD», που εδρεύει στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε μετά των νομίμων εκπροσώπων της Κων/νου ΒΛΑΧΟΥ και Αγγέλου ΒΛΑΧΟΥ, οι οποίοι διόρισαν τους πληρεξούσιους δικηγόρους Κωνσταντίνο ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ και Δόμνα ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνουν δεκτές οι από 19-1-2012 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 12358/463/2012) και 6-12-2012 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 198352/6208/2012) αγωγές αντίστοιχα, που κατατέθηκαν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης απόφασης και γράφηκαν στο πινάκιο με αριθμούς ΣΤ5-16 και ΣΤ5-18 αντίστοιχα.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.



στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των σχετικών παραγγελιών με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής 30.000 ευρώ. Το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει να γίνει δεκτό, διότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει οικονομική ζημία στην ενάγουσα (άρθρο 908 παρ. 1 εδ. στ' ΚΠολΔ). Τέλος τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, ύστερα από αίτημα, που υποβλήθηκε με τις προτάσεις της, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της δεύτερης εναγομένης, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ) όπως ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Θεωρήθηκε
Εισηγήτρια
ΑΕΔ

ΘΕΩΡΕΙ καταργημένη τη δίκη ως προς την πρώτη εναγομένη της δεύτερης από 6-12-2012 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 198352/6208/2012) αγωγής.

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αγωγές.

ΑΠΘΡΡΙΠΤΕΙ την πρώτη αγωγή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της ενάγουσας τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων, που ορίζει σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τη δεύτερη αγωγή ως προς τη δεύτερη εναγομένη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ-Επιστημονικά-Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές-αντιπροσωπείες-Service)» και το διακριτικό τίτλο «SERCO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και ανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ-Επιστημονικά-Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές-αντιπροσωπείες-Service)» και το

13^ο φύλλο της υπ' αριθμόν 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τακτική Διαδικασία)

διακριτικό τίτλο «SERCO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω διάταξη.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της δεύτερης εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, που ορίζει σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2-10-2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση στις 7-11-2013 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη
σήμανση και έκδοσή του κατά τη
σειρά της παραγγελίας

ΑΘΗΝΑ

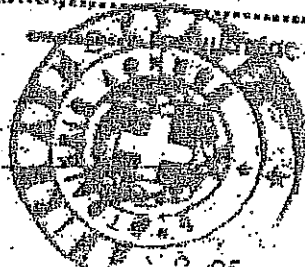

11 5 ΙΑΝ 2014

Ενημερωτικό δελτίο σέρβις

AK-95/AK-95S

Γενικές πληροφορίες 249

Ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου 2013

Σχετικά με: AK 95

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
C.O. ΚΑΙ Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
ΑΜ ΔΣΑ 80352
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395

Τέλος υποστήριξης για τα AK 95

Η περίοδος της υποστήριξης συντήρησης για τα AK 95 θα φθάσει σύντομα στο τέλος της. Η υποστήριξη για τεχνικές ερωτήσεις, ανταλλακτικά και επισκευή ανταλλακτικών θα συνεχιστεί έως την 31^η Δεκεμβρίου 2013. Οι παραγγελίες για μοναδικά ανταλλακτικά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα, κατά προτίμηση πριν την 1^η Απριλίου.

Έως την 31^η Δεκεμβρίου 2013, δεν θα εξεταστούν ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή οποιοδήποτε άλλου είδους βελτιώσεις, εκτός αν υπαγορεύονται για λόγους ασφαλείας.

Σημείωση! Δεν συνιστάται πλέον η χρήση των προϊόντων μετά την 31^η Δεκεμβρίου 2013 και τα παράπονα, που θα αφορούν αυτά τα προϊόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Με εκτίμηση,

Hakan Ohlsson

Karl Henrik Forsland

Αυφίβρις / μεταφράση ει του συντημένου στην Αγγλική πρωτοτύπου.

Αθήνα, 30/01/2014

Η Μεταφράστρια Διηγήσεις

ΙΛΒΑ Α. ΜΗΣΙΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
ΑΜ ΔΣΑ 80352
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395

Γ. ΚΑΡΔ
και Συνεργάτες ΔΙ
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ.
ΑΘΗΝΑ 997603842
ΤΗΛ.: 210 8211395

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 80352 - ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ 997603842 - ΔΟΥ: 1Α ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395

ΗΥΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΟ
 8035
 106 82 100 HNA
 ΔΟΥ: ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
 FAX: 210 8211395

Service Newsletter

AK 95 / AK 95 S

General Information 249

Date: 23 January 2013

Concerning: AK 95

C.o. no.

End of support for AK 95

The maintenance support period for AK 95 will soon come to its end. The support for technical inquiries, spare parts and spare parts repair will continue until 31st December 2013. Orders for unique spare parts should be placed as soon as possible, preferably before 1st April.

Up to 31st December 2013, no updates, modifications or any other type of improvements will be considered unless dictated by safety issues.

Note! After 31st December 2013, the use of the products is no longer advisable and complaints concerning these products will not be taken into consideration.

Best regards

Håkan Ohlsson

Karl Henrik Forslund

Ενημερωτικό δελτίο σέρβις

Γενικές πληροφορίες 403

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
ΑΜ ΔΙΑ 80352
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: 1Α ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395

Ημερομηνία: 21 Ιουνίου 2007 Σχετικά με: Όλα

C.o. no.

Περίοδος της υποστήριξης συντήρησης για τα AK 100

Η περίοδος της υποστήριξης συντήρησης για τα AK 100 και AK 100 ULTRA θα φθάσει σύντομα στο τέλος της. Η υποστήριξη για τεχνικές ερωτήσεις, ανταλλακτικά και επισκευή ανταλλακτικών θα συνεχιστεί έως την 31^η Δεκεμβρίου 2007. Οι παραγγελίες για ανταλλακτικά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

Έως την ημερομηνία που αναφέρεται ανωτέρω δεν θα εξεταστούν ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους βελτιώσεις, εκτός αν υπαγορεύονται για λόγους ασφαλείας.

Σημείωση! Δεν συνιστάται πλέον η χρήση των προϊόντων μετά την ημερομηνία που αναφέρεται ανωτέρω και τα παρόντα που θα αφορούν αυτά τα προϊόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Με εκτίμηση,

Hakan Ohlsson

Johan Ekdahl

Αυριβας μεταφραση ει τα συντη/βαν στην Αγγλική πρωτοταξια.

Αθήνα, 23/8/2014

Η μεταφράσα διευχέρως

ΙΛΒΑ Α. ΜΙΣΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ

και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
ΑΜ ΔΙΑ 80352
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: 1Α ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395

και Συνεργάτες Ανθρωπότητας
Γ. ΚΑΡΥΔΑΗΣ
ΖΑΪΜΗ 45, ΔΙΑ ΔΙΑ 80352
ΑΘΗΝΑ 997603842, 10682 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 8217393 - FAX: 210 8217395

Γ. ΚΑΡΥΔΑΗΣ
ΔΙΑ ΔΙΑ 80352
ΑΘΗΝΑ 997603842
ΤΗΛ.: 210 8217393

Y2 H2
AKN: OPKKA Etalpsa
1 8 0302
106 62 - AOHVA
2 - AOHVA AOHNGN
93 - FAX

AK 100

Service Newsletter

General Information 403

Date: 21 June 2007

Concerning: All

G.o. no.

AK 100 maintenance support period

The maintenance support period for the products AK 100 and AK 100 ULTRA will soon come to its end. The support for technical inquiries, spare parts and spare parts repair will continue until 31st December 2007. Orders for spare parts should be placed as soon as possible.

Up to the date stated above, no updates, modifications or any other type of improvements will be considered unless dictated by safety issues.

Note! After the date stated above, the use of the products is no longer advisable and complaints concerning these products will not be taken into consideration.

Best regards,

Håkan Ohlsson

Johan Ekdahl

Από: "Kokkinos, Vasilis" <Vasilis.Kokkinos@gambro.com>
 Προς: <serco1@otenet.gr>; "cms" <cms@scs-net.org>; "Customer Support Unit - Conventional Equipment" <csu-ce@intermedic.com.lb>; "medical" <medical@darmanagar.co.ir>; <Avi.Peleg@teva.co.il>
 Αποστολή: Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009 9:35 πμ
 Επισύναψη: SP_AK10_AK100_AK90_091120.xls
 Θέμα: Τα ανταλλακτικά για τα AK10/AK100/AK90 θα απορριφθούν

Αξιότιμοι κύριοι,

Η περίοδος υποστήριξης για τα ανταλλακτικά των AK10, AK90 και AK100 έχει λήξει. Για ορισμένα ανταλλακτικά έχουμε ακόμη απόθεμα στο DC Lund (βλ. συνημμένο αρχείο).

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε κάποια από τα υλικά που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο, επικοινωνήστε μαζί μου πριν από τις 2 Δεκεμβρίου. Ειδάλλως τα προϊόντα θα απορριφθούν πριν από το τέλος του έτους.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Κόκκινος
 Συντονιστής Τεχνικής Υποστήριξης
 Τηλ.: +30 210 6621360
 Φαξ: +30 210 6621361
 Κιν.: +30 6948 234434
www.gambro.com

**** Δήλωση αποποίησης ευθύνης από την Εταιρεία Gambro ****

Αυτό το μήνυμα ενδέχεται να περιέχει προνομιακές/εμπιστευτικές πληροφορίες. Εάν δεν είστε ο παραλήπτης που αναγράφεται σε αυτό το μήνυμα (ή υπεύθυνος για την παράδοση του μηνύματος στο εν λόγω πρόσωπο) δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε ή να παραδώσετε αυτό το μήνυμα σε κανέναν. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να καταστρέψετε αυτό το μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα με απαντητικό e-mail. Παρακαλείστε να ενημερώσετε αμέσως εάν εσείς ή ο εργοδότης σας δεν συναινείτε σε διαδικτυακό e-mail για μηνύματα αυτού του είδους. Οι γνώμες, τα συμπεράσματα και οι άλλες πληροφορίες αυτού του μηνύματος που αφορούν τον εργοδότη του αποστολέα και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του αντιπροσωπεύουν τη γνώμη του αποστολέα και δεν εκπροσωπούν ούτε αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις και γνώμες του εργοδότη.

**** Τέλος δήλωσης αποποίησης ευθύνης ****

Η εσωτερική βάση δεδομένων ιών είναι παρωχημένη.
 Ελέγχθηκε από το AVG.

Έκδοση: 7.5.560 / Βάση Δεδομένων Ιών: 270.10.6/1891 - Ημερομηνία Έκδοσης: 13/1/2009 8:17

Πιστή και ακριβή μετάφραση του

συνημμένου εγγράφου από την

Αγγελική Σπινέλα

γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 39

του κώδικα δικηγόρων.

Αθήνα, 23/11/2014

Ο επικεφαλής-βεβαίων Διηγούμενος

ΘΩΤΙΟΣ Θ. ΠΑΜΠΑΝΗΣ
 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΜΔΣΑ: 18705
 ΜΑΧΗΤΩΝ 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 1854
 ΤΗΛ: 097385570 - ΔΟΥ: ΣΤ' ΠΕΙΡΑΙΟΣ
 ΤΗΛ: 210 4210.272 - 210 66.66.956
 ΚΙΝ.: 6945 38 2652

ΘΕΤΙΟΣ ΣΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΜΑΧΗΤΩΝ 21
10M: 03788537
NAL: 21042.10
KML: 8

ΘΕΤΙΟΣ ΣΥ ΜΠΑΡΠΑΝΗ2
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΜΑΧΗΤΩΝ 2 ΠΕΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18705
10M: 03788537
NAL: 21042.10
KML: 8

SERCO LTD

Από: Vasilis Kokkinos, Vasilis" <Vasilis.Kokkinos@gambro.com>
Προς: serco1@otenet.gr; "cms" <cms@scs-net.org>; "Customer Support Unit - Conventional Equipment" <csu-be@intermedic.com.lb>; "medical" <medical@darmanagar.co.ir>; <Avi.Peleg@teva.co.il>

Αποστολή: Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009 9:35 πμ

Επισύναψη: SP_AK10_AK100_AK90_091120.xls

Θέμα: Spare parts for AK10/AK100/AK90 to be scrapped

Dear all,

The support period for AK10, AK100 and AK90 spare parts has ended. For some spare parts we still have stock in DC Lund (see attached file).

If you still have need for any of the materials in the attached file please get back to me before Dec 2nd. Otherwise the products will be scrapped before the year end.

Best regards

Vasilis Kokkinos
Technical Support Coordinator
Tel: +30 210 6621360
Fax: +30 210 6621361
Mob: +30 6948 234434
www.gambro.com

**** Disclaimer from Gambro Corporation ****

Privileged/confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for the delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, you should destroy this message and kindly notify the sender by reply e-mail. Please advise immediately if you or your employer does not consent to Internet e-mail for messages of this kind. Opinions, conclusions and other information in this message that pertain to the sender's employer and its products and services represent the opinion of the sender and do not necessarily represent or reflect the views and opinions of the employer.

**** End of disclaimer ****

Internal Virus Database is out-of-date.

Checked by AVG.

Version: 7.5.560 / Virus Database: 270.10.6/1891 - Release Date: 13/1/2009 8:17 δλ

21/1/2014

Γενικές πληροφορίες 168

Ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου 2013

Σχετικά με: Όλα

C.o. no.

Τέλος υποστήριξης για τα AK 200 / AK 200 ULTRA

Η περίοδος της υποστήριξης συντήρησης για τα AK 200 / AK 200 ULTRA θα φθάσει σύντομα στο τέλος της. Η υποστήριξη για τεχνικές ερωτήσεις, ανταλλακτικά και επισκευή ανταλλακτικών θα συνεχιστεί έως την 31^η Δεκεμβρίου 2013. Οι παραγγελίες για μοναδικά ανταλλακτικά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα, κατά προτίμηση πριν από την 1^η Απριλίου.

Έως την 31^η Δεκεμβρίου 2013 δεν θα εξεταστούν ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή οποιοδήποτε άλλου είδους βελτιώσεις, εκτός αν υπαγορεύονται για λόγους ασφάλειας.

Σημείωση! Δεν συνιστάται πλέον η χρήση των προϊόντων μετά την 31^η Δεκεμβρίου 2013 και τα παράπονα που θα αφορούν αυτά τα προϊόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Με εκτίμηση,

Hakan Ohlsson

Johan Ek Dahl

Ακριβής μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
εκ του συνημμένου στην αγγλική πρωτότυπου

Αθήνα, 30/9/2014


Η Μεταφράστρια Δικηγόρος

ΙΑΒΑ Α. ΜΙΣΙΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ

και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
ΑΜ ΔΣΑ 80352
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
ΑΜ ΔΣΑ 80352
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395



Γ. Κ. ΣΥΔΗΣ
ΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ.
ΑΘΗΝΑ 99760384
ΤΗΛ.: 210 8211331

Γ. Κ. ΣΥΔΗΣ
ΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΝΟΟΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 11527
ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 997603842-ΑΦΟΤ: 1Α ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211331 FAX: 210 8211395

Service Newsletter

AK 200

General Information 168

Date: 23 January 2013

Concerning: All

C.o. no.

End of support for AK 200 / AK 200 ULTRA

The maintenance support period for AK 200 / AK 200 ULTRA will soon come to its end. The support for technical inquiries, spare parts and spare parts repair will continue until 31st December 2013. Orders for unique spare parts should be placed as soon as possible, preferably before 1st April.

Up to 31st December 2013, no updates, modifications or any other type of improvements will be considered unless dictated by safety issues.

Note! After 31st December 2013, the use of the products is no longer advisable and complaints concerning these products will not be taken into consideration.

Best regards

Håkan Ohlsson

Johan Ekdahl



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αβέρωφ 12Α, 10433 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132037545
Φαξ: 2102037531

Αθήνα, 24/07/2015

Αρ. πρωτ. : 2889

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αποφάσισε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο) συνεδρίασή της τα εξής:

1. Η Ε.Π.Υ. αυτοδεσμεύεται, ώστε η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ως προς όλους τους διαγωνισμούς που αυτή διεξάγει να διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη, υπό στοιχεία (α) έως και (δ), διαδικασία και απαιτήσεις:

(α) Ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για κάθε προϊόν και υπηρεσία αναρτάται στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ανακοίνωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με την ανακοίνωση αυτή καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ανάρτησης, πρώτον, όλοι οι προμηθευτές του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν, να υποβάλουν στο Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας τις επίσημες, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και δεύτερον, οι επίσημοι φορείς ή/και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών να υποβάλουν στο ίδιο Τμήμα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας τις προτεινόμενες από αυτούς, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από τους ανωτέρω προμηθευτές και τους ανωτέρω επισήμους φορείς ή/και ενώσεις αυτών γίνεται ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως,

είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)]. Στην ίδια αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας συλλέγει από επίσημους φορείς πιστοποίησης, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εγκεκριμένες από αυτούς τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν.

Το σύνολο του υλικού που κατά τα ανωτέρω υποβάλλεται στο Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και συλλέγεται από αυτό, πρώτον, παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας στην Επιτροπή Προδιαγραφών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της ολοκλήρωσης της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, και δεύτερον, αναρτάται από το ίδιο Τμήμα στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) εργασίμων ημερών.

(β) Κάθε τελικό σχέδιο κάθε Επιτροπής Προδιαγραφών τίθεται υποχρεωτικώς σε δημόσια διαβούλευση.

(γ) Κάθε τελική απόφαση κάθε Επιτροπής Προδιαγραφών πρέπει να διαλέγεται τουλάχιστον με το ως άνω, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο (α), υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, τις εν γένει διεθνείς, παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, τις παραδοχές της επιστήμης, την εμπειρία, τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου.

(δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο κατά το δυνατόν γενικό, ώστε τουλάχιστον να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή.

2. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ως προς όλους τους διαγωνισμούς που διεξάγονται από δημόσιους φορείς υγείας πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, με τις εξής δύο διαφοροποιήσεις:

(α) Η προβλεπόμενη στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1 ανάρτηση λαμβάνει χώρα στην επίσημη ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

(β) Αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 1 για την εν γένει συλλογή του υλικού που παραδίδεται στην Επιτροπή

Προδιαγραφών λογίζεται η υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την προμήθεια του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. Οι απαιτήσεις των στοιχείων (γ) και (δ) της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν από την 17^η Ιουλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία η Ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ενέκρινε το σύνολο της διαδικασίας και των απαιτήσεων της παραγράφου 1, μόνον τις Επιτροπές Προδιαγραφών που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και δεν έχουν ακόμη, έως την ως άνω ημερομηνία, παραδώσει υπογεγραμμένες, από όλα τα μέλη τους, τις προτεινόμενες από αυτές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, πλην της ειδικότερης απαίτησης του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα να διαλέγονται με το υλικό που το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1, να παραδίδει σε κάθε Επιτροπή Προδιαγραφών.

Ο Αντιπρόεδρος

Απόστολος Κ. Σίνης

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΣ : ▪ **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**
 ▪ **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Πρόεδρος / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία

▪ **Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την εξέταση της παρούσας**

Θέμα : Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του οίκου GAMBRO

Σχετικά με το έγγραφό σας με αριθμ. πρωτ. 2889/24-07-2015 που αφορά την ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο), σας υποβάλουμε τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που δραστηριοποιείται και προσφέρει η εταιρεία μας για 30 και πλέον χρόνια στα Δημόσια Νοσοκομεία στην Ελλάδα, ήτοι **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO.**

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO.

1) Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου GAMBRO της Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου .

2) Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο .

3) Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα υπό ανάθεση μηχανήματα (συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων) ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε όμοιους τύπους μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου GAMBRO.

4) Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) συντηρήσεις κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους (μία ανά τρίμηνο). Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο)

με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

- 5) Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν., μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.
- 6) Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων, αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το νοσοκομείο.
- 7) Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
- 8) Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.
- 9) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.
- 10) Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά κάθε μηχανήματος τεχνητού νεφρού (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.
- 11) Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου.
- 12) Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:
 - Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει αμέριστα την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου GAMBRO του Νοσοκομείου .

Η τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχανήμα τεχνητού νεφρού τον μήνα και θα περιλαμβάνει όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε περίπτωση που κάποιο μηχανήμα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως .

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο .

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, εν μέρει, περιλαμβάνονται σε πρόσφατη διακήρυξη με αριθμ. 5402/23-06-2015 (Σχετ. 1) του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», ο οποίος διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, οι προδιαγραφές της διακήρυξης αυτής συντάχθηκαν από το νοσοκομείο, μέσω δημόσιας διαβούλευσης που διενέργησε και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με το πρακτικό υπ' αριθμ. 64/14-05-2015.

Επίσης παρόμοιες προδιαγραφές περιλαμβάνονται και στις διακηρύξεις του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 2) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 3), όπως και στις δύο τελευταίες διακηρύξεις της Ν.Μ. Μεσολογγίου 2860 (Σχετ. 4) και 11898 (Σχετ. 5) στις οποίες δεν υφίστανται αδικαιολόγητα εμπόδια ανάπτυξης και λειτουργίας του ανταγωνισμού.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο) και πιο συγκεκριμένα στο στοιχείο (δ) της παραγράφου 1 αναφέρεται:

«(δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο κατά το δυνατόν γενικό, ώστε τουλάχιστον να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή.»

Ενώ λοιπόν βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και όχι ο περιορισμός του ...μέσω τεχνικών προδιαγραφών ... που ευνοούν ένα συγκεκριμένο προμηθευτή με αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων και οικονομικότερων τιμών καθώς και ποιοτικότερων υπηρεσιών, παρατηρείται το φαινόμενο σε κάποια Δημόσια Νοσοκομεία να θέτουν ακριβώς προδιαγραφές τέτοιες οι οποίες φωτογραφίζουν απόλυτα ένα συγκεκριμένο προμηθευτή, κατακρεουργώντας κάθε έννοια ανταγωνισμού και οδηγώντας τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς επί της ουσίας σε κεκαλυμμένες απ' ευθείας αναθέσεις ανεξαρτήτου ποιότητας και προσφερόμενης τιμής, ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Για τα φαινόμενα αυτά η εταιρεία μας έχει καταθέσει στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας πλήθος εγγράφων που τα καταγγέλλει.

2. Φωτογραφικές προδιαγραφές και όροι που πρέπει να αποφευχθούν.

2.1. Όρος «Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία».

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για το κάθε Νοσοκομείο. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η **ευθύνη του κατασκευαστή** να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. Τούτο, δε, οφείλει να πράττει απαρέγκλιτα ο κατασκευαστής, προκειμένου να διατίθεται νομίμως το ιατροτεχνολογικό του προϊόν (μηχάνημα) εντός της ΕΕ. Γι' αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται ή διακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE, δεικνύοντας τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με όλες τις νομικές

απαιτήσεις για την επίτευξη τη σήμανση CE και, συνεπώς, την εξασφάλιση ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σήμανση CE προορίζεται για την εθνική εποπτεία της αγοράς και των αρχών επιβολής του νόμου, ως ένδειξη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση λοιπόν η υποχρέωση αυτή του κατασκευαστή μηχανημάτων απέναντι στον χρήστη, να φροντίζει για την αναβάθμιση των μηχανημάτων και να παρέχει προς τούτο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί (μέσω της τυχόν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του συγκεκριμένου όρου) σε δυνατότητα του κατασκευαστή να δίδει ή όχι τις αναγκαίες πληροφορίες.

Αλλά ούτε και θα μπορούσε ο προαναφερόμενος όρος να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί με τρόπο που θα υπέθαλπε και θα νομιμοποιούσε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζει έναντι της εταιρείας μας ο οίκος Gambro, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2012 μας έχει στερήσει παράνομα και καταχρηστικά την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Σημειωτέον ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές γι' αυτό στην Ελληνική Δικαιοσύνη και καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όπως δικαιωθήκαμε για το παράνομο αθέμιτο και αντι ανταγωνιστικό μποιϊκοτάζ στην προμήθεια ανταλλακτικών, που μας επέβαλαν για δύο και πλέον χρόνια, είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα δικαιωθούμε και για το θέμα της τεχνολογίας.

Πλέον τούτων, τονίζουμε με έμφαση ότι υπάρχουν Δημόσια Νοσοκομεία με οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, που αναλαμβάνουν από μόνα τους τις συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων τους και για τα οποία δεν προέκυψε ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την οποιαδήποτε αναβάθμιση, ακριβώς επειδή είναι υποχρέωση του κατασκευαστή να τις παρέχει χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προμήθειας με αριθμό 4567/2003 του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια 121 Μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro τύπου AK-95S ΚΑΙ AK-200S, σε 24 δημόσια νοσοκομεία, από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αναφέρεται στη σελίδα 10 όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικών ότι *«Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχ/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για Αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα» (Σχετ. 6).*

Ακολουθώς, στη σελίδα 26 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ως επιλογή τεχνικής στήριξης για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και αυτόνομο *service* στα Νοσοκομεία ως συμφέρουσα λύση και εκπαίδευση των τεχνικών με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι ηλεκτρονικοί.

β. Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.

γ. Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις των και τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο.

2.2. Όρος «Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία των μηχανημάτων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους στα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας ή εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος».

2.2.1 Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι

αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι ευνοούν και υποθάλλουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούνταν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμέλους Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ.7), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα

(εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπτώξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον

αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαιώσεως που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

2.2.2 Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από τα Νοσοκομεία απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλλει πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

2.3. Όρος : *«Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των μηχανημάτων ή να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία και εμπειρία της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας για την επισκευή και συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού».*

Ο εν λόγω όρος στο βαθμό που απαιτεί την ύπαρξη εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς προϋποθέτει συμβατική σχέση μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρίας και του αναδόχου συντηρητή, κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο για τον επιδιωκόμενο νόμιμο στόχο, ήτοι για την πιστοποίηση της πραγματικής δυνατότητας του αναδόχου συντηρητή για συντήρηση και επισκευή των σχετικών ιατρικών μηχανημάτων. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση της αναδόχου εταιρίας με την κατασκευάστρια εταιρία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες

αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τον τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους. Συνακόλουθα οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή, είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από δημόσια νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την

τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 1) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, αρ.πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 4) και αρ.πρωτ. 11898/17-11-2014 (Σχετ. 5) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Υπογραμμίζουμε δε, ότι, αν ελεγχθούν οι φάκελοι των συμβάσεων, όλων των ετών, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, που αφορούν την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro, πολύ εύκολα θα διαπιστωθεί ότι, πριν το 2010 κανένας όρος περί βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή τίθεντο, καθώς και καμία βεβαίωση από τον κατασκευαστή δεν διέθεταν οι σημερινοί περιούσιοι συντηρητές, που αντιπροσωπεύουν το εν λόγω KAPTEA. Τέτοιοι όροι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, και ξεκάθαρα τέθηκαν από κάποια νοσοκομεία με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του KAPTEA.

Γ. Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού από το 1976. Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρεία μας ήταν το μοναδικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο

επισκευών της Gambro στην Ελλάδα, καθώς και ο αποκλειστικός διανομέας ανταλλακτικών. Ουδέποτε όμως χρησιμοποιήσαμε ή εκμεταλλευτήκαμε την ιδιότητα μας αυτή για να μονοπωλήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αθέμιτα την Ελληνική Αγορά των επισκευών και συντηρήσεων των Μ.Τ.Ν. του οίκου Gambro. Αντιθέτως δίναμε απλόχερα σε όποιον μας ζητούσε τόσο τα ανταλλακτικά όσο και την τεχνολογία της Gambro, ως αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη εταιρεία που ήμασταν, χωρίς να δημιουργούμε το παραμικρό εμπόδιο εισόδου και παραμονής σε κανέναν στην εν λόγω αγορά.

Η εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ (MEDICAL) έχει αποδυθεί σε απόλυτη σύμπνοια και συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο Gambro Lundia AB (GAMBRO) επί τετραετία και πλέον, σε ανηλεή εμπορικό πόλεμο κατά της εταιρείας μας με αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές, προκειμένου να πετύχει την μονοπώληση της ελληνικής αγοράς παροχής υπηρεσιών service στα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του ως άνω κατασκευαστικού οίκου, επί ζημιά του ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος. Επί των ως άνω παράνομων πρακτικών και επιδιώξεων των δύο εταιριών έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2011, η GAMBRO παράνομα και αντισυμβατικά έπαψε να μας τροφοδοτεί με ανταλλακτικά και μας παρέπεμψε στη Medical, τον νέο διανομέα της ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά. Πλην, όμως αργότερα και η Medical διέκοψε την τροφοδοσία της ΣΕΡΚΟ, την οποία όπως μας δήλωσε (προσχηματικά όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων) θα διατηρούσε μόνο για τις εκκρεμείς συμβάσεις μας. Εν συνεχεία, στις 16 Φεβρουαρίου του 2012 η GAMBRO, σε πλήρη σύμπλευση με τη MEDICAL κλιμακώνοντας τις αντιανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές τους, αιφνιδίως διέκοψε στη ΣΕΡΚΟ την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματά της προκειμένου να δυναμιτίσει την παροχή υπηρεσιών από μέρους μας.

Η εταιρεία μας προσέφυγε αμέσως στη Δικαιοσύνη, η οποία δια της υπ' αριθμ. 5667/2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απεφάνθη μεταξύ άλλων κατά το διατακτικό της:

- *ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ* ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά –

Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

- ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπτράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Η εταιρεία μας είναι από τις λίγες εξαιρέσεις στην ελληνική αγορά της συντήρησης των Ιατρικών Μηχανημάτων που προσπαθεί να λειτουργήσει και να επιβιώσει στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού. Κάποια νοσοκομεία ενώ βλέπουν ότι στους περισσότερους διαγωνισμούς συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων δεν αναπτύσσεται καθόλου ανταγωνισμός και λειτουργεί το απόλυτο μονοπώλιο προσπαθούν, αντί να συνδράμουν στην ανάπτυξη ανταγωνισμού και στο άνοιγμα της αγοράς και σε μικρές εταιρείες όπως η εταιρεία μας, να προσφέρουν παρανόμως υπηρεσίες υπέρ της στεγανοποίησης της αγοράς, βοηθώντας και συμμετέχοντας στις εναρμονισμένες παράνομες αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές των πολυεθνικών κατασκευαστών και των βραχιόνων τους.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι σε Διαγωνισμό Δημόσιου Νοσοκομείου για την συντήρηση μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στον οποίο δεν συμμετείχαμε, λόγω του

παράνομου μποικοτάζ προμήθειας ανταλλακτικών, που προαναφέραμε, και έχουμε ήδη δικαιωθεί, η διαφορά - ζημιά - για το Δημόσιο συμφέρον φθάνει τις 13.500 €, παραπάνω κόστος από τη μονοπωλιακή σύμβαση που υπέγραψε με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ.

Σε όλο τον κόσμο οι συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων γίνονται είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων (OEMs) είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής τεχνικών υπηρεσιών (ISOs) είτε από τεχνικό προσωπικό των πελατών των μηχανημάτων (internal ή inhouse). (βλ. αντίστοιχες εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) (Σχετ. 8).

Κι ενώ σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται πολύ έντονος ανταγωνισμός στην αγορά της επισκευής και συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων καθώς και στην αγορά των ανταλλακτικών, με τεράστια οφέλη για τα νοσοκομεία και τις κλινικές, το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα Ε.Π.Ε. και της Gambro, θεωρώντας τη χώρα μας απόλυτη μπανανία επιμένει στην μονοπώληση της αγοράς στις εξωφρενικές τιμές που αυτή επιθυμεί και στην αμφίβολη ποιότητα που θέλει να επιβάλει.

Όλα τα παραπάνω τα έχουμε κοινοποιήσει και είναι εν γνώση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, καθώς και μέσω των καταγγελιών μας και Αγωγών είναι εν γνώση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Οράτε ενδεικτικά:

Στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας: Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2102, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-

2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ. 1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015.

Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας: Αρ. πρωτ. 2210/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2211/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2335/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 2336/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 321/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 406/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 621/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 622/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 1009/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1010/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1011/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1207/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1208/19-5-2012, Αρ. πρωτ. 1209/19-5-2015.

Στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Αρ. πρωτ. 2280/22-5-2014, Αρ. πρωτ. 2344/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2345/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2427/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2624/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 2793/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 2887/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 2888/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3222/30-7-2014, Αρ. πρωτ. 3255/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 3588/4-9-2014, Αρ. πρωτ. 3938/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 3993/26-9-2014, Αρ.

πρωτ. 4086/2-10-2014, Αρ. πρωτ. 4170/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4169/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4218/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 4247/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 4666/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 5401/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5402/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5403/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5404/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5405/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5406/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 658/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 659/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 842/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 1140/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1142/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1963/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1964/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1965/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1966/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1967/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 2213/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2214/19-5-2012 Αρ. πρωτ. 2215/19-5-2015.

Στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης: Αρ. πρωτ. 23836/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 25335/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 26642/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 26643/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 27771/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 27772/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 3387/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 4175/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 5611/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 5613/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 9919/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9920/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9922/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9923/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9924/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 11347/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 11348/19-5-2012, Αρ. πρωτ. 11350/19-5-2015.

Προς επιπλέον απόδειξη ότι τα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία απαιτούν ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες και δεν τάσσονται υπέρ του παράνομου ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αλλά υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ απορρίπτοντας τις παράνομες πρακτικές του ΚΑΡΤΕΛ, σας παραθέτουμε λίστα με τα Δημόσια Νοσοκομεία που προσφάτως έχει συνάψει συμβάσεις η εταιρεία μας , και είμαστε στη διάθεσή σας, μόλις μας ζητηθεί, να σας προσκομίσουμε και τα πρακτικά κατακύρωσης – συμβάσεις, παρόλο που αυτά είναι δημόσια διαθέσιμα από την εφαρμογή της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ :

- 1) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- 2) Γ. Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ
- 3) Γ. Νοσοκομείο –Κ.Υ. Κω
- 4) Γ. Νοσοκομείο Φιλιατών
- 5) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
- 6) Γ. Νοσοκομείο Λευκάδας
- 7) Γ. Νοσοκομείο Καλύμνου
- 8) Γ. Νοσοκομείο Λιβαδειάς

- 9) Γ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
- 10) 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
- 11) Γ. Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
- 12) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
- 13) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΠΚ
- 14) Γ. Νοσοκομείο Χαλκίδας
- 15) Γ. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κύμης
- 16) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- 17) Γ. Νοσοκομείο Μεσολογγίου
- 18) Γ. Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
- 19) Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας
- 20) Γ. Νοσοκομείο Πύργου
- 21) Γ. Νοσοκομείο Αγρινίου
- 22) Γ. Νοσοκομείο Ρεθύμνου
- 23) Γ. Νοσοκομείο Πρέβεζας

Κατόπιν τούτων, η συμβολή των Δημόσιων Νοσοκομείων και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει να είναι καθοριστική στην αποτροπή εγκαθίδρυσης παράνομων μονοπωλιακών καταστάσεων στις προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων, με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη του Δημόσιου Συμφέροντος μέσω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνονται απλοί παρατηρητές και ακόμη περισσότερο συμμετοχοί στο «τεράστιο πάρτυ» των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ .

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των παραπάνω σας παραθέτουμε αυτούσιες τις παρατηρήσεις τις εταιρείας μας , από τη συμμετοχή της σε 2 πρόσφατες Δημόσιες Διαβουλεύσεις Τεχνικών προδιαγραφών .

1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

(αριθμ. πρωτ. ΕΠΥ : 3211/20-8-2015)

«Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015

- ΠΡΟΣ:
- 4^η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 - Διοικητή
 - Γραφείο Προμηθειών / Κα Βακαλίδου
 - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 - Αναπλ. Διοικητή Νοσοκομείου / Κο Νικόλαο Φαρμάκη
 - Γραφείο Προμηθειών / Κα Αφροδίτη Μιχαηλίδου
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Προέδρου / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /
Κο Λέανδρο Ρακιντζή
 - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 - Κεντρική Υπηρεσία: Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα.
 - Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης: Αγίας Σοφίας 46,
54622 Θεσσαλονίκη / Υπόψη Κού Σαβαΐδη Γεωργίου
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την
εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για την πρώτη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμου ακριβείας» (срν 5042100-2) – Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών Ε. Για τη συντήρηση Εννέα (9) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά και χωρίς αναλώσιμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.050 € με ΦΠΑ,

Α. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει

να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

«Ε) Για τη συντήρηση Εννέα (9) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά και χωρίς αναλώσιμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.050 € με ΦΠΑ.»

1.Όρος « Να κατατεθεί βεβαίωση της Κατασκευάστριας Εταιρείας ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα.

Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από το Νοσοκομείο απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τουτό, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλλει πράγματι την παράνομη και ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ως άνω όρος περί προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο δεν υπήρχε, με αυτή τη μορφή, σε παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Ειδικότερα, στην τελευταία διακήρυξη με αριθμ. 94/2014 αναγραφόταν ότι:

«Να καταθέσει βεβαίωση της Κατασκευάστριας Εταιρείας ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα ή σε άλλα ανάλογα μηχανήματα της ίδιας Εταιρείας»

δινόταν έτσι η δυνατότητα στην εταιρεία μας να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και να εγκριθεί η τεχνική μας προσφορά από την επιτροπή του διαγωνισμού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, παρόλη την έλλειψη πιστοποιητικών εκπαίδευσης για τα μηχανήματα AK-200 ULTRA, αφού καταθέσαμε πιστοποιητικά εκπαίδευσης παρόμοιων μηχανημάτων του ίδιου οίκου κατασκευής (AK-200S), πετυχαίνοντας έτσι το νοσοκομείο για πρώτη φορά ανάπτυξη ανταγωνισμού και συμμετοχή μεγαλύτερη του ενός συντηρητή, πέραν αυτή του επί πολλών ετών μονοπωλιακού και κεκαλυμμένου απευθείας αναδόχου.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από άλλα νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με

τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 1) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε ο ως άνω όρος των τεχνικών προδιαγραφών να διαμορφωθεί ανάλογα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον εκάστοτε ανάδοχο συντηρητή να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια μέσω σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να μην εξαρτάται η απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον κατασκευαστή.

Η εταιρεία μας παρά την έλλειψη των πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή οίκο, δραστηριοποιείται επιτυχώς στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού στην Ελλάδα από το 1976, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών αλλά και πολύ πιο οικονομικότερων για το συμφέρον των νοσοκομείων και για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ εν γένει, Τιμών . Οράτε Σχετ. 2 Σύμβαση υπ' αριθμ. 8992/23-04-15, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (20 μηχανήματα τύπου AK-200S και 9 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 158 € το μηχάνημα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχάνημα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ

Ομοίως οράτε Σχετ. 3 Σύμβαση υπ' αριθμ. πρωτ. 8748, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ, Κόμης με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (5 μηχανήματα τύπου AK-200S και 2 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 169,98 € το μηχάνημα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχάνημα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Ομοίως οράτε Σχετ. 4 Σύμβαση υπ' αριθμ. 1/1-8/2014, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (10 μηχανήματα τύπου AK-200S και 1 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 172 € το μηχανήματα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήματα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΛΑΤΡΙΚΗ.

Επίσης οράτε Σχετ. 5 Σύμβαση υπ' αριθμ. 9075, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (7 μηχανήματα τύπου AK-200S και 4 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τελική τιμή των 160,00 € το μηχανήματα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήματα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΛΑΤΡΙΚΗ.

Στην τελευταία διακήρυξη του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με αριθμ. 94/2014, στον εν λόγω όρο υπήρχε η φράση : ή σε άλλα ανάλογα μηχανήματα της ίδιας Εταιρείας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μεγαλύτερης του ενός συντηρητή συμμετοχής και της πραγματικής ανάπτυξης ανταγωνισμού. Στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και από τον συγκεκριμένο όρο αφαιρέθηκε αυτή η φράση. Ευλόγως, κάθε νοήμων άνθρωπος, θα απορούσε για την σκοπιμότητα της αλλαγής αυτού του όρου :

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει ευρεία συμμετοχή και ανάπτυξη ανταγωνισμού στη συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO ;

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει ποιοτικότερες υπηρεσίες συντήρησης ;

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει οικονομικότερες τιμές και εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ ;

Η μήπως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με πρόσχημα δήθεν την εξασφάλιση της τεχνικής επάρκειας του συντηρητή, θέλει με πάση θυσία την διατήρηση της

πολύχρονης παράνομης μονοπωλιακής συνεργασίας, με τον περιούσιο συντηρητή , ανεξαρτήτου ποιότητας και κόστους ;

Υπογραμμίζοντας δε ότι, αν ελεγχθούν οι φάκελοι των συμβάσεων , όλων των ετών συνεργασίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με τον επί πολλά χρόνια περιούσιο συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. , πολύ εύκολα θα διαπιστωθεί ότι , πριν το 2010 κανένας όρος περί βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή τίθεντο, καθώς και καμία βεβαίωση από τον κατασκευαστή δεν διέθετε ο εν λόγω περιούσιος συντηρητής.

2.Όρος «Να καταθέσει βεβαίωση από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών, που θα φέρουν πιστοποίηση CE, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης»

Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί

και υποθάλπει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι ευνοούν και υποθάλπουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούνταν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ. 6), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε

ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαιώσεως που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

Γ. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι οι όροι που τίθενται στο κείμενο της διαβουλεύσεως διαψεύδουν την υποτιθέμενη πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και καταλήγει σε κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση με το πρόσχημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε όλως ενδεικτικώς τις διακηρύξεις των Δημόσιων Νοσοκομείων, του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 7) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 8), του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Σχετ. 1) στις οποίες δεν υφίστανται τα αδικαιολόγητα εμπόδια που το Νοσοκομείο σας ορθώνει στον ανταγωνισμό.

Τα προς χάριν παραδείγματος προαναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία, όχι μόνο διαμόρφωσαν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ήδη δρέπουν τους καρπούς των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών τους (συμμετείχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με εξοικονόμηση δαπανών για τα Νοσοκομεία).

Τα Νοσοκομεία που θέλησαν πραγματικά και όχι προσχηματικά να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής συντηρητών πέτυχαν και απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε πολύ οικονομικότερες τιμές :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

A/A	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ- Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ	158,00 €	29 Μ.Τ.Ν.	20 MTN AK-200S & 9 MTN AK-200 ULTRA S
2.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	172,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S & 1 AK-200 ULTRA S
3.	ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ	165,00 €	2 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S
4.	Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	165,00 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S, 2 MTN AK-200 2 MTN AK-95S
5.	Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	170,00 €	11 Μ.Τ.Ν	4 MTN AK-200S, 6 MTN AK-200 & 1 MTN AK-95

6.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ	195,00 €	10 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S
7.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	178,95 €	7 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S
8.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	160,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S & 4 AK-200 ULTRA S
9.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	162,50 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-95, 3 MTN AK-95S & 1 MTN AK-200S
10.	Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ	189,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	6 MTN AK-200, 2 MTN AK-95 & 1 MTN AK-200S
11.	Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	166,67 €	13 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95, 1 MTN AK-200, & 8 MTN AK-200S
12.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	176,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	1 MTN AK-10, 1 MTN AK- 100, 2 MTN AK-200, 4 MTN AK-200S & 1 MTN AK-200SU
13.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – Κ.Υ. ΑΗΜΝΟΥ	177,78 €	7 Μ.Τ.Ν.	3 MTN AK-10, 1 MTN AK-95 & 3 MTN AK-200S
14.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	160,00 €	4 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95S

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

[...]

Τέλος, εφόσον η παρούσα διαβούλευση δεν είναι προσχηματική και υπάρχει πραγματική βούληση – πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και της μέγιστης δυνατής ανάπτυξης ανταγωνισμού,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας και να διαμορφώσετε ανάλογα τους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας έτσι, για πρώτη φορά:

- το σταμάτημα των ασύμφορων μονοπωλιακών συνεργασιών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

[...]»

2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(αριθμ. πρωτ. ΕΠΥ : 3212/20-8-2015)

«Αθήνα, 06 Ιουλίου 2015

- ΠΡΟΣ:**
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ &
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κος Γεώργιος Βλάχος
 - Τμήμα Οικονομικού /
Κα Δέσποινα Λαυρέντζου – Κα Ρ. Φραγκιαδουλάκη
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Πρόεδρου / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για την δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro, σύμφωνα με την πρόσκληση υπ' αριθμ. 9020/30-6-2015

Α. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές Ν.Μ. Αργινίου(των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO) – Ν.Μ. Μεσολογγίου

1. Όρος «Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία».

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για το κάθε Νοσοκομείο. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η **ευθύνη του κατασκευαστή** να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. Τούτο, δε, οφείλει να πράττει **απαρέγκλιτα** ο κατασκευαστής, προκειμένου να διατίθεται νομίμως το ιατροτεχνολογικό του προϊόν (μηχάνημα) εντός της ΕΕ. Γι' αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται ή διακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE, δεικνύοντας τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη τη σήμανση CE και, συνεπώς, την εξασφάλιση ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σήμανση CE προορίζεται για την εθνική εποπτεία της αγοράς και των αρχών επιβολής του νόμου, ως ένδειξη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση λοιπόν η υποχρέωση αυτή του κατασκευαστή μηχανημάτων απέναντι στον χρήστη, να φροντίζει για την αναβάθμιση των μηχανημάτων και να παρέχει προς τούτο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί

(μέσω της τυχόν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του συγκεκριμένου όρου) σε δυνατότητα του κατασκευαστή να δίδει ή όχι τις αναγκαίες πληροφορίες.

Αλλά ούτε και θα μπορούσε ο προαναφερόμενος όρος να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί με τρόπο που θα υπέθαλπε και θα νομιμοποιούσε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζει έναντι της εταιρείας μας ο οίκος Gambro, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2012 μας έχει στερήσει παράνομα και καταχρηστικά την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Σημειωτέον ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές γι' αυτό στην Ελληνική Δικαιοσύνη και καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όπως δικαιωθήκαμε για το παράνομο αθέμιτο και αντιανταγωνιστικό μποϊκοτάζ στην προμήθεια ανταλλακτικών, που μας επέβαλαν για δύο και πλέον χρόνια, είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα δικαιωθούμε και για το θέμα της τεχνολογίας.

Πλέον τούτων, τονίζουμε με έμφαση ότι υπάρχουν Δημόσια Νοσοκομεία με οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, που αναλαμβάνουν από μόνα τους τις συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων τους και για τα οποία δεν προέκυψε ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την οποιαδήποτε αναβάθμιση, ακριβώς επειδή είναι υποχρέωση του κατασκευαστή να τις παρέχει χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προμήθειας με αριθμό 4567/2003 του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια 121 Μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro τύπου AK-95S ΚΑΙ AK-200S, σε 24 δημόσια νοσοκομεία, από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αναφέρεται στη σελίδα 10 όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικών ότι «Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχ/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για Αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα» (Σχετ. 1).

Ακολούθως, στη σελίδα 26 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ως επιλογή τεχνικής στήριξης για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και αυτόνομο service στα Νοσοκομεία ως συμφέρουσα λύση και εκπαίδευση των τεχνικών με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι ηλεκτρονικοί.

β. Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.

γ. Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις των και τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο.

2. Όρος (Ετήσιας συντήρησης των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRÖ της Ν.Μ. Αγγινίου(σελίδα 25) – τεχνικές προδιαγραφές Ν.Μ. Μεσολογγίου (α/α:12 σελίδα 28)) «Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία των μηχανημάτων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους στα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας ή εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος».

2.1 Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό

αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι ευνοούν και υποθάλπουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούνταν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ.2), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπτώξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαιώσεως που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

2.2 Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από το Νοσοκομείο απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον

κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλλει πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζουμε στο Νοσοκομείο ότι οι ως άνω όροι περί πιστοποιητικού συνεργασίας με τον κατασκευαστικό οίκο για την προμήθεια ανταλλακτικών, καθώς και περί προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο δεν υπήρχαν σε παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών των νοσοκομείων σας. Ειδικότερα, στην πρόσκληση με αριθμ. Πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 3) της Ν.Μ. Μεσολογγίου αναγραφόταν ότι:

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη μονάδα τεχνητού νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς.

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Όμοιους όρους είχε και η προγενέστερη πρόσκληση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου με αρ. πρωτ. 11898/17-11-2014. (Σχετ. 4).

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές στη Ν.Μ. Μεσολογγίου

3. Όρος : «Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των μηχανημάτων ή να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία και εμπειρία της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας για την επισκευή και συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού».

Ο εν λόγω όρος στο βαθμό που απαιτεί την ύπαρξη εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς προϋποθέτει συμβατική σχέση μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρείας και του αναδόχου συντηρητή, κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο για τον επιδιωκόμενο νόμιμο στόχο, ήτοι για την πιστοποίηση της πραγματικής δυνατότητας του αναδόχου συντηρητή για συντήρηση και επισκευή των σχετικών ιατρικών μηχανημάτων. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση της αναδόχου εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει

εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τον τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους. Συνακόλουθα οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή, είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από άλλα νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 5) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα ΑΚ 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης ΑΚ 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας

Μεσολογγίου, αρ.πρωτ. 11898/17-11-2014 (Σχετ. 3) και αρ.πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 4) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε ο ως άνω όρος των τεχνικών προδιαγραφών να διαμορφωθεί ανάλογα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον εκάστοτε ανάδοχο συντηρητή να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια μέσω σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να μην εξαρτάται η απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον κατασκευαστή.

Θεωρούμε ότι ουδέν έχει να προσφέρει ο εν λόγω όρος, καθώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις καλύπτονται πλήρως από τους έτερους όρους σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να προσκομίζεται:

«Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας συντήρησης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ. /1348/2004 σχετικά με την ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

«Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 ή ISO 13485 για τη Διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ εξοπλισμού».

«Να κατατεθούν σχετικές βεβαιώσεις καλής συνεργασίας και εκτέλεσης των συμβάσεων συντήρησης με αντίστοιχα ιδρύματα».

Συνεπώς προτείνουμε την πλήρη απόλεια του εν λόγω όρου από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Γ. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι οι όροι που τίθενται στο κείμενο της διαβουλεύσεως διαψεύδουν την υποτιθέμενη πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και καταλήγει σε κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση με το πρόσχημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε όλως ενδεικτικώς τις διακηρύξεις δύο Δημόσιων Νοσοκομείων, του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 6) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 7), καθώς και του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Σχετ. 5), όπως και τις δύο τελευταίες διακηρύξεις της Ν.Μ. Μεσολογγίου 2860 (Σχετ. 3) και 11898 (Σχετ. 4) στις οποίες δεν υφίστανται τα αδικαιολόγητα εμπόδια που το Νοσοκομείο σας ορθώνει στον ανταγωνισμό.

Τα προς χάριν παραδείγματος προαναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία, όχι μόνο διαμόρφωσαν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ήδη δρέπουν τους καρπούς των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών τους (συμμετείχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με εξοικονόμηση δαπανών για τα Νοσοκομεία). Σας επισυνάπτουμε το πρακτικό του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 8) όπου έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Ομοίως τους καρπούς της ανάπτυξη του ανταγωνισμού έδρεψε το Νοσοκομείο σας σε όλες τις προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες κερδίζοντας οικονομικότερες αλλά και ποιοτικότερες υπηρεσίες, οράτε ενδεικτικά το διαγωνισμό του Νοσοκομείου Αργινίου με την υπ' αριθμό 17200/31-10-2014 & ΑΔΑ 756Π46904Μ-ΨΒ6 ανάρτηση του Νοσοκομείου σας, για την Τρίμηνη Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης Gambro για το χρονικό διάστημα τριών μηνών, στον οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας υποβάλλοντας την προσφορά της, καθώς και η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ. Η προσφορά της εταιρείας μας (ΣΕΡ.ΚΟ) ανερχόταν στα 2.898,00 € χωρίς ΦΠΑ και η προσφορά της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ανερχόταν στο ποσό των 3.699,00 € χωρίς ΦΠΑ δηλαδή διαφορά – όφελος για το Νοσοκομείο από την ανάπτυξη ανταγωνισμού: 801,00 € για τους τρεις μήνες και 3204,00 € αναγόμενο σε ετήσια βάση.

Και αντίστοιχα το διαγωνισμό της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11898/17-11-2014 και ΑΔΑ: ΨΨΑΑ46907Π-ΥΕΔ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, για την επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού για το χρονικό διάστημα δύο μηνών, στον οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας υποβάλλοντας την προσφορά της, καθώς και η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ. Η προσφορά της εταιρείας μας (ΣΕΡ.ΚΟ) ανερχόταν στα 1.638,00 € χωρίς ΦΠΑ και η προσφορά της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ανερχόταν στο ποσό των 2.160,00 € χωρίς ΦΠΑ δηλαδή διαφορά – όφελος για το Νοσοκομείο από την ανάπτυξη ανταγωνισμού: 522,00 € για τους δύο μήνες και 3.132,00 € αναγόμενο σε ετήσια βάση.

Το Νοσοκομείο σας γνωρίζει άριστα τις πολύ ποιοτικές και οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες που προσφέρει όλα τα χρόνια η εταιρεία μας ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ από την πολυετή συνεργασία του μαζί μας από το 1986 μέχρι και σήμερα .

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

[...]»

Επειδή η εταιρεία μας, όπως έχει διαπιστώσει και υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βιώνει τις σκληρές πρακτικές ενός αδίστακτου καρτέλ που επιδιώκει τη μονοπώληση των δημόσιων διαγωνισμών επί μεγίστη βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.

Επειδή οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες των υπό ανάθεση συμβάσεων και πρέπει να δρουν υπέρ του ανταγωνισμού, έτσι ώστε

να απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες με περισσότερο από 30% χαμηλότερες τιμές.

Επειδή οι δημόσιες συμβάσεις και οι σχετικοί διαγωνισμοί απαγορεύεται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία να αποτελούν απευθείας ανάθεση, αλλά αντιθέτως πρέπει να σέβονται κατά τις διεξαγόμενες διαδικασίες τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

Επειδή τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι τσιφλίκι κανενός, δεν πρέπει να πετούν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού προκειμένου να υποστηρίξουν το ΚΑΡΤΕΛ της Medical, της Τεχνοϊατρική και της Gambro.

Επειδή η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας τελεί σε πλήρη γνώση της δράσης του ΚΑΡΤΕΛ της Medical, της Τεχνοϊατρική και της Gambro με πλήθος εγγράφων που σας έχει κοινοποιήσει η εταιρεία μας :

Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2012, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ. 1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015,

Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015,
Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3211/20-8-2015,
Αρ. πρωτ. 3212/20-8-2015.

Επειδή η παρούσα υποβολή των Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται από την εταιρεία μας ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή , cd , εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών , όπως ορίζει η ανακοίνωση σας , έγγραφο με αρ. πρωτ. 2889/24-07-2015 .

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές και Παρατηρήσεις μας και να διαμορφώσετε ανάλογα τους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας έτσι :

- το σταμάτημα των ασύμφορων μονοπωλιακών συνεργασιών των Δημόσιων Νοσοκομείων .
- την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο των συμβάσεων λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro .
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τους προϋπολογισμούς των Δημόσιων Νοσοκομείων – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Επισυναπτόμενα Σχετικά:


- 1) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 5402/23-06-2015 του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου– Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
- 2) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 6/2014 του Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «TZANEIO»
- 3) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 2137/2015 του Γ.Ν. Ρεθύμνου
- 4) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 2860/20-03-2015

- 5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 11898/17-11-2014
- 6) Σύμβαση 4567/2003 Υπουργείου Ανάπτυξης – Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ
- 7) Απόσπασμα της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου
- 8) Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για συντηρήσεις ιατρικών μηχανημάτων με αποσπασματική μετάφραση
- 9) Ψηφιακός Δίσκος (cd) με όλα τα δεδομένα του παρόντος



Μπάλτσας Ιωάννης

Για τη ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ
ΣΕΡ.ΚΟ Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3 - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ.: 210 7013582 - FAX: 210 7519343
ΑΦΜ: 095221353 - ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ



Στεριώτης Κων/νος

Διαχειριστές

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015

- ΠΡΟΣ :**
- **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κο ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟ
 - Τμήμα Προμηθειών
 - **1^η ΥΠΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
 Διοικητή / Κοσ Άγγελος Παπαδόπουλος
 - **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**
 ΥΠΟΨΗ: Προέδρου / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - **ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**
 - **ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /**
 Κο Λέανδρο Ρακιντζή
 - **ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ**
 Κεντρική Υπηρεσία: Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την εξέταση της παρούσας
- Θέμα : Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για το αντικείμενο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού Εξοπλισμού (Συντήρηση Μηχανημάτων Τ. Ν. (50421000-2)), Συντήρηση μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του οίκου GAMBRO»**

Κύριοι,

Κατόπιν του εγγράφου του νοσοκομείου σας αρ. πρωτ. 19763/28-09-2015 και σε εφαρμογή της 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο) απόφασης της Επιτροπής

Προμηθειών Υγείας υπ' αριθμ. πρωτ. 2889/24-07-2015 της σχετικής ανακοίνωσης, σας υποβάλουμε τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που δραστηριοποιείται και προσφέρει η εταιρεία μας για 30 και πλέον χρόνια στα Δημόσια Νοσοκομεία στην Ελλάδα, ήτοι ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO.

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO.

- 1) Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου GAMBRO της Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου.
- 2) Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο .
- 3) Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα υπό ανάθεση μηχανήματα (συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων) ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε όμοιους τύπους μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου GAMBRO.
- 4) Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) συντηρήσεις κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους (μία ανά τρίμηνο). Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο) με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.
- 5) Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν., μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

6) Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων, αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το νοσοκομείο.

7) Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

8) Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.

9) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

10) Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά κάθε μηχανήματος τεχνητού νεφρού (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

11) Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου .

12) Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου GAMBRO του Νοσοκομείου.

Η τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχανήμα τεχνητού νεφρού τον μήνα και θα περιλαμβάνει όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε περίπτωση που κάποιο μηχανήμα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως .

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, εν μέρει, περιλαμβάνονται σε πρόσφατη διακήρυξη με αριθμ. 5402/23-06-2015 (Σχετ. 1) του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», ο οποίος διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, οι προδιαγραφές της διακήρυξης αυτής συντάχθηκαν από το νοσοκομείο, μέσω δημόσιας διαβούλευσης που διενέργησε και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με το πρακτικό υπ' αριθμ. 64/14-05-2015.

Επίσης παρόμοιες προδιαγραφές περιλαμβάνονται και στις διακηρύξεις του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 2) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 3), όπως και στις δύο τελευταίες διακηρύξεις της Ν.Μ. Μεσολογγίου 2860 (Σχετ. 4) και 8834 (Σχετ. 5) στις οποίες δεν υφίστανται αδικαιολόγητα εμπόδια ανάπτυξης και λειτουργίας του ανταγωνισμού.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο) και πιο συγκεκριμένα στο στοιχείο (δ) της παραγράφου 1 αναφέρεται:

«(δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο κατά το δυνατόν γενικό, ώστε τουλάχιστον να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή.»

Ενώ λοιπόν βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και όχι ο περιορισμός του ...μέσω τεχνικών προδιαγραφών ... που ευνοούν ένα συγκεκριμένο προμηθευτή με αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων και οικονομικότερων τιμών καθώς και ποιοτικότερων υπηρεσιών, παρατηρείται το φαινόμενο σε κάποια Δημόσια Νοσοκομεία να θέτουν ακριβώς προδιαγραφές τέτοιες οι οποίες φωτογραφίζουν απόλυτα ένα συγκεκριμένο προμηθευτή, κατακρεουργώντας κάθε έννοια ανταγωνισμού και οδηγώντας τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς επί της ουσίας σε κεκαλυμμένες απ' ευθείας αναθέσεις ανεξαρτήτου ποιότητας και προσφερόμενης τιμής, ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Για τα φαινόμενα αυτά η εταιρεία μας έχει καταθέσει στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας πλήθος εγγράφων που τα καταγγέλλει.

2. Φωτογραφικές προδιαγραφές και όροι που πρέπει να αποφευχθούν.

2.1. Όρος «Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία».

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για το κάθε Νοσοκομείο. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η **ευθύνη του κατασκευαστή** να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. Τούτο, δε, οφείλει να πράττει απαρέγκλιτα ο κατασκευαστής, προκειμένου να διατίθεται νομίμως το ιατροτεχνολογικό του προϊόν (μηχάνημα) εντός της ΕΕ. Γι' αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται ή διακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE, δεικνύοντας τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη τη σήμανση CE και, συνεπώς, την εξασφάλιση ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σήμανση CE προορίζεται για την εθνική εποπτεία της αγοράς και των αρχών επιβολής του νόμου, ως ένδειξη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση λοιπόν η υποχρέωση αυτή του κατασκευαστή μηχανημάτων απέναντι στον χρήστη, να φροντίζει για την αναβάθμιση των μηχανημάτων και να παρέχει προς τούτο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί

(μέσω της τυχόν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του συγκεκριμένου όρου) σε δυνατότητα του κατασκευαστή να δίδει ή όχι τις αναγκαίες πληροφορίες.

Αλλά ούτε και θα μπορούσε ο προαναφερόμενος όρος να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί με τρόπο που θα υπέθαλπε και θα νομιμοποιούσε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζει έναντι της εταιρείας μας ο οίκος Gambro, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2012 μας έχει στερήσει παράνομα και καταχρηστικά την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Σημειωτέον ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές γι' αυτό στην Ελληνική Δικαιοσύνη και καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όπως δικαιωθήκαμε για το παράνομο αθέμιτο και αντι ανταγωνιστικό μοιχοτάξ στην προμήθεια ανταλλακτικών, που μας επέβαλαν για δύο και πλέον χρόνια, είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα δικαιωθούμε και για το θέμα της τεχνολογίας.

Πλέον τούτων, τονίζουμε με έμφαση ότι υπάρχουν Δημόσια Νοσοκομεία με οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, που αναλαμβάνουν από μόνα τους τις συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων τους και για τα οποία δεν προέκυψε ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την οποιαδήποτε αναβάθμιση, ακριβώς επειδή είναι υποχρέωση του κατασκευαστή να τις παρέχει χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προμήθειας με αριθμό 4567/2003 του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια 121 Μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro τύπου AK-95S ΚΑΙ AK-200S, σε 24 δημόσια νοσοκομεία, από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αναφέρεται στη σελίδα 10 όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικών ότι «Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχ/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για Αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα» (Σχετ. 6).

Ακολούθως, στη σελίδα 26 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ως επιλογή τεχνικής στήριξης για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και αυτόνομο *service* στα Νοσοκομεία ως συμφέρουσα λύση και εκπαίδευση των τεχνικών με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι ηλεκτρονικοί.

β. Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.

γ. Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις των και τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο.

2.2. Όρος «Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία των μηχανημάτων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους στα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας ή εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος».

2.2.1 Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλπει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί και υποθάλπει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην

ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι ευνοούν και υποθάλουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούνταν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ. 7), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσκρούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαιώσεως που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

2.2.2 Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από τα Νοσοκομεία απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του

υποψήφιου συντηρητή με τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και **σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.**

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση **υποθάλλει** πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη

επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

2.3. Όρος : *«Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των μηχανημάτων ή να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία και εμπειρία της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας για την επισκευή και συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού».*

Ο εν λόγω όρος στο βαθμό που απαιτεί την ύπαρξη εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς προϋποθέτει συμβατική σχέση μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρίας και του αναδόχου συντηρητή, κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο για τον επιδιωκόμενο νόμιμο στόχο, ήτοι για την πιστοποίηση της πραγματικής δυνατότητας του αναδόχου συντηρητή για συντήρηση και επισκευή των σχετικών ιατρικών μηχανημάτων. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση της αναδόχου εταιρίας με την κατασκευάστρια εταιρία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τον τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες

ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους. Συνακόλουθα οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή, είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από δημόσια νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- *Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.*
- *Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.*

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 1) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας , έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, αρ.πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 4) και αρ.πρωτ. 8834/21-9-2015 (Σχετ. 5) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Υπογραμμίζουμε δε, ότι, αν ελεγχθούν οι φάκελοι των συμβάσεων, όλων των ετών, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, που αφορούν την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro, πολύ εύκολα θα διαπιστωθεί ότι, πριν το 2010 κανένας όρος περί βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή τίθεντο, καθώς και καμία βεβαίωση από τον κατασκευαστή δεν διέθεταν οι σημερινοί περιούσιοι συντηρητές, που αντιπροσωπεύουν το εν λόγω ΚΑΡΤΕΛ. Τέτοιοι όροι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, και ξεκάθαρα τέθηκαν από κάποια νοσοκομεία με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΚΑΡΤΕΛ.

Γ. Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού από το 1976. Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρεία μας ήταν το μοναδικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών της Gambro στην Ελλάδα, καθώς και ο αποκλειστικός διανομέας ανταλλακτικών. Ουδέποτε όμως χρησιμοποιήσαμε ή εκμεταλλευτήκαμε την ιδιότητα μας αυτή για να μονοπωλήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αθέμιτα την Ελληνική Αγορά των επισκευών και συντηρήσεων των Μ.Τ.Ν. του οίκου Gambro. Αντιθέτως δίναμε απλόχερα σε όποιον μας ζητούσε τόσο τα ανταλλακτικά όσο και την τεχνολογία της Gambro, ως αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη εταιρεία που ήμασταν,

χωρίς να δημιουργούμε το παραμικρό εμπόδιο εισόδου και παραμονής σε κανέναν στην εν λόγω αγορά.

Η εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ (MEDICAL) έχει αποδυθεί σε απόλυτη σύμπνοια και συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο Gambro Lundia AB (GAMBRO) επί τετραετία και πλέον, σε ανηλεή εμπορικό πόλεμο κατά της εταιρείας μας με αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές, προκειμένου να πετύχει την μονοπώληση της ελληνικής αγοράς παροχής υπηρεσιών service στα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του ως άνω κατασκευαστικού οίκου, επί ζημιά του ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος. Επί των ως άνω παράνομων πρακτικών και επιδιώξεων των δύο εταιριών έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2011, η GAMBRO παράνομα και αντισυμβατικά έπαψε να μας τροφοδοτεί με ανταλλακτικά και μας παρέπεμψε στη Medical, τον νέο διανομέα της ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά. Πλην, όμως αργότερα και η Medical διέκοψε την τροφοδοσία της ΣΕΡΚΟ, την οποία όπως μας δήλωσε (προσχηματικά όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων) θα διατηρούσε μόνο για τις εκκρεμείς συμβάσεις μας. Εν συνεχεία, στις 16 Φεβρουαρίου του 2012 η GAMBRO, σε πλήρη σύμπλευση με τη MEDICAL κλιμακώνοντας τις αντιανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές τους, αιφνιδίως διέκοψε στη ΣΕΡΚΟ την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματά της προκειμένου να δυναμιτίσει την παροχή υπηρεσιών από μέρους μας.

Η εταιρεία μας προσέφυγε αμέσως στη Δικαιοσύνη, η οποία δια της υπ' αριθμ. 5667/2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απεφάνθη μεταξύ άλλων κατά το διατακτικό της:

- *ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ* ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.
- *ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ* τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα

εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Η εταιρεία μας είναι από τις λίγες εξαιρέσεις στην ελληνική αγορά της συντήρησης των Ιατρικών Μηχανημάτων που προσπαθεί να λειτουργήσει και να επιβιώσει στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού. Κάποια νοσοκομεία ενώ βλέπουν ότι στους περισσότερους διαγωνισμούς συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων δεν αναπτύσσεται καθόλου ανταγωνισμός και λειτουργεί το απόλυτο μονοπώλιο προσπαθούν, αντί να συνδράμουν στην ανάπτυξη ανταγωνισμού και στο άνοιγμα της αγοράς και σε μικρές εταιρείες όπως η εταιρεία μας, να προσφέρουν παρανόμως υπηρεσίες υπέρ της στεγανοποίησης της αγοράς, βοηθώντας και συμμετέχοντας στις εναρμονισμένες παράνομες αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές των πολυεθνικών κατασκευαστών και των βραχιόνων τους.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι σε Διαγωνισμό Δημόσιου Νοσοκομείου για την συντήρηση μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στον οποίο δεν συμμετείχαμε, λόγω του παράνομου μποϊκοτάζ προμήθειας ανταλλακτικών, που προαναφέραμε, και έχουμε ήδη δικαιωθεί, η διαφορά - ζημιά - για το Δημόσιο συμφέρον φθάνει τις 13.500 €, παραπάνω κόστος από τη μονοπωλιακή σύμβαση που υπέγραψε με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ.

Σε όλο τον κόσμο οι συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων γίνονται είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων (OEMs) είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής τεχνικών υπηρεσιών (ISOs) είτε από τεχνικό

προσωπικό των πελατών των μηχανημάτων (internal ή inhouse). (βλ. αντίστοιχες εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) (**Σχετ. 8**).

Κι ενώ σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται πολύ έντονος ανταγωνισμός στην αγορά της επισκευής και συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων καθώς και στην αγορά των ανταλλακτικών, με τεράστια οφέλη για τα νοσοκομεία και τις κλινικές, το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα Ε.Π.Ε. και της Gambro, θεωρώντας τη χώρα μας απόλυτη μπανανία επιμένει στην μονοπώληση της αγοράς στις εξωφρενικές τιμές που αυτή επιθυμεί και στην αμφίβολη ποιότητα που θέλει να επιβάλει.

Όλα τα παραπάνω τα έχουμε κοινοποιήσει και είναι εν γνώση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, καθώς και μέσω των καταγγελιών μας και Αγωγών είναι εν γνώση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Οράτε ενδεικτικά:

Στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας: Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2102, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ. 1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ.

2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3211/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3212/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3225/21-8-2015, Αρ. πρωτ. 3296/31-8-2015.

Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας: Αρ. πρωτ. 2210/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2211/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2335/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 2336/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 321/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 406/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 621/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 622/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 1009/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1010/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1011/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1207/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1208/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1209/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2259/1-9-2015.

Στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Αρ. πρωτ. 2280/22-5-2014, Αρ. πρωτ. 2344/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2345/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2427/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2624/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 2793/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 2887/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 2888/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3222/30-7-2014, Αρ. πρωτ. 3255/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 3588/4-9-2014, Αρ. πρωτ. 3938/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 3993/26-9-2014, Αρ. πρωτ. 4086/2-10-2014, Αρ. πρωτ. 4170/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4169/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4218/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 4247/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 4666/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 5401/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5402/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5403/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5404/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5405/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5406/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 658/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 659/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 842/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 1140/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1142/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1963/5-5-2015,

Αρ. πρωτ. 1964/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1965/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1966/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1967/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 2213/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2214/19-5-2012 Αρ. πρωτ. 2215/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3742/1-9-2015.

Στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης: Αρ. πρωτ. 23836/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 25335/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 26642/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 26643/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 27771/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 27772/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 3387/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 4175/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 5611/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 5613/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 9919/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9920/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9922/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9923/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9924/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 11347/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 11348/19-5-2012, Αρ. πρωτ. 11350/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 19222/1-9-2015

Προς επιπλέον απόδειξη ότι τα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία απαιτούν ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες και δεν τάσσονται υπέρ του παράνομου ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αλλά υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ απορρίπτοντας τις παράνομες πρακτικές του ΚΑΡΤΕΛ, σας παραθέτουμε λίστα με τα Δημόσια Νοσοκομεία που προσφάτως έχει συνάψει συμβάσεις η εταιρεία μας, και είμαστε στη διάθεσή σας, μόλις μας ζητηθεί, να σας προσκομίσουμε και τα πρακτικά κατακύρωσης – συμβάσεις, παρόλο που αυτά είναι δημόσια διαθέσιμα από την εφαρμογή της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ :

- 1) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- 2) Γ. Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ
- 3) Γ. Νοσοκομείο –Κ.Υ. Κω
- 4) Γ. Νοσοκομείο Φιλιατών
- 5) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
- 6) Γ. Νοσοκομείο Λευκάδας
- 7) Γ. Νοσοκομείο Καλύμνου
- 8) Γ. Νοσοκομείο Λιβαδειάς
- 9) Γ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
- 10) 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
- 11) Γ. Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
- 12) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
- 13) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ
- 14) Γ. Νοσοκομείο Χαλκίδας

- 15) Γ. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κύμης
- 16) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- 17) Γ. Νοσοκομείο Μεσολογγίου
- 18) Γ. Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
- 19) Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας
- 20) Γ. Νοσοκομείο Πύργου
- 21) Γ. Νοσοκομείο Αγρινίου
- 22) Γ. Νοσοκομείο Ρεθύμνου
- 23) Γ. Νοσοκομείο Πρέβεζας

Κατόπιν τούτων, η συμβολή των Δημόσιων Νοσοκομείων και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει να είναι καθοριστική στην αποτροπή εγκαθίδρυσης παράνομων μονοπωλιακών καταστάσεων στις προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων, με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη του Δημόσιου Συμφέροντος μέσω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνονται απλοί παρατηρητές και ακόμη περισσότερο συμμετέχοντες στο «τεράστιο πάρτυ» των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ .

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των παραπάνω σας παραθέτουμε αυτούσιες τις παρατηρήσεις τις εταιρείας μας, από τη συμμετοχή της σε 2 πρόσφατες Δημόσιες Διαβουλεύσεις Τεχνικών προδιαγραφών.

1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

(αριθμ. πρωτ. ΕΠΥ : 3211/20-8-2015)

«Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015

- ΠΡΟΣ:
- 4^η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 - Διοικητή
 - Γραφείο Προμηθειών / Κα Βακαλίδου
 - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 - Αναπλ. Διοικητή Νοσοκομείου / Κο Νικόλαο Φαρμάκη
 - Γραφείο Προμηθειών / Κα Αφροδίτη Μιχαηλίδου
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΗ: Προέδρον / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /
Κο Λέανδρο Ρακιντζή
 - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 - Κεντρική Υπηρεσία: Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα
 - Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης: Αγίας Σοφίας 46,
54622 Θεσσαλονίκη / Υπόψη Κού Σαβαΐδη Γεωργίου
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την
εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για την πρώτη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ακριβείας» (cpn 5042100-2) – Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών Ε. Για τη συντήρηση Εννέα (9) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά και χωρίς αναλώσιμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.050 € με ΦΠΑ,

Α. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει

να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

«Ε) Για τη συντήρηση Εννέα (9) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά και χωρίς αναλώσιμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.050 € με ΦΠΑ.»

1. Όρος « Να κατατεθεί βεβαίωση της Κατασκευάστριας Εταιρείας ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα.

Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από το Νοσοκομείο απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλπει πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ως άνω όρος περί προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο δεν υπήρχε, με αυτή τη μορφή, σε παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Ειδικότερα, στην τελευταία διακήρυξη με αριθμ. 94/2014 αναγραφόταν ότι:

«Να καταθέσει βεβαίωση της Κατασκευάστριας Εταιρείας ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα ή σε άλλα ανάλογα μηχανήματα της ίδιας Εταιρείας»
δινόταν έτσι η δυνατότητα στην εταιρεία μας να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και να εγκριθεί η τεχνική μας προσφορά από την επιτροπή του διαγωνισμού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, παρόλη την έλλειψη πιστοποιητικών εκπαίδευσης για τα μηχανήματα AK-200 ULTRA, αφού καταθέσαμε πιστοποιητικά εκπαίδευσης παρόμοιων μηχανημάτων του ίδιου οίκου κατασκευής (AK-200S), πετυχαίνοντας έτσι το νοσοκομείο για πρώτη φορά ανάπτυξη ανταγωνισμού και συμμετοχή μεγαλύτερη του ενός συντηρητή, πέραν αυτή του επί πολλών ετών μονοπωλιακού και κεκαλυμμένου απευθείας αναδόχου.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από άλλα νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με

τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ.

1) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας , έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε ο ως άνω όρος των τεχνικών προδιαγραφών να διαμορφωθεί ανάλογα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον εκάστοτε ανάδοχο συντηρητή να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια μέσω σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να μην εξαρτάται η απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον κατασκευαστή.

Η εταιρεία μας παρά την έλλειψη των πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή οίκο, δραστηριοποιείται επιτυχώς στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού στην Ελλάδα από το 1976, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών αλλά και πολύ πιο οικονομικότερων για το συμφέρον των νοσοκομείων και για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ εν γένει, Τιμών . Οράτε Σχετ. 2 Σύμβαση υπ' αριθμ. 8992/23-04-15, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (20 μηχανήματα τύπου AK-200S και 9 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 158 € το μηχανήμα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήμα το μήνα που πλήρωνε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ

Ομοίως οράτε Σχετ. 3 Σύμβαση υπ' αριθμ. πρωτ. 8748, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ, Κύμης με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (5 μηχανήματα τύπου AK-200S και 2 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 169,98 € το μηχανήμα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήμα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Ομοίως οράτε Σχετ. 4 Σύμβαση υπ' αριθμ. 1/1-8/2014, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιππών με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (10 μηχανήματα τύπου AK-200S και 1 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 172 € το μηχανήματα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήματα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Επίσης οράτε Σχετ. 5 Σύμβαση υπ' αριθμ. 9075, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (7 μηχανήματα τύπου AK-200S και 4 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τελική τιμή των 160,00 € το μηχανήματα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήματα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Στην τελευταία διακήρυξη του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με αριθμ. 94/2014 , στον εν λόγω όρο υπήρχε η φράση : ή σε άλλα ανάλογα μηχανήματα της ίδιας Εταιρείας , δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μεγαλύτερης του ενός συντηρητή συμμετοχής και της πραγματικής ανάπτυξης ανταγωνισμού . Στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και από τον συγκεκριμένο όρο αφαιρέθηκε αυτή η φράση . Ευλόγως , κάθε νοήμων άνθρωπος , θα απορούσε για την σκοπιμότητα της αλλαγής αυτού του όρου :

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει ευρεία συμμετοχή και ανάπτυξη ανταγωνισμού στη συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO ;

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει ποιοτικότερες υπηρεσίες συντήρησης ;

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει οικονομικότερες τιμές και εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ ;

Η μήπως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο , με πρόσχημα δήθεν την εξασφάλιση της τεχνικής επάρκειας του συντηρητή , θέλει με πάση θυσία την διατήρηση της

πολύχρονης παράνομης μονοπωλιακής συνεργασίας, με τον περιούσιο συντηρητή , ανεξαρτήτου ποιότητας και κόστους ;

Υπογραμμίζοντας δε ότι, αν ελεγχθούν οι φάκελοι των συμβάσεων , όλων των ετών συνεργασίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με τον επί πολλά χρόνια περιούσιο συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. , πολύ εύκολα θα διαπιστωθεί ότι , πριν το 2010 κανένας όρος περί βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή τίθεντο, καθώς και καμία βεβαίωση από τον κατασκευαστή δεν διέθετε ο εν λόγω περιούσιος συντηρητής.

2.Όρος «Να καταθέσει βεβαίωση από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών, που θα φέρουν πιστοποίηση CE, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης»

Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί

και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι εννοούν και υποθάλλουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούνταν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ. 6), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε

ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रοεί στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαιώσεως που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

Γ. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι οι όροι που τίθενται στο κείμενο της διαβουλεύσεως διαψεύδουν την υποτιθέμενη πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και καταλήγει σε κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση με το πρόσχημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε όλως ενδεικτικώς τις διακηρύξεις των Δημόσιων Νοσοκομείων, του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχέτ. 7) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχέτ. 8), του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Σχέτ. 1) στις οποίες δεν υφίστανται τα αδικαιολόγητα εμπόδια που το Νοσοκομείο σας ορθώνει στον ανταγωνισμό.

Τα προς χάριν παραδείγματος προαναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία, όχι μόνο διαμόρφωσαν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ήδη δρέπουν τους καρπούς των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών τους (συμμετείχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με εξοικονόμηση δαπανών για τα Νοσοκομεία).

Τα Νοσοκομεία που θέλησαν πραγματικά και όχι προσχηματικά να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής συντηρητών πέτυχαν και απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε πολύ οικονομικότερες τιμές :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

A/A	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ- Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ	158,00 €	29 Μ.Τ.Ν.	20 MTN AK-200S & 9 MTN AK-200 ULTRA S
2.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	172,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S & 1 AK-200 ULTRA S
3.	ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ	165,00 €	2 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S
4.	Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	165,00 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S, 2 MTN AK-200 2 MTN AK-95S
5.	Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	170,00 €	11 Μ.Τ.Ν	4 MTN AK-200S, 6 MTN AK-200 & 1 MTN AK-95

6.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ	195,00 €	10 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S
7.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	178,95 €	7 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S
8.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	160,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S & 4 AK-200 ULTRA S
9.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	162,50 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-95, 3 MTN AK-95S & 1 MTN AK-200S
10.	Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ	189,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	6 MTN AK-200, 2 MTN AK-95 & 1 MTN AK-200S
11.	Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	166,67 €	13 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95, 1 MTN AK-200, & 8 MTN AK-200S
12.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	176,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	1 MTN AK-10, 1 MTN AK- 100, 2 MTN AK-200, 4 MTN AK-200S & 1 MTN AK-200SU
13.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – Κ.Υ. ΑΗΜΝΟΥ	177,78 €	7 Μ.Τ.Ν.	3 MTN AK-10, 1 MTN AK-95 & 3 MTN AK-200S
14.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	160,00 €	4 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95S

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

[...]

Τέλος, εφόσον η παρούσα διαβούλευση δεν είναι προσχηματική και υπάρχει πραγματική βούληση – πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και της μέγιστης δυνατής ανάπτυξης ανταγωνισμού,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας και να διαμορφώσετε ανάλογα τους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας έτσι, για πρώτη φορά:

- το σταμάτημα των ασύμφορων μονοπωλιακών συνεργασιών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

[...] »

2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(αριθμ. πρωτ. ΕΠΥ : 3212/20-8-2015)

«Αθήνα, 06 Ιουλίου 2015

- ΠΡΟΣ:**
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ &
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κος Γεώργιος Βλάχος
 - Τμήμα Οικονομικού /
Κα Δέσποινα Λαυρέντζου – Κα Ρ. Φραγκιαδουλάκη
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Πρόεδρον / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για την δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro, σύμφωνα με την πρόσκληση υπ' αριθμ. 9020/30-6-2015

Α. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές Ν.Μ. Αγγρινίου(των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO) – Ν.Μ. Μεσολογγίου

1. Όρος «Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία».

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για το κάθε Νοσοκομείο. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η **ευθύνη του κατασκευαστή** να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. Τούτο, δε, οφείλει να πράττει **απαρέγκλιτα ο κατασκευαστής**, προκειμένου να διατίθεται νομίμως το ιατροτεχνολογικό του προϊόν (μηχάνημα) εντός της ΕΕ. Γι' αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται ή διακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE, δεικνύοντας τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη τη σήμανση CE και, συνεπώς, την εξασφάλιση ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σήμανση CE προορίζεται για την εθνική εποπτεία της αγοράς και των αρχών επιβολής του νόμου, ως ένδειξη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση λοιπόν η υποχρέωση αυτή του κατασκευαστή μηχανημάτων απέναντι στον χρήστη, να φροντίζει για την αναβάθμιση των μηχανημάτων και να παρέχει προς τούτο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί

(μέσω της τυχόν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του συγκεκριμένου όρου) σε δυνατότητα του κατασκευαστή να δίδει ή όχι τις αναγκαίες πληροφορίες.

Αλλά ούτε και θα μπορούσε ο προαναφερόμενος όρος να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί με τρόπο που θα υπέθαλπε και θα νομιμοποιούσε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζει έναντι της εταιρείας μας ο οίκος Gambro, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2012 μας έχει στερήσει παράνομα και καταχρηστικά την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Σημειωτέον ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές γι' αυτό στην Ελληνική Δικαιοσύνη και καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όπως δικαιωθήκαμε για το παράνομο αθέμιτο και αντι ανταγωνιστικό μποϊκοτάζ στην προμήθεια ανταλλακτικών, που μας επέβαλαν για δύο και πλέον χρόνια, είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα δικαιωθούμε και για το θέμα της τεχνολογίας.

Πλέον τούτων, τονίζουμε με έμφαση ότι υπάρχουν Δημόσια Νοσοκομεία με οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, που αναλαμβάνουν από μόνα τους τις συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων τους και για τα οποία δεν προέκυψε ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την οποιαδήποτε αναβάθμιση, ακριβώς επειδή είναι υποχρέωση του κατασκευαστή να τις παρέχει χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προμήθειας με αριθμό 4567/2003 του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια 121 Μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro τύπου AK-95S ΚΑΙ AK-200S, σε 24 δημόσια νοσοκομεία, από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αναφέρεται στη σελίδα 10 όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικών ότι «Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχ/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για Αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα» (Σχετ. 1).

Ακολούθως, στη σελίδα 26 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ως επιλογή τεχνικής στήριξης για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και αυτόνομο service στα Νοσοκομεία ως συμφέρουσα λύση και εκπαίδευση των τεχνικών με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι ηλεκτρονικοί.

β. Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.

γ. Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις των και τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο.

2. Όρος (Ετήσιας συντήρησης των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO της N.M. Αγγρινίου(σελίδα 25) – τεχνικές προδιαγραφές N.M. Μεσολογγίου (α/α:12 σελίδα 28)) «Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία των μηχανημάτων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους στα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας ή εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος».

2.1 Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και εννοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός εννοεί και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό

αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι ενοούν και υποθάλλουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούνταν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ.2), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαιώσεως που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

2.2 Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από το Νοσοκομείο απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον

κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλπει πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζουμε στο Νοσοκομείο ότι οι ως άνω όροι περί πιστοποιητικού συνεργασίας με τον κατασκευαστικό οίκο για την προμήθεια ανταλλακτικών, καθώς και περί προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο δεν υπήρχαν σε παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών των νοσοκομείων σας. Ειδικότερα, στην πρόσκληση με αριθμ. Πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 3) της Ν.Μ. Μεσολογγίου αναγραφόταν ότι:

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη μονάδα τεχνητού νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς.

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Όμοιους όρους είχε και η προγενέστερη πρόσκληση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου με αρ. πρωτ. 11898/17-11-2014. (Σχετ. 4).

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές στη Ν.Μ. Μεσολογγίου

3. Όρος : «Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των μηχανημάτων ή να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία και εμπειρία της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας για την επισκευή και συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού».

Ο εν λόγω όρος στο βαθμό που απαιτεί την ύπαρξη εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς προϋποθέτει συμβατική σχέση μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρίας και του αναδόχου συντηρητή, κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο για τον επιδιωκόμενο νόμιμο στόχο, ήτοι για την πιστοποίηση της πραγματικής δυνατότητας του αναδόχου συντηρητή για συντήρηση και επισκευή των σχετικών ιατρικών μηχανημάτων. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση της αναδόχου εταιρίας με την κατασκευάστρια εταιρία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει

εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τον τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους. Συνακόλουθα οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή, είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από άλλα νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 5) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα ΑΚ 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης ΑΚ 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας

Μεσολογγίου, αρ.πρωτ. 11898/17-11-2014 (Σχετ. 3) και αρ.πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 4) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε ο ως άνω όρος των τεχνικών προδιαγραφών να διαμορφωθεί ανάλογα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον εκάστοτε ανάδοχο συντηρητή να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια μέσω σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να μην εξαρτάται η απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον κατασκευαστή.

Θεωρούμε ότι ουδέν έχει να προσφέρει ο εν λόγω όρος, καθώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις καλύπτονται πλήρως από τους έτερους όρους σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να προσκομίζεται:

«Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας συντήρησης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ. /1348/2004 σχετικά με την ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

«Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 ή ISO 13485 για τη Διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ εξοπλισμού».

«Να κατατεθούν σχετικές βεβαιώσεις καλής συνεργασίας και εκτέλεσης των συμβάσεων συντήρησης με αντίστοιχα ιδρύματα».

Συνεπώς προτείνουμε την πλήρη απόλεια του εν λόγω όρου από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Γ. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι οι όροι που τίθενται στο κείμενο της διαβουλεύσεως διαψεύδουν την υποτιθέμενη πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και καταλήγει σε κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση με το πρόσχημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε όλως ενδεικτικώς τις διακηρύξεις δύο Δημόσιων Νοσοκομείων, του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 6) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 7), καθώς και του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Σχετ. 5), όπως και τις δύο τελευταίες διακηρύξεις της Ν.Μ. Μεσολογγίου 2860 (Σχετ. 3) και 11898 (Σχετ. 4) στις οποίες δεν υφίστανται τα αδικαιολόγητα εμπόδια που το Νοσοκομείο σας ορθώνει στον ανταγωνισμό.

Τα προς χάριν παραδείγματος προαναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία, όχι μόνο διαμόρφωσαν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ήδη δρέπουν τους καρπούς των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών τους (συμμετείχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με εξοικονόμηση δαπανών για τα Νοσοκομεία). Σας επισυνάπτουμε το πρακτικό του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 8) όπου έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Ομοίως τους καρπούς της ανάπτυξης του ανταγωνισμού έδρεψε το Νοσοκομείο σας σε όλες τις προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες κερδίζοντας οικονομικότερες αλλά και ποιοτικότερες υπηρεσίες, οράτε ενδεικτικά το διαγωνισμό του Νοσοκομείου

Αγρινίου με την υπ' αριθμό 17200/31-10-2014 & ΑΔΑ 756Π46904Μ-ΨΒ6 ανάρτηση του Νοσοκομείου σας, για την Τρίμηνη Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης Gambro για το χρονικό διάστημα τριών μηνών, στον οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας υποβάλλοντας την προσφορά της, καθώς και η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ. Η προσφορά της εταιρείας μας (ΣΕΡ.ΚΟ) ανερχόταν στα 2.898,00 € χωρίς ΦΠΑ και η προσφορά της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ανερχόταν στο ποσό των 3.699,00 € χωρίς ΦΠΑ δηλαδή διαφορά – όφελος για το Νοσοκομείο από την ανάπτυξη ανταγωνισμού: 801,00 € για τους τρεις μήνες και 3204,00 € αναγόμενο σε ετήσια βάση.

Και αντίστοιχα το διαγωνισμό της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11898/17-11-2014 και ΑΔΑ: ΨΨΑΑ46907Π-ΥΕΔ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, για την επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού για το χρονικό διάστημα δύο μηνών, στον οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας υποβάλλοντας την προσφορά της, καθώς και η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ. Η προσφορά της εταιρείας μας (ΣΕΡ.ΚΟ) ανερχόταν στα 1.638,00 € χωρίς ΦΠΑ και η προσφορά της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ανερχόταν στο ποσό των 2.160,00 € χωρίς ΦΠΑ δηλαδή διαφορά – όφελος για το Νοσοκομείο από την ανάπτυξη ανταγωνισμού: 522,00 € για τους δύο μήνες και 3.132,00 € αναγόμενο σε ετήσια βάση.

Το Νοσοκομείο σας γνωρίζει άριστα τις πολύ ποιοτικές και οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες που προσφέρει όλα τα χρόνια η εταιρεία μας ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ από την πολυετή συνεργασία του μαζί μας από το 1986 μέχρι και σήμερα .

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

[...]»

Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (ΘΕΜΑ 1^ο) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

Ε1. ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ

Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε κάποιος καλόπιστα να δεχθεί ότι η παραπάνω απόφαση (65/17-07-2015/21-07-2015 θέμα 1^ο) στοχεύει στο να σταματήσουν οι τεχνικές προδιαγραφές να αποτελούν «εμπορεύσιμο προϊόν» από τους αρμόδιους των νοσοκομείων, δηλαδή να πάψουν οι τεχνικές προδιαγραφές να είναι «προϊόν συναλλαγής» μεταξύ των αρμοδίων των Νοσοκομείων και των περιούσιων συντηρητών – προμηθευτών.

Με μια δεύτερη ματιά όμως, διαψεύδεται αμέσως η υποτιθέμενη ως άνω πρόθεση της ΕΠΥ, από τη στιγμή που οι αρμόδιοι των Νοσοκομείων συνεχίζουν να έχουν όλη την ευχέρεια να δέχονται όποιες τεχνικές προδιαγραφές (από αυτές που καταθέτουν οι προμηθευτές με βάση την απόφαση της ΕΠΥ) αυτοί θέλουν. Έτσι αποτέλεσμα της απόφασης της ΕΠΥ είναι να καταλήγει να αποτελεί απλώς την αποενοχοποίηση και κοινώς το «συχωροχάρτι» των αρμοδίων εκείνων των Νοσοκομείων που πιθανόν εμπορεύονταν και πιθανόν θα συνεχίσουν να εμπορεύονται τις τεχνικές προδιαγραφές. Διότι τώρα θα υπάρχει άλλοθι.

«ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ»

Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν τέθηκαν από κανέναν αρμόδιο του Νοσοκομείου (έναντι πιθανής αμοιβής από κάποιους περιούσιους συντηρητές) αλλά τέθηκαν από τους ίδιους τους περιούσιους συντηρητές – προμηθευτές βάσει της απόφασης της ΕΠΥ. Και επειδή όμως παραμένει στην ευχέρεια των αρμοδίων, θα δέχονται μόνο τις προδιαγραφές των περιούσιων συντηρητών – προμηθευτών και κανενός άλλου τυχάρπαστου τίμιου και ρομαντικού συντηρητή – προμηθευτή ο οποίος δρα και προσπαθεί να επιβιώσει νόμιμα πέρα και μακριά από τις παράνομες μεν αλλά προσοδοφόρες δε πρακτικές των ΚΑΡΤΕΛ και των ΑΠΙΣΤΩΝ αρμοδίων υπαλλήλων των Νοσοκομείων.

Ε.2 Το Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

2.1 Το Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. με την Διακήρυξη 05/2012 και αριθμ. πρωτ. 589/9-3-2012 προκήρυξε τον τελευταίο διαγωνισμό για τη συντήρηση των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro.

Οι προδιαγραφές στη διακήρυξη αυτή είχαν ως εξής:

«Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘ

- 1. Η συντήρηση αφορά τα (5) μηχανήματα CAMBRO AK 90-S και τα (3) μηχανήματα CAMBRO AK 10 και AK 200 του τεχνητού νεφρού και της ΜΕΘ*
- 2. Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί (4) συντηρήσεις ετησίως (μία ανά τρίμηνο) με ανάλογες και διαφορετικές ρυθμίσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων, αν αυτό απαιτείται.*
- 3. Ο συντηρητής υποχρεούται να καλύπτει πλήρως έκτακτες βλάβες στα μηχανήματα τεχνητού Νεφρού και ΜΕΘ, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών, μετά*

από τηλεφωνική κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θα κρατείται δε από την Μονάδα τεχνητού νεφρού εφεδρικό νεφρολογικό μηχάνημα και σε ποσοστά που ορίζει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για να αντιμετωπίζεται βλάβη διαρκείας είτε εντός του Νοσοκομείου είτε στο εργαστήριο του συντηρητή.

4. Η αξία των ανταλλακτικών που θα αντικαθίστανται κατά την διάρκεια των επισκευών ή συντηρήσεων θα βαρύνουν τον συντηρητή.

5. Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται βλάβες που προκύπτουν, από αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή τρίτους, από χρήση ακατάλληλων υλικών αποστείρωσης, καθαρισμό απασβέστωσης ή ελλιπή χρήση απασβέστωσης ή καθαρισμού πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου, από κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου, από κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περ/δων του Νοσοκομείου ή της Δ.Ε.Η., από εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους, από ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός, θύελλες, πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά) και από κτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτους. (Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται μετά από αναφορά του συντηρητή και επιβεβαίωση από την Βιοϊατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου).

6. Ο συντηρητής επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποκαταστήσει κάποια βλάβη επί τόπου στο Νοσοκομείο και χρειαστεί να μεταφέρει το προς επισκευή μηχάνημα στην εταιρεία του και κατόπιν πίσω στο Νοσοκομείο.

7. Η τιμή θα δοθεί ως μηνιαία δαπάνη ανά μηχάνημα. (Σημειώνεται ότι εάν κάποιο από τα μηχανήματα τεθεί εκτός οριστικής λειτουργίας, θα σταματάει αυτόματα η συντήρηση και η αντίστοιχη χρέωση αμοιβής). Τα ανταλλακτικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν θα συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω δαπάνη» (σελ. 41 – 42 Διακήρυξης).

Η εταιρεία μας δεν συμμετείχε σ' αυτόν τον διαγωνισμό λόγω του παράνομου μποϊκοτάζ ανταλλακτικών που βιώναμε τότε. Καθώς η δικαίωση μας από την Ελληνική Δικαιοσύνη ήρθε πολύ αργότερα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5667/2013.

Έτσι το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, πέτυχε την παράνομη μονοπώληση της συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο σας και σύναψε

τη σύμβαση με αριθμ. 05/2012 και αρ. πρωτ. 31471/12-4-2013 με συνολική ετήσια τιμή 15.480,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για 6 μηχανήματα Gambro. Δηλαδή τιμή 215,00€ ανά μηχανήμα ανά μήνα.

Η σύμβαση αυτή μέσω παρατάσεων είναι ενεργή μέχρι σήμερα, στις ίδιες ακριβώς τιμές (215,00 € το μηχανήμα το μήνα).

Όταν η ανάπτυξη του ανταγωνισμού από την συμμετοχή της εταιρείας μας στους διαγωνισμούς της συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro έχει φέρει τεράστια οφέλη στα νοσοκομεία της χώρας τα οποία καρπώνονται πολύ χαμηλότερες τιμές.

Ενδεικτικά σας κοινοποιούμε συμβάσεις συντήρησης που έχει συνάψει πρόσφατα η εταιρεία μας με Δημόσια Νοσοκομεία Αθηνών, τα οποία ακολούθησαν τη Νόμιμη οδό ανάπτυξης ανταγωνισμού μακριά από την υποστήριξη του εν λόγω ΚΑΡΤΕΛ κερδίζοντας τόσο ποιοτικότερες, όσο και οικονομικότερες τιμές:

1. Ετήσια σύμβαση της 15/4/2015 με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με μέση τιμή 176,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι 215,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας (**Σχετ. 10**).
2. Ετήσια σύμβαση της 09/04/2015 με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με μέση τιμή 162,50 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι 215,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας (**Σχετ. 11**).
3. Ετήσια σύμβαση της 29/12/2014 με το ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με τιμή 165,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι 215,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας (**Σχετ. 12**).
4. Ετήσια σύμβαση της 27/02/2015 με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ, ΑΦΟΡΑ Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ με τιμή 168,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι 215,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας (**Σχετ. 13**).
5. Ετήσια σύμβαση της 30/01/2015 με το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ με μέση τιμή 166,67 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι

215,00 € ανά μηχάνημα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας(Σχετ. 14).

6. Τρίμηνη σύμβαση της 02/10/2015 με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ με μέση τιμή 158,98 € ανά μηχάνημα ανά μήνα και όχι 215,00 € ανά μηχάνημα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας (Σχετ. 15).

2.2 Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού του 2012, διακήρυξη 05/2012, όπως τις αναφέραμε και ανωτέρω, ήταν απόλυτα αποδεκτές από το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, διότι μέσω του παράνομου μποϋκοτάζ ανταλλακτικών που είχαν επιβάλει στην εταιρεία μας είχαν εξασφαλισμένη την παράνομη μονοπωλιακή τους δράση.

Μετά όμως την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5667/2013 αναπροσαρμόζουν τις παράνομες πρακτικές τους και προσπαθούν να επιβάλουν στα νοσοκομεία όρους που θα τους εξασφαλίσουν την συνέχιση της παράνομης μονοπωλιακής τους δράσης.

Τελευταία μάλιστα φθάνουν στο σημείο να απαιτούν παράνομα από τα νοσοκομεία να μην κάνουν καν Διαγωνισμούς και να χαρίζουν τις συντηρήσεις στο ΚΑΡΤΕΛ τους με απευθείας αναθέσεις ανεξαρτήτως τιμής και ποιότητας των υπηρεσιών τους(!!!).

3. Μικρές αλήθειες μεγάλα συμπεράσματα:

Προς αντίκρουση κάθε δύσπιστου αρμόδιου παραθέτουμε και τα ακόλουθα σχετικά με την «εξουσιοδότηση» και γενικότερα τις βεβαιώσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία:

3.1 **Ιδού τι δήλωνε μέχρι το 2014 η κατασκευάστρια εταιρεία Gambro Lundia AB στα Ελληνικά Δικαστήρια, όπου η εταιρεία μας κατέφυγε για τη δικαίωση της:**

Στις 13/2/2012 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών:

«25.3 Ο μάρτυς της αιτούσας κατέθεσε ότι και μετά την καταγγελία της σύμβασης υπερβολαβίας της με την 2^η καθ' ης, η αιτούσα εξακολούθησε να μετέχει σε διαγωνισμούς Νοσοκομείων για τη συντήρηση και συνήψε πράγματι, όπως λέει, νέες τέτοιες συμβάσεις, που σημαίνει ότι και ανταλλακτικά έχει και βεβαιώσεις από εμάς δεν χρειάζεται αφού την επάρκειά της την γνωρίζουν ήδη τα Νοσοκομεία.»

Στις 19/8/2011 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών :

«Με αυτό το δεδομένο, η αιτούσα είχε (και έχει) απόλυτη ελευθερία να συντηρεί εκτός από τα προϊόντα της GAMBRO και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ακόμα και ανταγωνιστικά».

Ιδού τι αναφέρουν τα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια χρήσης της ίδιας της κατασκευάστριας εταιρείας Gambro Lundia AB:

«Εξουσιοδοτημένος Τεχνικός

Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός είναι ένας τεχνικός που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης AK 96 από τη Gambro και διαθέτει πιστοποίηση από τη Gambro ή έχει αποκτήσει ισάξια εμπειρία με παρόμοιο τρόπο.

(ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο χειριστή Gambro για το μηχάνημα AK 96, Σχετ. 16).

Για τον εκπαιδευόμενο τεχνικό διατίθεται το Εγχειρίδιο Σέρβις AK 200. Το Εγχειρίδιο Σέρβις παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή και απαιτούμενη συντήρηση του μηχανήματος.

Οι προληπτικές επιθεωρήσεις, συντήρηση και βαθμονόμηση του AK 200 θα γίνονται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Σέρβις του AK 200, το Εγχειρίδιο Συντήρησης HCEN9164 τα οποία μπορούν να παραγγελθούν από τον αντιπρόσωπό σας της Gambro. Η περιοδική συντήρηση πρέπει να γίνεται μετά από 2500 ώρες λειτουργίας ή τουλάχιστον ανά έτος. (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200 op.man. HCEL9761.Rev.12.1999 program verison 4.xx σελ. 1:3 και 1:4, Σχετ. 17).

Για τον έμπειρο τεχνικό, υπάρχει διαθέσιμο το Εγχειρίδιο Επισκευής του μηχανήματος αιμοδιάλυσης AK 200 S. Το Εγχειρίδιο Επισκευής παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και την ασφαλή και απαιτούμενη συντήρηση του μηχανήματος. (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο λειτουργίας (χειριστή) μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200S HCEL9882 Αναθεώρηση 04.2010. Έκδοση προγράμματος 10.xx σελ. 1:7 και 1:8, Σχετ. 18).

Επάρκεια Μηχανικών Service

Υπάρχει ένα ορισμένο ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για τους Μηχανικούς service που συντηρούν και επισκευάζουν προϊόντα Gambro, και συνοψίζεται ως εξής.

Ένας μηχανικός συντήρησης θεωρείται κατάλληλα ειδικευμένος, αν αυτός / αυτή έχει:

1. Παρακολουθήσει τεχνικό σεμινάριο για AK 200 S / AK 200 ULTRA S και του έχει δοθεί ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο τεχνικός έχει περάσει το μάθημα.
2. Πρόσβαση στο συνιστώμενο εξοπλισμό δοκιμών και τα ειδικά εργαλεία που αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο service.
3. Πρόσβαση στα συνιστώμενα ανταλλακτικά, ανατρέξτε στο AK 200S / AK 200 ULTRA S – Spare Parts List, HCEN 9288.
4. Πρόσβαση και κατανόηση στο εγχειρίδιο Χρήσης AK 200 S / AK 200 ULTRA S- (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο συντήρησης HCEN12395 Revision 02.2010 program version 10.xx σελ. 1:5, νομίμως μεταφρασμένη (Σχετ. 19).

Η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία έχοντας πλήρη επίγνωση των θεμάτων, δεν παίρνει κανένα ρίσκο και προσέχει πολύ σχετικά με τα ποινικώς κολάσιμα αδικήματα, αφού ούτως ή άλλως, υπάρχουν υποψήφιοι «αρμόδιοι» των Νοσοκομείων που μπορούν να «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά», θέτοντας παράνομους όρους στους διαγωνισμούς κι έτσι δεν χρειάζεται να παρανομήσει η ίδια.

4. Κατακλείδα

Ενώ τα Νοσοκομεία που θέλησαν πραγματικά και όχι προσχηματικά να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής συντηρητών, διαμορφώνοντας διαφανείς και χωρίς διακρίσεις, τεχνικές προδιαγραφές με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον, πέτυχαν και απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε πολύ οικονομικότερες τιμές :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

A/A	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ– Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ	158,00 €	29 Μ.Τ.Ν.	20 MTN AK-200S & 9 MTN AK-200 ULTRA S
2.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	172,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S & 1 AK-200 ULTRA S
3.	ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ	165,00 €	2 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S

4.	Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	165,00 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S, 2 MTN AK-200 2 MTN AK-95S
5.	Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	170,00 €	11 Μ.Τ.Ν	4 MTN AK-200S, 6 MTN AK-200 & 1 MTN AK-95
6.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ	195,00 €	10 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S
7.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	178,95 €	7 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S
8.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	160,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S & 4 AK-200 ULTRA S
9.	Γ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	162,50 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-95, 3 MTN AK-95S & 1 MTN AK-200S
10.	Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ	189,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	6 MTN AK-200, 2 MTN AK-95 & 1 MTN AK-200S
11.	Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	166,67 €	13 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95, 1 MTN AK-200, & 8 MTN AK-200S
12.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	176,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	1 MTN AK-10, 1 MTN AK- 100, 2 MTN AK-200, 4 MTN AK-200S & 1 MTN AK-200SU
13.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ	177,78 €	7 Μ.Τ.Ν.	3 MTN AK-10, 1 MTN AK-95 & 3 MTN AK-200S
14.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	160,00 €	4 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95S
15.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ	168,00 €	4 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-200S-
16.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ	158,98 €	11 Μ.Τ.Ν.	1 MTN AK-200 ULTRA, 6 MTN AK-200, 3 MTN AK-200S & 1 MTN AK-95
17.	251 Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	166,67 €	6 Μ.Τ.Ν.	5 MTN AK-200 & 1 MTN AK-90S

«ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ» του Νοσοκομείου Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.:

- Θα προτιμήσουν να συντηρεί τα μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού Gambro μόνο ο περιούσιος συντηρητής σε τιμή 215,00 € το μηχάνημα το μήνα και όχι με 165,00 € περίπου το μηχάνημα το μήνα που προσφέρει η ΣΕΡ.ΚΟ;
- Θα προτιμήσουν να πετούν πολλές χιλιάδες ευρώ, τα χρήματα του ελληνικού λαού, ωσάν το Νοσοκομείο Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.: να είναι τσιφλίκι τους, προκειμένου να συνεχίσει να κερδοσκοπεί παράνομα το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ;

Επειδή η εταιρεία μας, όπως έχει διαπιστώσει και υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βιώνει τις σκληρές πρακτικές ενός αδίστακτου καρτέλ που επιδιώκει τη μονοπώληση των δημόσιων διαγωνισμών επί μεγίστη βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.

Επειδή οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες των υπό ανάθεση συμβάσεων και πρέπει να δρουν υπέρ του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες με περισσότερο από 30% χαμηλότερες τιμές.

Επειδή οι δημόσιες συμβάσεις και οι σχετικοί διαγωνισμοί απαγορεύεται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία να αποτελούν απευθείας ανάθεση, αλλά αντιθέτως πρέπει να σέβονται κατά τις διεξαγόμενες διαδικασίες τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

Επειδή τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι τσιφλίκι κανενός, δεν πρέπει να πετούν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού προκειμένου να υποστηρίξουν το ΚΑΡΤΕΛ της Medical, της Τεχνοϊατρική και της Gambro.

Επειδή, για να γίνει περισσότερο αντιληπτό, το μέγεθος του πλιάτσικου από το συγκεκριμένο ΚΑΡΤΕΛ, σας γνωστοποιούμε ενδεικτικά πόσο πωλούνται αντίστοιχα, σε άλλες χώρες, τα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO:

K40280001 AC/DC UNIT AK200S:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 350,00€ ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 2.069,65 €.

K11845A Level Transducer:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 36,00 € ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 246,72 €.

K40228003 Pressure transducer kit compl.:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 112,00 € ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 715,48 €.

Ανταλλακτικό που άλλες χώρες το αγοράζουν 112 € στην Ελλάδα πουλιέται από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ 715,48 €. Το ίδιο πράττει η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και με τις τιμές των αναλωσίμων τεχνητού νεφρού,

Έτσι το Φίλτρο Τεχνητού Νεφρού που το κόστος του δεν υπερβαίνει το 1 € και άλλες χώρες το αγοράζουν 6 - 8 € στην Ελλάδα σήμερα πουλιέται 28 € και παλιότερα 50 €.

Με βάση δημοσιεύματα στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο της περιόδου Ιουλίου 2014 σχετικά με έρευνα του εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Κου Δημόπουλου :

«Σύμφωνα με την καταγγελία, τα φίλτρα αιμοκάθαρσης στα ελληνικά νοσοκομεία πωλούνται σε τιμές που κυμαίνονται από 23 έως 30 ευρώ, όταν την περίοδο αυτή στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπερβαίνουν τα 15 ευρώ. Παλιότερα δε, οι τιμές τους είχαν εκτοξευτεί στα 50 ευρώ το ένα, παρότι το κόστος παρασκευής των υλικών αυτών υπολογίζεται ότι μετά βίας να ξεπερνούσε το 1 ευρώ!!

Ο κ. Εισαγγελέας, ζητά να εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της απιστίας σε βάρος του δημοσίου από την πλευρά των ιδρυμάτων, αλλά και τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και το ενδεχόμενο να έχει τελεστεί το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Δεν αποκλείεται παράλληλα να γίνουν έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς συγκεκριμένων προσώπων, καθώς οι καταγγέλλουσες πηγές ανέφεραν ότι υποστηρίζουν πως από τις συγκεκριμένες προμήθειες μέλη νοσοκομείων “εισπράττουν ποσοστά”», αναφέρεται σε σχετικό επίσημο ερώτημα αρ. πρωτ. 1200/17-7-2014 των βουλευτών κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη προς τον υπουργό υγείας.

Για το καρτέλ στο χώρο του Τεχνητού Νεφρού, έχει μιλήσει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας Κος Α. Σαμαράς από το βήμα της Βουλής στις 12/11/2012:

«Τα Ελληνικά νοσοκομεία αγόραζαν ως πρόσφατα τα φίλτρα για τις μονάδες τεχνητού νεφρού προς 35 ευρώ το ένα. Την ίδια στιγμή στην Κύπρο και σε άλλες χώρες τα ίδια φίλτρα έκαναν προς 8 ευρώ το ένα! ... Αυτό πια κόβεται με το μαχαίρι...».

"Σύμφωνα με την καταγγελία, όλες οι προμηθεύτριες εταιρίες συμφώνησαν να διαθέτουν τα υλικά, στην ίδια υψηλή τιμή και συνέστησαν offshore εταιρία, με τη συμμετοχή γιατρών από την Βόρεια Ελλάδα αλλά και την Αθήνα."

Πηγή: <http://www.onmed.gr/ygeia-politiki/item/316153-sta-xeria-tou-eisaggelea-i-ypothesi-gia-to-kartel-tou-texnitoy-nefroy#ixzz3Fgiycufs>

Επειδή η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας τελεί σε πλήρη γνώση της δράσης του ΚΑΡΤΕΛ της Medical, της Τεχνοϊατρική και της Gambro με πλήθος εγγράφων που έχει κοινοποιήσει η εταιρεία μας :

Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2102, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ. 1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014,

Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3211/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3212/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3225/21-8-2015, Αρ. πρωτ. 3296/31-8-2015.

Επειδή τις εν λόγω Τεχνικές Προδιαγραφές που προτείνουμε, τις έχουμε καταθέσει και απ' ευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3225/21-8-2015 έγγραφο μας, το οποίο και επισυνάπτουμε (**Σχετ. 20**).

Επειδή, προς επιπλέον επίρρωση όλων των παραπάνω, σας επισυνάπτουμε (**Σχετ. 21**) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που καταθέσαμε προσφάτως στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας, Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 04/9696/20-10-15 έγγραφο μας.

Επειδή η παρούσα υποβολή των Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται από την εταιρεία μας ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή, cd, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, όπως ορίζει η ανακοίνωσή σας, έγγραφο με αρ. πρωτ. 19763/28-9-2015.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές και Παρατηρήσεις μας και να διαμορφώσετε ανάλογα τους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας έτσι :


- το σταμάτημα των ασύμφορων μονοπωλιακών συνεργασιών των Δημόσιων Νοσοκομείων.
- την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο των συμβάσεων λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro.
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τους προϋπολογισμούς των Δημόσιων Νοσοκομείων – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Επισυναπτόμενα Σχετικά:

- 1) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 5402/23-06-2015 του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου- Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΔΥΝΑΚΕΙΟ»
- 2) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 6/2014 του Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- 3) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 2137/2015 του Γ.Ν. Ρεθύμνου
- 4) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 2860/20-03-2015
- 5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 8834/21-9-2015
- 6) Σύμβαση 4567/2003 Υπουργείου Ανάπτυξης – Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ
- 7) Απόσπασμα της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου
- 8) Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για συντηρήσεις ιατρικών μηχανημάτων με αποσπασματική μετάφραση
- 9) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 05/2012 του Γ.Ν. Κοργαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
- 10) Σύμβαση της εταιρείας με το Γ.Ν. Αθηνών Παν. & Αγλ. Κυριακού
- 11) Σύμβαση της εταιρείας με το Γ.Ν. Αθηνών Αλεξάνδρα
- 12) Σύμβαση της εταιρείας με το Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών
- 13) Σύμβαση της εταιρείας με το Γ.Ν. Αττικής Σισμανογλειο-Αμ. Φλεμιγκ, αφορά Γ.Νοσ/μειο Σισμανογλειο
- 14) Σύμβαση της εταιρείας μας με το 251 Γ.Ν. Αεροπορίας
- 15) Σύμβαση της εταιρείας μας το Γ.Ν. Αττικής Σισμανογλειο-Αμ. Φλεμιγκ, υποκατάστημα Αμ. Φλέμιγκ
- 16) Εγχειρίδιο χειριστή Gambro για το μηχάνημα AK 96
- 17) Εγχειρίδιο λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200 op.man. HCEL9761.Rev.12.1999 program verison 4.xx σελ. 1:3 και 1:4
- 18) Εγχειρίδιο λειτουργίας (χειριστή) μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200S HCEL9882 Αναθεώρηση 04.2010. Έκδοση προγράμματος 10.xx σελ. 1:7 και 1:8
- 19) Εγχειρίδιο συντήρησης HCEN12395 Revision 02.2010 program version 10.xx σελ. 1:5
- 20) Έγγραφο της εταιρείας μας υπ' αριθμ. 3225/21-8-2015 προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
- 21) Έγγραφο μας υπ' αριθμ. πρωτ. 04/9696/20-10-15προς το Γ.Ν. Έδεσσας
- 22) Ψηφιακός Δίσκος (cd) με όλα τα δεδομένα του παρόντος

Για τη ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ

ΣΕΡ.ΚΟ Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3 - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ.: 210 7013582 - FAX: 210 7519343
ΑΦΜ: 095221353 - ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ

Μπάλτσας Ιωάννης  Στεριώτης Κων/νος 

Διαχειριστές

Αγηςάνδρου 3, Αγ.Αρτέμιος-116 32 Αθήνα e-mail: serco1@otenet.gr Τηλ:2107013582-2107520070 Fax:2107519343

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Α' Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ.**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ τηλ:
2132068933

Θέμα

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τ. Ν. (50421000 - 2)**

Αριθμ. πρωτ.

22260

Ημ. καταχώρησης

27/10/2015

Ενέργεια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ