

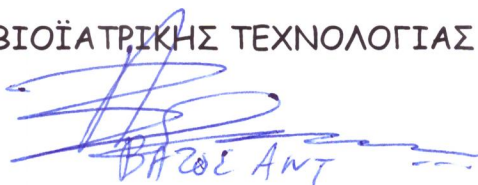
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΕΤ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

Α.ΓΕΝΙΚΑ		
Σετ επιτοίχιας αναρρόφησης σύγχρονης τεχνολογίας για χρήση σε Τμήμα του Νοσοκομείου με δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στην κεντρική λήψη του νοσοκομείου. Το σετ να περιλαμβάνει : 1. Ρυθμιστή ύψους κενού (Μανόμετρο) 2. Δοχείο υπερχειλίσης 3. Σωλήνες σύνδεσης πολλαπλών χρήσεων της αναρρόφησης με το σάκο συλλογής εκκριμάτων ασθενών μίας χρήσης		
Β.ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ		
1.	Ρυθμιστή ύψους κενού (μανόμετρο) συνοδευόμενο από φιάλη υπερχειλίσης, μικρής χωρητικότητας και βαλβίδα ασφαλείας, υψηλής ποιότητας κατασκευής	ΝΑΙ
2.	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν
3.	Βάρος (Kg)	Να αναφερθεί
4.	Μανόμετρο ακριβείας	Ένδειξη από 0-1000 mbar
5.	Διακόπτης κενού (ON-OFF) ή μπουτόν	Υψηλής ποιότητας κατασκευής
6.	Περιστροφικός επιλογέας ρύθμισης κενού	Υψηλής ποιότητας κατασκευής, με εύρος από 0 έως -0,8 bar περίπου
7.	Εύρος αναρροφητικής ικανότητας	0-24 (l/min) περίπου
8.	Ένταση κενού	-5 έως -80 (kPa) περίπου
9.	Σύστημα ασφαλείας κατά της υπερχειλίσης	Ναι. Να περιγραφεί
10.	Το σύστημα του ρυθμιστή να συνδέεται απ' ευθείας στη λήψη κενού (γαλλικού τύπου AFNOR), με απλή περιστροφική κίνηση.	ΝΑΙ
11.	Να είναι ανθεκτικής κατασκευής	ΝΑΙ
12.	Να έχει δυνατότητα αντικατάστασης των εξαρτημάτων (αποσπώμενα)	ΝΑΙ
13.	Τα τμήματα του σετ αναρρόφησης, που επιμολύνονται και χρειάζονται αποστείρωση, να αποσυνδέονται εύκολα, για να μπορούν να αποστειρωθούν	ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά
14.	Δυνατότητα χρήσης σάκων μίας χρήσης αλλά και φιαλών συλλογής εκκριμάτων με καπάκι ασφαλείας διαφόρων χωρητικότητων,	ΝΑΙ. Να αναφερθούν αναλυτικά.

Γ.Ν.Α "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Β' & Γ' ΧΕΙΡ/ΚΗ
ΛΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

	αποστειρώσιμες.	
15.	Η εγκατάσταση, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή	ΝΑΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΑΝΤ

ΓΙΑ ΤΟ

ΤΜΗΜΑ
Γ.Ν.Α "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Β' & Γ' ΧΕΙΡ/ΚΗ
ΛΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
1.	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
2.	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
3.	Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος των απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και ανταλλακτικών σταθερή τιμή για πέντε (5) έτη.
4.	Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης.
5.	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 13485:2016 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE ή σύμφωνα με την οδηγία 745/2017. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
6.	Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
7.	Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16.01.2004 του Υπουργείου Υγείας.
8.	Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον προμηθευτή, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με τους ίδιους ζητούμενους



	όρους μέχρις συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.
9.	Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους κλπ, όπως αυτούς προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού).
10.	Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης